

GINRAM®

PRODOTTI MONOUSO STERILI PER LA GINECOLOGIA

Gynaecological disposable, sterile devices

AMNIORAM

Ago per amniocentesis transaddominale **Transabdominal amniocentesis needle**

**COD. 770212 – 770228 – 770222 – 770224 – 770201 – 770226 –
 770227 – 770223 – 770202 – 770229 – 770232 – 770233**


I

Istruzioni d'uso

Togliere l'ago dalla confezione. Prima di iniziare l'esame assicurarsi che la tacca di aggancio del tappino sia perfettamente inserita nella sede del raccordo. Posizionare lo stopper sulla cannula all'altezza voluta. Sfilare la protezione dell'ago e tenere con una mano lo stopper affinché non fuoriesca. Inserire l'ago su un asse perpendicolare seguendo il tracciato dell'ultrasuono (precedentemente identificato) fino ad arrivare al sacco amniotico. Rimuovere il mandrino e connettere una siringa della capacità desiderata (normalmente 20 cc) al raccordo luer dell'ago. Aspirare il liquido amniotico esercitando una lenta e moderata pressione negativa fino a prelevare la quantità di liquido voluta. Togliere la siringa, reinserire il mandrino nell'ago e rimuovere. Trasferire il liquido amniotico in una provetta asciutta e sterile e conservarla alla temperatura di 37°.

Avvertenza: Leggere le istruzioni prima dell'uso. Non riutilizzare. Utilizzare solo se la confezione è integra. Conservare ad una temperatura variabile tra 0°C e 40°C. Utilizzare immediatamente dopo l'apertura della busta. Distruggere dopo l'utilizzo in accordo alle norme vigenti. Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale medico specializzato.

Può contenere tracce di nichel.

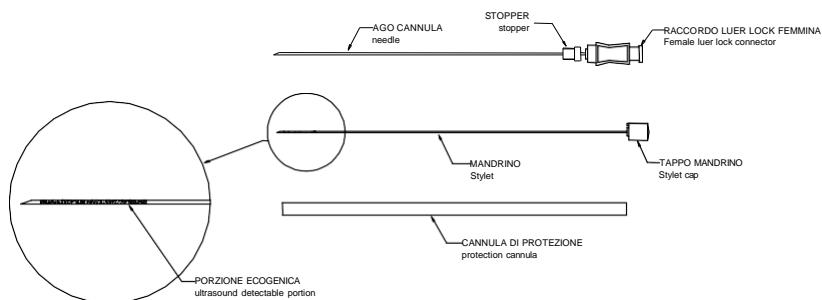

CE 0051

0476 RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755
fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – <http://www.rimos.com>



RI.MOS. s.r.l. via Manuzio, 15 – 41037 MIRANDOLA (MO) ITALY – tel. +39 0535 – 25755
fax +39 0535 – 25509 e-mail: info@rimos.com – <http://www.rimos.com>

LOT	NUMERO DI LOTTO	REF	CODICE PRODOTTO	 LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE	 LATEX FREE	STERILE EO	STERILIZZAZIONE CON OSSIDO DI ETILENE
 DATA ENTRO CUI IL DISPOSITIVO PUO ESSERE USATO		 LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO		 FABBRICANTE	 DATA DI FABBRICAZIONE	 MONOUSO	
 BATCH CODE		 REFERENCE NUMBER		 ATTENTION. SEE INSTRUCTIONS FOR USE	 LATEX FREE	STERILE EO	STERILIZED BY ETHYLENE OXIDE
 USE BY MM/YYYY		 CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE		 MANUFACTURER	 DATE OF MANUFACTURE	 DO NOT REUSE	