

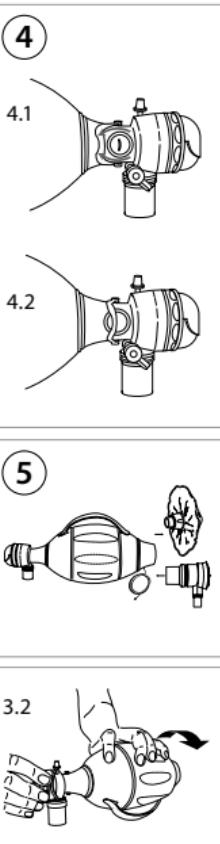


INSTRUCTIONS FOR USE

Ambu® SPUR® II
Disposable

Ambu

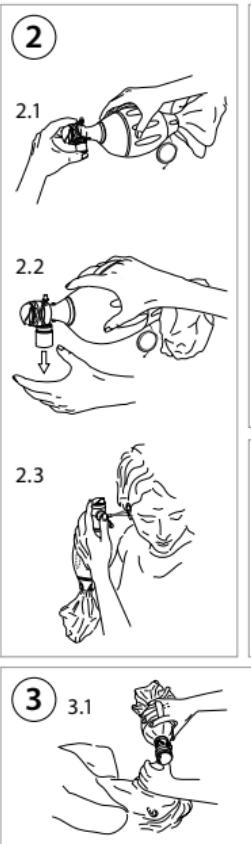

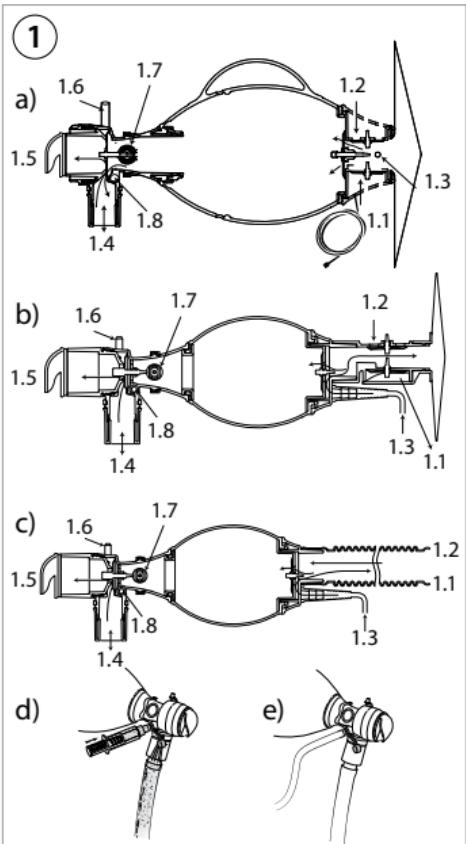

6

6.1

ADULT
 $\geq 20 \text{ kg}$

$\text{O}_2 (\text{l/min})$	250×12	600×12	750×12	1000×12
2	74	43	38	34
5	100	76	65	54
10	100	100	100	87
15	100	100	100	100

6.2

PEDIATRIC
 $4-30 \text{ kg}$


$\text{O}_2 (\text{l/min})$	40×40	100×20	200×20	400×15
1	70	60	40	34
2	100	100	60	47
4	100	100	100	73
6	100	100	100	100

6.3

INFANT
 $< 10 \text{ kg}$

$\text{O}_2 (\text{l/min})$	40×40		100×20		150×20	
	Reservoir Bag	10" Tube	Reservoir Bag	10" Tube	Reservoir Bag	10" Tube
1	70	70	60	60	47	47
2	100	100	100	100	73	73
4	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100

Calculated delivered $\text{O}_2 \%^*$

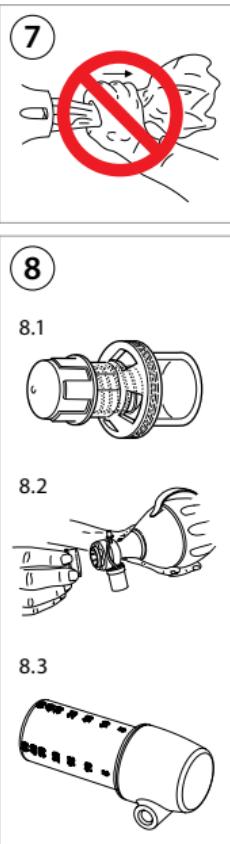

6*

EN	Calculated delivered O ₂ %, V _r : Ventilation volume, f: Frequency	LT	Apskaičiuotas O ₂ % tiekimas, V _r : Ventiliavimo tūris, f: Dažnis
BG	Изчислен доставян O ₂ %, V _r : Вентилационен обем, f: Честота	LV	Aprēķinātais piegādātais O ₂ %, V _r : Elpināšanas tilpums, f: Frekvence
CS	Vypočtený dodávaný O ₂ %, V _r : Ventilační objem, f: Frekvence	NL	Berekende toegeediende O ₂ %, V _r : Beademingsvolume, f: Frequentie
DA	Beregnet leveret O ₂ %, V _r : Ventilationsvolumen, f: Frekvens	NO	Beregnet levert O ₂ %, V _r : Ventileringsvolum, f: Frekvens
DE	Berechnetes zugeführtes O ₂ %, V _r : Beatmungsvolumen, f: Frequenz	PL	Obliczony dostarczony O ₂ %, V _r : Objętość wentylacji, f: Częstotliwość
EL	Υπολογισμένο παρεχόμενο O ₂ %, V _r : Όγκος αερισμού, f: Συχνότητα	PT	Fornecimento calculado O ₂ %, V _r : Volume de ventilação, f: Frequência
ES	O ₂ % suministrado calculado, V _r : Volumen de ventilación, f: Frecuencia	RO	O ₂ % furnizat calculat, V _r : Volum de ventilare, f.: Frecvență
ET	Arvutuslik edastatav O ₂ %, V _r : Ventileerimismäht, f: Sagedus	RU	Расчетные значения подаваемого O ₂ %, V _r : Объем вентиляции, f: Частота
FI	Laskennallinen toimitettu O ₂ %, V _r : Ventilointimäärä, f: Taajuus	SK	Vypočítaný dodaný objem O ₂ %, V _r : Ventilačný objem, f: Frekvencia
FR	% d'O ₂ administré calculé, V _r : Volume de ventilation, f: Fréquence	SL	Izračunani dovedeni O ₂ (%), V _r : Volumen predihavanja, f: Frekvenca
HR	Izračunati isporučeni O ₂ %, V _r : Ventilacijski volumen, f: Frekvencija	SV	Beräknad tillförsel av O ₂ %, V _r : Ventilationsvolym, f: Frekvens
HU	Számított leadott O ₂ %, V _r : Lélegeztetési térfogat, f: Frekvencia	TR	Hesaplanmış verilen % O ₂ , V _r : Ventilasyon hacmi, f: Frekans
IT	O ₂ % erogato calcolato, V _r : Volume di ventilazione; f: Frequenza	ZH	计算输送的 O ₂ %, V _r : 通气量, f: 频率
JA	供給酸素濃度計算値(%) V _r : 換気量、f: 換気回数		



English Instructions for use	Français Mode d'emploi.....	Polski Instrukcja obsługi
5-11	74-81	145-152
Български Указания за ползване	Hrvatski Upute za upotrebu.....	Português Manual de instruções.....
12-19	82-89	153-160
Česky Návod k použití	Magyar Használati útmutató.....	Română Instrucțiuni de utilizare
20-27	90-97	161-168
Dansk Brugsanvisning.....	Italiano Manuale d'uso	Русский Инструкция по применению
28-35	98-105	169-177
Deutsch Bedienungsanleitung	日本語 使用法.....	Slovenčina Návod na použitie
36-43	106-112	178-185
Ελληνικά δηγίες χρήσεως	Lietuviškai Naudojimo instrukcijos	Slovenština Navodila za uporabo
44-51	113-120	186-193
Español Manual de instrucciones.....	Latviski Lietošanas instrukcija.....	Svenska Instruktionshandbok.....
52-59	121-128	194-201
Eesti Kasutusjuhised	Nederlands Gebruiksaanwijzing	Türkçe Kullanım talimatları.....
60-66	129-136	202-209
Suomi Käyttöohje.....	Norsk Brukerveiledning.....	中文 使用说明
67-73	137-144	210-216

1. Important information – Read before use

Read these safety instructions carefully before using the Ambu® SPUR® II Resuscitator. The instructions for use may be updated without further notice. Copies of the current version are available upon request. Please be aware that these instructions do not explain or discuss clinical procedures. They describe only the basic operation and precautions related to the operation of the resuscitator. Before initial use of the resuscitator, it is essential for operators to have received sufficient training in resuscitation techniques and to be familiar with the intended use, warnings, cautions and indications mentioned in these instructions. There is no warranty on the Ambu SPUR II Resuscitator.

1.1. Intended use

The Ambu SPUR II Resuscitator is a single patient use resuscitator intended for pulmonary resuscitation.

1.2. Indications for use

The Ambu SPUR II Resuscitator is intended to be used in situations where a manual cardio-pulmonary resuscitator is needed for assisted ventilation.

The Ambu SPUR II Resuscitator is indicated for ventilation and oxygenation of patients until a more definitive airway can be established or the patient has recovered.

1.3. Intended patient population

The size range of applications for each version is:

- **Adult:** Adults and children with a body weight more than 30 kg (66 lb).
- **Pediatric:** Infants and Children with a body weight from 6 kg to 30 kg (13 – 66 lb).
- **Infant:** Neonates and infant with a body weight up to 10 kg (22 lb).

Please note that not all Ambu SPUR II Resuscitator configurations are available for all three patient ranges.

1.4. Intended user

Medical professionals trained in airway management such as anesthesiologists, nurses, rescue personnel and emergency personnel.

1.5. Contra indications

None known.

1.6. Clinical benefits

The basic airway management technique using a manual resuscitator allows for ventilation and oxygenation of patients until a more definitive airway can be established or the patient has recovered.

1.7. Warnings and cautions

Failure to observe these precautions may result in inefficient ventilation and oxygenation of the patient or damage to the equipment.

WARNINGS

1. Do not use the resuscitator for more than 4 accumulated hours over a maximum time span of 1 week, in order to avoid the risk of infection.
2. Do not reuse the resuscitator if visible moisture or residues are left inside the device, in order to avoid the risk of infection and malfunction.
3. Ensure that either the Splash Guard or Ambu PEEP valve is attached to the expiratory port. An open expiratory port can be accidentally blocked and result in excessive air volume in the lungs, which can lead to tissue trauma.
4. Avoid the use of the resuscitator in toxic or hazardous environments, to avoid the risk of tissue damage.

5. Always ensure that the oxygen reservoir tube is not blocked, as blocking the tube can prevent the compression bag from reinflating, which can result in no possible ventilation.
 6. Do not use the product if contaminated by external sources, as this can cause infection.
 7. Always visually inspect the product and perform a functionality test after unpacking, assembly and prior to use, as defects and foreign matters can lead to no or reduced ventilation of the patient.
 8. Do not use the product if functionality test fails, as this can lead to no or reduced ventilation.
 9. Do not override the pressure-limiting valve unless a medical assessment indicates the necessity. High ventilation pressures may cause barotrauma.
 10. For single patient use only. Use on other patients can cause cross infection.
 11. Medication cannot be delivered through the M-port if accessories (e.g. filter, CO₂ detector) are connected between the resuscitator and the face mask.
 12. Do not leave M-port open after use, in order to avoid leakage, which may lead to reduced O₂ delivery to the patient.
 13. The M-Port should not be used for side-stream EtCO₂ monitoring of patients ventilated with less than 400 ml Tidal Volume, to avoid inaccurate EtCO₂ measurements.
 14. When administering medication with a volume below 1 ml, it is required to flush the M-Port to ensure accurate medication dosage delivered.
 15. Do not attach oxygen supply tubing to the M-port, as the intended O₂ concentration will not be delivered to the patient.
 16. Adding accessories may increase inspiratory and/or expiratory resistance. Do not attach accessories if increased breathing resistance would be detrimental to the patient.
 17. Only to be used by intended users who are familiar with the content of this manual, as incorrect use might harm the patient.
-
18. When using supplemental oxygen, do not allow smoking or use of device near open flame, oil, grease, other flammable chemicals or equipment and tools, which cause sparks, due to the risk of fire and/or explosion.
 19. Do not attempt to attach any demand valve to the infant version, as this can cause high oxygen concentrations, which might be harmful to neonates.
 20. Be aware of complete/partial upper airway obstruction signs when using the resuscitator attached to a face mask, as this will lead to no or limited oxygen delivery. Always switch to an alternative to using a face mask for directing air to the patient, if available.
 21. Do not use product with attached face mask when ventilating infants with congenital diaphragmatic hernia due to the risk of insufflation. Switch to an alternative to using a face mask for directing air to the patient, if available.
 22. Professionals performing the procedure should assess the choice of resuscitator size and accessories (e.g. face mask, PEEP valve, etc.) in accordance with the patient's specific condition(s), as incorrect use may harm the patient.
 23. Do not use the Ambu SPUR II when delivery of free-flow oxygen is needed due to possible insufficient administration of oxygen, which can lead to hypoxia.
 24. The Manometer cap must always be put on the Manometer port when pressure is not being monitored to avoid leakage, which may lead to reduced O₂ delivery to the patient.
 25. Always pre-attach the oxygen tube to the oxygen supply at temperatures above 0 °C, as mounting can become difficult at temperatures below 0 °C, thereby leading to reduce oxygen delivery to the patient.
 26. When using the resuscitator with attached face mask, ensure correct positioning and sealing of the face mask, as improper sealing can lead to spreading of airborne infectious disease to the user.

CAUTIONS

1. Never store the resuscitator in a deformed state other than as folded when delivered by the manufacturer, otherwise permanent distortion of the bag could occur, which may reduce the ventilation efficiency. The folding zone is clearly visible on the bag (only Adult and Pediatric versions may be folded).
2. Always watch the movement of the chest and listen for the expiratory flow from the patient valve, in order to check the ventilation. Switch immediately to mouth-to-mouth ventilation if ventilation with the resuscitator cannot be achieved.
3. Do not soak, rinse, or sterilize this device, as these procedures may leave harmful residues or cause malfunction of the device. The design and material used are not compatible with conventional cleaning and sterilization procedures.
4. Use the M-Port only for one of the two; EtCO₂ measuring or drug administration, as this can modify the measured values.
5. If applicable, please see accessory packaging for more specific information about the individual accessory as incorrect handling may lead to malfunction of the entire product.
6. The use of third-party products and oxygen delivery devices (e.g. filters and demand valves) with the Ambu SPUR II Resuscitator may influence product performance. Please consult the manufacturer of the third-party device to verify compatibility with Ambu SPUR II Resuscitator and obtain information on the possible performance changes.
7. The oxygen reservoir bag is permanently attached to the inlet valve on adult and pediatric resuscitators, except on demand valve versions. Do not attempt to disassemble. Do not pull the oxygen reservoir bag, as it may result in malfunction of the device.

1.8. Potential adverse events

Potential adverse events related to resuscitation (not exhaustive): barotrauma, volutrauma, hypoxia, hypercarbia and aspiration pneumonia.

1.9. General notes

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

2. Device description

The Ambu SPUR II Resuscitator can be connected to the Ambu® Disposable Pressure Manometer, the Ambu® PEEP Valves and the Ambu® Face masks, as described in section 4.3 Operating the Resuscitator.

3. Explanation of symbols used

Symbol indication	Description
	Adult Intended ideal body mass greater than 30 kg
	Pediatric Intended ideal body mass from 6 to 30 kg
	Infant Intended ideal body mass up to 10 kg
	MR conditional
	Country of Manufacturer

Symbol indication	Description
	Medical Device
	Single Patient Multiple Use
	Do not pull the oxygen reservoir bag by force

A full list of symbol explanations can be found on <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Product use

4.1. Principle of operation

The illustration 1 shows the ventilation gas flow mixtures into the bag and to and from the patient during manual operation of the resuscitator. 1a Adult and pediatric resuscitator, 1b infant resuscitator with closed oxygen reservoir bag (bag reservoir), 1c infant resuscitator with open oxygen reservoir tube (tube reservoir).

The gas flow is similar when the patient is breathing spontaneously through the device.

The oxygen reservoir is fitted with two valves, one allowing ambient air to be drawn in when the reservoir is empty and one spilling out surplus oxygen when the oxygen reservoir bag is full.

The M-Port provides access to the inspiratory and expiratory gas flow allowing to connect a syringe for drug delivery 1d or to connect a gas sampling line for measuring side stream EtCO₂ 1e.

- 1.1 Excess oxygen release, 1.2 Air inlet, 1.3 Oxygen inlet, 1.4 Patient connector, 1.5 Expiration, 1.6 Manometer port, 1.7 Pressure-limiting valve, 1.8 M-port.

NOTE: attachment to 1.5 can be either a splash guard or a PEEP valve.

4.2. Inspection and Preparation

The resuscitator must be unpacked and prepared (including performing a functionality test) for immediate use before it is placed ready for use in emergency situations.

4.2.1. Preparation

- If the resuscitator is packed in a compressed state, unfold by pulling on the patient valve and the inlet valve.
- Prepare the resuscitator and place all items in the carrying bag supplied with the resuscitator.
- If the face mask supplied with the resuscitator is wrapped in a protective pouch, the pouch should be removed before use.

Refer to section 4.2.2. (Oxygen tube) for preparation of the device before use at below 0 °C.

4.2.2. Test of function 2

Resuscitator

Close the pressure-limiting valve with the override clip and close the patient connector with the thumb 2.1. Briskly squeeze the compressible bag. The resuscitator shall resist the squeeze.

Open the pressure-limiting valve by sliding away the override clip and repeating the procedure. The pressure-limiting valve should now be activated, and it should be possible to hear the flow from the valve during brisk compression of the compressible bag.

Squeeze and release the resuscitator a few times to ensure that air is moving through the valve system and out of the patient valve. 2.2

NOTE: As the valve discs are moving during functionality test or during ventilation a slight sound may appear. This does not compromise the functionality of the resuscitator.

Oxygen tube

Mounting of the oxygen tube and test of function for the oxygen reservoir bag and the oxygen reservoir tube should be performed at temperatures above 0 °C. For use of the resuscitator at temperatures below 0 °C, leave the oxygen tube connected to the oxygen supply following the test of function.

Oxygen reservoir bag

Supply a gas flow of 10 l/min at the oxygen inlet connector. Eventually, support unfolding of the bag by hand. Check that the oxygen reservoir bag fills. If not, check the integrity of the two valve shutters or for a torn oxygen reservoir.

Subsequently, adjust the supplied gas flow according to medical indication.

Oxygen reservoir tube

Supply a gas flow of 10 l/min at the oxygen inlet connector. Check that the oxygen flows out at the end of the oxygen reservoir tube. If not, check for a blocked oxygen tube. Subsequently, adjust the supplied gas flow according to medical indication.

M-Port

Remove the M-Port cap and block the patient connector. Squeeze the bag and listen for the sound of air being pressed out through the M-Port. **2.3**

4.3. Operating the resuscitator

- Use recommended techniques to clear the patient's mouth and airway and to position the patient correctly, to open the airway.
- Hold the face mask firmly against the patient's face. **3.1**
- Slide your hand (Adult Version) or ring and middle finger (Pediatric version) under the handle. The infant version does not have a support handle.

Ventilation without using the support handle can be achieved by turning the bag. **3.2**
Ventilation of the patient: During insufflation observe for chest rise. Release the hand holding the bag abruptly and listen for the expiratory flow from the patient valve and as well for the visual lowering of the chest.

- If continued resistance to insufflation is encountered, check the airway for obstruction and re-position the patient, to ensure an open airway.
- If the patient vomits during ventilation; immediately clear the patient's airway, and expel the vomit from the resuscitator by shaking and compressing it forcefully and fast several times before resuming ventilation.
If necessary, wipe off the product with a cloth containing alcohol and clean the splash guard with water.

Manometer port

The Ambu disposable pressure manometer as well as third party pressure gauge can be attached to the manometer port, situated on the top of the patient valve. Remove the cap and attach the manometer/pressure gauge

Pressure-limiting system **4**

The pressure-limiting valve is set to open at 40 cm H₂O (4.0kPa). **4.1**

If medical and professional assessment indicates a pressure above 40 cm H₂O is required, the pressure-limiting valve can be overridden by moving the override clip onto the valve. **4.2**

Alternatively, the pressure-limiting valve can be overridden by placing a finger on the red button while squeezing the bag.

M-Port

The Ambu SPUR II Resuscitator comes either with or without an M-Port. The M-Port provides access to the inspiratory and expiratory gas flow and can be used for applying medication, where connected to a syringe, and as well used to measure side stream CO₂ (EtCO₂). When not in use, remember to close the M-port with the red M-port cap.

Measuring EtCO₂

For measuring of side stream EtCO₂; connect the gas-sampling line for the EtCO₂ measuring device to the M-Port of Ambu SPUR II Resuscitator. Connect the gas sampling line connector by mounting and rotating it 1/4 turn clockwise.

Applying medication

Carefully observe patient response to the administered medication. Administration of volumes of 1 ml fluid or above through the M-Port is comparable with administration directly into an endotracheal tube. The M-Port has been tested with epinephrine, lidocaine, and atropine.

Ambu SPUR II Resuscitator demand valve version 5

Ambu SPUR II Resuscitator demand valve version is available in adult and pediatric sizes and can be used either with or without a demand valve and comes with an attachable oxygen reservoir bag.

The inlet valve of the Ambu SPUR II Resuscitator connects to the demand valve via an adapter.

Attachment of the demand valve:

- Remove the oxygen reservoir unit from the Ambu SPUR II Resuscitator inlet valve, if attached.
- Attach the adapter to the demand valve system.
- Insert the demand valve adaptor in the Ambu SPUR II Resuscitator inlet valve.

NOTE: Use only part labeled "compression unit" with adapter and Demand valve. The part labeled "Oxygen Reservoir Bag" is regarded as back-up if the demand valve fails.

Oxygen administration

Administer oxygen according to medical indication.

The figure 6 shows Calculated delivered oxygen percentages which can be obtained with different ventilation volumes and frequencies at different gas flow rates. The oxygen percentages can be seen in 6 Adult 6.1, Pediatric 6.2, Infant 6.3.

Oxygen reservoir bag 7

The thin oxygen reservoir bag plastic foil cannot be detached from its point of fixation to the resuscitator at any time.

Accessories 8

The Ambu SPUR II Resuscitator connectors follows ISO 5356-1 and EN 13544-2 making it compliant to other hospital equipment. When applying external devices, make sure to test for functionality and consult the instructions for use accompanying the external device.

Ambu products compatible with Ambu SPUR II Resuscitator are stated below:

Ambu® Disposable Face Mask

For further information please refer to the directions for use of the Ambu Disposable Face Mask.

Ambu® Disposable PEEP 20 valve 8.1 8.2

For further information please refer to the instruction for use of the Ambu Disposable PEEP 20 valve or refer to illustration 8.1 in this Instruction for use. To fit the Ambu Disposable PEEP 20 valve (if required) to the resuscitator, remove the splash guard. 8.2

Ambu® Disposable Pressure Manometer 8.3

For further information please refer to the directions for use of the Ambu Disposable Pressure Manometer.

4.4. After use

Used products must be disposed of according to local procedures.

5. Technical product specifications

5.1. Standards applied

The Ambu SPUR II resuscitator is conforming with the product specific standard EN ISO 10651-4.

5.2. Specifications

	Infant	Pediatric	Adult
Resuscitator volume	approx. 220 ml	approx. 670 ml	approx. 1510 ml
Delivered volume one hand*	150 ml	450 ml	600 ml
Delivered volume two hands*	-	-	1000 ml
Dimensions (length x diameter) w/o reservoir and accessory	approx. 190 x 71 mm	approx. 223 x 99 mm	approx. 284 x 127 mm
Weight w/o reservoir and accessory	approx. 70 g	approx. 145 g	approx. 220 g
Pressure-limiting valve**	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)
Dead space	≤ 5 ml + 10 % of the delivered volume	≤ 5 ml + 10 % of the delivered volume	≤ 5 ml + 10 % of the delivered volume
Inspiratory resistance***	max 0.1 kPa (1.0 cm H ₂ O) at 5 l/min	max 0.5 kPa (5.0 cm H ₂ O) at 50 l/min	max 0.5 kPa (5.0 cm H ₂ O) at 50 l/min
Expiratory resistance***	max 0.2 kPa (2.0 cm H ₂ O) at 5 l/min	max 0.27 kPa (2.7 cm H ₂ O) at 50 l/min	max 0.27 kPa (2.7 cm H ₂ O) at 50 l/min
Reservoir volume	approx. 300 ml (bag) approx. 100 ml (tube)	approx. 2600 ml (bag)	approx. 2600 ml (bag)
Patient connector	Outside 22 mm male (ISO 5356-1) Inside 15 mm female (ISO 5356-1)		
Expiration connector (for PEEP valve attachment)	30 mm male (ISO 5356-1)		
Manometer Port connector	Ø 4.2 +/- 0.1 mm		
Demand Valve connector	-	Inside 32 mm female (EN ISO 10651-4)	

	Infant	Pediatric	Adult
Forward and backward leakage	Not measurable		
M-Port	Connector compatible with EN ISO 80369-7		
O ₂ inlet connector	According to EN 13544-2		
Operation temperature limits	-18 °C to +50 °C (-0.4 °F to +122 °F), tested according to EN ISO 10651-4		
Storage temperature limits	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F), tested according to EN ISO 10651-4		
Recommended long term storage in closed packaging at room temperature, away from sunlight.			

* Tested according to EN ISO 10651-4.

** Higher delivery pressure can be obtained by overriding the pressure-limiting valve.

*** At general test conditions according to EN ISO 10651-4.

5.3. MRI Safety Information

The Ambu SPUR II Resuscitator¹, and Ambu SPUR II Resuscitator with attached Ambu Disposable PEEP 20 Valve², and Ambu SPUR II Resuscitator with attached Ambu Disposable PEEP 20 Valve and Ambu Disposable Pressure Manometer² are MR Conditional, and therefore may be safely used in the MR environment (not inside the MR bore) under the following conditions.

Static magnetic field of 7 Tesla and less, with

- Maximum spatial field gradient of
 - 10,000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16,000 G/cm (160 T/m)²
- Maximum force product of
 - 450,000,000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721,000,000 G2/cm (721 T²/m)²

Use inside the MR bore may influence MR image quality.

RF-induced heating and MR image artifacts have not been tested. Any metallic parts are fully encapsulated and do not have any contact with the human body.

1. Важна информация – Прочетете преди употреба

Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност, преди да използвате ресусцитатора Ambu® SPUR® II. Инструкциите за употреба подлежат на актуализиране без допълнително предизвестие. Копия на текущата версия са налични при поискване. Имайте предвид, че тези инструкции не дават обяснения и не разглеждат клиничните процедури. Те описват само базовите операции и предпазните мерки, свързани с работата с ресусцитатора. Преди първата употреба на ресусцитатора е важно операторите да са получили подходящо обучение за техниките на ресусцитация и да са запознати с предназначението, предупрежденията, предпазните мерки и показанията, отбелзани в тези инструкции. Няма гаранция за ресусцитатора Ambu SPUR II.

1.1. Предназначение

Ресусцитаторът Ambu SPUR II е ресусцитатор за употреба върху един пациент, предназначен за пулмонална ресусцитация.

1.2. Показания за употреба

Ресусцитаторът Ambu SPUR II е предназначен за употреба в ситуации, при които е необходим ръчен кардиопулмонален ресусцитатор за асистирана вентилация.

Ресусцитаторът Ambu SPUR II е показан за вентилация и оксигенация на пациенти, докато не се установи по-дефинитивна проводимост на дихателните пътища или пациентът не се възстанови.

1.3. Целева пациентска популация

Размерният диапазон на приложението за всяка версия е:

- Възрастни:** възрастни и деца с телесно тегло над 30 kg (66 lb).
- Деца:** бебета и деца с телесно тегло от 6 kg до 30 kg (13 – 66 lb).
- Бебета:** новородени и бебета с телесно тегло до 10 kg (22 lb).

Имайте предвид, че не всички конфигурации на ресусцитатора Ambu SPUR II са налични за всичките три групи пациенти.

1.4. Предвидена група потребители

Медицински специалисти, обучени в обезпечаването на проводимостта на дихателните пътища, като анестезиолози, медицински сестри, служители в спасителни служби и служители на спешната помощ.

1.5. Противопоказания

Не са известни.

1.6. Клинични ползи

Основната техника за обезпечаване на проводимостта на дихателните пътища с помощта на ръчен ресусцитатор позволява вентилация и оксигенация на пациенти, докато не се установи по-дефинитивна проводимост на дихателните пътища или пациентът не се възстанови.

1.7. Предупреждения и предпазни мерки

Неспазването на тези предпазни мерки може да доведе до неефективни вентилация и оксигенация на пациента или повреда на апарат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не използвайте ресусцитатора за повече от общо 4 часа с натрупване в рамките на максимален период от 1 седмица, за да избегнете риска от инфекция.
2. Не използвайте повторно ресусцитатора, ако в него останат видими следи от влага или остатъци, за да избегнете риска от инфекция и неправилно функциониране.
3. Уверете се, че предпазителят за пръски или PEEP клапанът Ambu са прикрепени към експираторния порт. Отворен експираторен порт може да бъде неволно блокиран и това да доведе до прекомерен обем на въздуха в белите дробове, което в резултат да предизвика травма на тъканите.
4. Избягвайте използването на ресусцитатора в токсична или опасна среда, за да избегнете риска от увреждане на тъканите.

5. Винаги се уверявайте, че тръбата на резервоара за кислород не е блокирана, тъй като запушването на тръбата може да попречи на компресионния балон да се напомпа отново, което може да доведе до невъзможност за вентилиране.
6. Не използвайте продукта, ако е замърсен от външни източници, тъй като това може да причини инфекция.
7. Винаги проверявайте продукта визуално и изпълнявайте функционален тест след разопаковане, сглобяване и преди употреба, тъй като дефектите и чуждите материки може да доведат до липса или намалено вентилиране на пациента.
8. Не използвайте продукта, ако тестът за функционалност е неуспешен, тъй като това може да доведе до липса или намалено вентилиране.
9. Не затваряйте клапана за ограничаване на налягането, освен ако медицинската оценка не указва необходимост. Високото вентилационно налягане може да причини баротравма.
10. Само за еднократна употреба. Използването върху други пациенти може да доведе до кръстосано заразяване.
11. През M-port не може да се достави лекарство, ако аксесоарите (напр. филтър, детектор за CO₂) са свързани между ресусцитатора и лицевата маска.
12. Не оставяйте M-port отворен след употреба, за да избегнете изтичане, което може да доведе до намаляване на подаването на O₂ на пациента.
13. M-Port не трябва да се използва за мониторинг на EtCO₂ в страничния поток при пациенти, вентилирани с по-малко от 400 ml дихателен обем, за да се избегнат неточни измервания на EtCO₂.
14. При администриране на медикаменти с обем под 1 ml е необходимо промиване на M-Port, за да се осигури точно дозиране на лекарството.
15. Не прикачвайте тръба за подаване на кислород към M-port, тъй като желаната концентрация на O₂ няма да бъде доставена на пациента.
16. Добавянето на аксесоари може да повиши инспираторното и/или експираторното съпротивление. Не свързвайте аксесоари, ако повишеното съпротивление при дишане ще бъде вредно за пациента.
17. Да се използва само от предвидената група потребители, които са запознати със съдържанието на това ръководство, тъй като неправилната употреба може да навреди на пациента.
18. Когато използвате допълнителен кислород, не допускайте пущене или използване на изделието в близост до открит пламък, масло, смазка, други запалими химикали или оборудване и инструменти, които могат да причинят искири, поради опасност от пожар и/или експлозия.
19. Не се опитвайте да прикачвате клапана за белите дробове към версията за бебета, тъй като това може да доведе до високи концентрации на кислород, което може да е вредно за новородените.
20. Имайте предвид признаките за пълна/частична обструкция на дихателните пътища, когато използвате ресусцитатора, прикрепен към маска за лице, тъй като това ще доведе до липса или ограничено подаване на кислород. Винаги преминавайте към алтернатива на използването на маска за лице за насочване на въздуха към пациента, ако има такава.
21. Не използвайте продукта с прикрепена маска за лице, когато вентилирате бебета с вродена диафрагмена херния, поради рисък от инсуфляция. Преминете към алтернатива на използването на маска за лице за насочване на въздуха към пациента, ако има такава.
22. Професионалистите, които извършват процедурата, трябва да оценят избора на размер на ресусцитатора и аксесоарите (напр. маска за лице, РЕЕР клапан и т.н.) в съответствие с конкретното състояние на пациента, тъй като неправилната употреба може да навреди на пациента.
23. Не използвайте Ambu SPUR II, когато е необходимо подаване на кислород със свободен поток, поради възможно недостатъчно подаване на кислород, което може да доведе до хипоксия.
24. Капачката на манометъра трябва винаги да е поставена върху порта за манометър, когато налягането не се наблюдава, за да се избегне теч, който може да доведе до намаляване на подаването на O₂ на пациента.
25. Винаги прикачвайте предварително кислородната тръба към подаването на кислород при температури над 0 °C, тъй като монтирането може да бъде затруднено при температури под 0 °C, което води до намаляване на подаването на кислород към пациента.
26. Когато използвате ресусцитатора с прикрепена маска за лице, осигурете правилното позициониране и доброто прилепване на маската за лице, тъй като недоброто прилепване може да доведе до разпространяване на въздушно-капкови инфекциозни заболявания до потребителя.

ВНИМАНИЕ

1. Ресусцитаторът никога да не се съхранява в деформирано състояние, различно от съгнатото състояние, в което е бил при доставянето му от производителя; в противен случай може да възникне перманентна деформация на торбичката, която може да понижи ефективността на вентилацията. Зоната на сгъване се вижда ясно върху торбичката (само версията за възрастни и деца позволяват сгъване).
2. Винаги наблюдавайте движението на гръденния кош и прослушвайте за експираторен поток от клапана за пациента, за да проверявате вентилирането. Ако не може да се постигне вентилиране с ресусцитатора, преминете незабавно към обдишване уста в уста.
3. Не накисвайте, изплаквайте или стерилизирайте това изделие, тъй като тези процедури може да оставят вредни остатъци или да причинят неизправност на изделието. Конструкцията и използваният материал не са съвместими с конвенционалните процедури за почистване и стерилизация.
4. Използвайте M-Port за едно от двете; измерване на EtCO₂ или администриране на лекарство, тъй като това може да промени измерените стойности.
5. Ако е приложимо, вижте опаковката на аксесоара за по-конкретна информация относно отделния аксесоар, тъй като неправилното боравене с него може да доведе до неправилно функциониране на целия продукт.
6. Използването на продукти и устройства за подаване на кислород на трети лица (напр. филтри и клапани за белите дробове) с ресусцитатора Ambu SPUR II може да повлияе на работата на продукта. Консултирайте се с производителя на чуждото устройство, за да проверите съвместимостта с ресусцитатора Ambu SPUR II и да получите информация за възможните промени в характеристиките и действието.
7. Резервоарния балон за кислород е перманентно прикрепен към входния клапан на ресусцитаторите за възрастни и деца, с изключение на версията с клапан за белите дробове. Не се опитвайте да го отстранявате. Не дърпайте резервоарния балон за кислород, тъй като това може да доведе до неизправност на изделието.

1.8. Потенциални нежелани събития

Потенциални нежелани събития, свързани с ресусцитацията (без да са изчерпателни): баротравма, болутравма, хипоксия, хиперкарпния и аспирационна пневмония.

1.9. Общи бележки

Ако по време на употреба на това изделие или като резултат от неговата употреба възникнат сериозни инциденти, съобщете за тях на производителя и на националния компетентен орган.

2. Описание на изделието

Ресусцитаторът Ambu SPUR II може да бъде свързан към манометъра Ambu® за еднократна употреба, PEEP клапаните Ambu® и маските за лице Ambu®, както е описано в раздел 4.3 Работа с ресусцитатора.

3. Обяснение на използваните символи

Означение на символите	Описание
	Възрастни Оптимално предназначение за телесна маса над 30 kg
	Деца Оптимално предназначение за телесна маса от 6 до 30 kg
	За бебета Оптимално предназначение за телесна маса до 10 kg

Означение на символите	Описание
	Безопасно за МР при определени условия
	Държава на производителя
	Медицинско изделие
	За многократна употреба от един пациент
	Не дърпайте резервоарния балон за кислород със сила

Пълен списък на обясненията на символите може да намерите на <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Използване на продукта

4.1. Принцип на работа

На илюстрация **1** е показано как се смесва вентилационният газов поток в балона, както и към и от пациента по време на ръчното обдишване с ресусцитатора. **1a** – ресусцитатор за възрастни и деца, **1b** – ресусцитатор за бебета със затворен резервоарен балон за кислород (балонен резервоар), **1c** – ресусцитатор за бебета с отворена тръба на резервоара за кислород (тръбен резервоар).

Газовият поток е подобен, когато пациентът диша спонтанно през устройството.

Резервоарът за кислород е снабден с две клапи – една за поемане на въздух от околната среда, когато резервоарът е празен, и една за освобождаване на излишния кислород, когато балонният резервоар за кислород е пълен.

M-Port осигурява достъп до инспираторния и експираторния газов поток, като позволява да свържете спринцовка за подаване на медикаменти **1d** или линия за вземане на газови пробы за измерване в страничния поток на EtCO₂ **1e**.

1.1 Освобождаване на излишния кислород, **1.2** вход за въздух, **1.3** вход за кислород, **1.4** конектор за пациента, **1.5** експирация, **1.6** порт за манометър, **1.7** клапан за ограничаване на налягането, **1.8** M-порт.

ЗАБЕЛЕЖКА: приставката към 1.5 може да бъде или предпазител срещу пръски, или PEEP клапан.

4.2. Проверка и подготовка

Ресусцитаторът трябва да бъде разопакован и подгответ (включително извършване на тест за функционалност) за незабавна употреба, преди да се постави готов за използване в спеши ситуации.

4.2.1. Подготовка

- Ако ресусцитаторът е опакован в компресирано състояние, го разгънете, като издърпате клапана за пациента и входния клапан.
- Подгответе ресусцитатора и поставете всички елементи в плика за пренасяне, предоставен с ресусцитатора.
- Ако маската за лице, доставена с ресусцитатора, е опакована в предпазен плик, той трябва да се отстрани преди употреба.

Вижте раздел 4.2.2. (Кислородна тръба) за подготовка на изделието преди употреба под 0 °C.

4.2.2. Тест за функционалност 2

Ресусцитатор

Затворете клапана за ограничаване на налягането чрез скобата за затваряне и затворете конектора за пациента с палеца си **2.1**. Стискайте енергично компресионния балон. Ресусцитаторът трябва да оказва съпротивление на стискането.

Отворете клапана за ограничаване на налягането, като пълзнете скобата за затваряне и повторите процедурата. Клапанът за ограничаване на налягането трябва да е активиран и трябва да можете да чуете потока през него по време на енергична компресия на компресионния балон.

Стиснете и освободете ресусцитатора няколко пъти, за да се гарантира, че въздухът се движи през клапанната система и от клапана за пациента. **2.2**

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като дисковете на клапите се движат по време на функционалния тест или по време на вентилация, може да се чува лек звук. Това не застрашава функционалността на кислородния апарат.

Кислородна тръба

Монтирането на кислородната тръба и тестването на функционалността на резервоарния балон за кислород и тръбата на резервоара за кислород трябва да се извършват при температури над 0 °C. При употреба на ресусцитатора при температури под 0 °C оставете кислородната тръба свързана към подаването на кислород, след като тествате функционалността.

Резервоарен балон за кислород

Подавайте газов поток от 10 l/min към входния конектор за кислород. На финала поддържайте разгъването на балона на ръка. Проверете дали резервоарният балон за кислород се пълни. Ако не се пълни, проверете целостта на двета затварящи механизма на клапаните или за разкъсан резервоар за кислород.

След това регулирайте подавания газов поток според медицинското показание.

Тръба на резервоара за кислород

Подавайте газов поток от 10 l/min към входния конектор за кислород. Проверете дали кислородът излиза от края на тръбата на резервоара за кислород. Ако не излиза, проверете дали кислородната тръба не е блокирана. След това регулирайте подавания газов поток според медицинското показание. **2.3**

M-Port

Отстранете капачката на M-Port и блокирайте конектора за пациента. Стиснете балона и прослушайте за звук от въздушна струя, преминаваща през M-Port. **2.3**

4.3. Работа с ресусцитатора

- Използвайте препоръчените техники за правилно позициониране на пациента, за да разкриете устата и да отворите дихателните пътища.
- Дръжте маската за лице пътно до лицето на пациента. **3.1**
- Пълзнете ръката си (версия за възрастни) или безименнния и средния си пръст (версия за деца) под дръжката. Версията за бебета няма опорна дръжка.
- Вентилация без използване на опорната дръжка може да се постигне чрез завъртане на балона. **3.2**
- Вентилиране на пациента: по време на инсуфляция наблюдавайте за издигане на гръденния кош. Освободете рязко ръката, която държи балона, прослушайте за експираторен поток от клапана за пациента и проверете визуално дали има видимо спускане на гръденния кош.
- Ако е налице продължително съпротивление към инсуфляцията, проверете дихателните пътища за блокиране и позиционирайте пациента отново, за да се уверите, че дихателните пътища са отворени.
- Ако пациентът повърне по време на вентилиране, веднага почистете дихателните му пътища и изтласкайте повърнатото от ресусцитатора, като го разплатите и стиснете силно и бързо няколко пъти, преди да подновите вентилирането.
- Ако е необходимо, избършете продукта с кърпа, съдържаща алкохол, и почистете предпазителя срещу пръски с вода.

Порт за манометър

Манометърът Ambu за еднократна употреба, както и уреди за измерване на налягане на трети лица, може да се прикачват към порта за манометър, разположен в горната част на клапана за пациента. Свалете капачката и прикрепете манометъра/уреда за измерване на налягането

Система за ограничаване на налягането **4**

Клапанът за ограничаване на налягането е настроен за отваряне при $40 \text{ cm H}_2\text{O}$ ($4,0 \text{ kPa}$). **4.1**

Ако медицинската или професионалната оценка показва, че е необходимо налягане над $40 \text{ cm H}_2\text{O}$, клапанът за ограничаване на налягането може да бъде затворен чрез преместване на скобата за затваряне върху клапана. **4.2**

Алтернативен вариант е клапанът за ограничаване на налягането да бъде затворен чрез поставяне на пръст върху червения бутон, докато стискате балона.

M-Port

Ресусцитаторът Ambu SPUR II се доставя със или без M-Port. M-Port осигурява достъп до инспираторния и експираторния газов поток и може да се използва за прилагане на лекарства, когато са свързани към спринцовка, както и за измерване на страничния поток на CO_2 (EtCO_2). Когато не се използва, не забравяйте да затворите M-port с червената капачка на M-port.

Измерване на EtCO_2

За измерване на страничния поток EtCO_2 ; свържете линията за вземане на газова проба за устройството за измерване на EtCO_2 към M-Port на ресусцитатора Ambu SPUR II. Свържете конектора на линията за вземане на газова проба, като го монтирате и завъртите с $1/4$ оборот в посока на часовниковата стрелка.

Прилагане на медикаменти

Внимателно наблюдавайте реакцията на пациента към приложения медикамент. Прилагането на 1 ml обем флуид или повече през M-Port е сравнимо с прилагане директно в ендотрахеалната тръба. M-Port е тестван с еpineфрин, лидокаин и атропин.

Версия на ресусцитатора Ambu SPUR II с клапан, командван от белите дробове **5**

Версията на ресусцитатора Ambu SPUR II с клапан, командван от белите дробове, се предлага с размери за възрастни и деца и може да се използва със или без клапан, командван от белите дробове, като се доставя с прикачващ се резервоарен балон за кислород.

Входният клапан на ресусцитатора Ambu SPUR II се свързва към клапана за белите дробове посредством адаптер.

Прикачване на клапана за белите дробове:

- Отстранете блока на резервоара за кислород от входния клапан на ресусцитатора Ambu SPUR II, ако е прикрепен.
- Прикачете адаптера към клапанната система за белите дробове.
- Вкарайте адаптера на клапана за белите дробове във входния клапан на ресусцитатора Ambu SPUR II.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само частта, означена с „компресионен блок“, с адаптер и клапан за бели дробове. Частта, означена с „Резервоарен балон за кислород“, се счита за резервна, ако клапанът, командван от белите дробове, откаже.

Прилагане на кислород

Приложете кислород съгласно медицинските показания.

Фигурата **6** показва изчислените проценти на доставяния кислород, които могат да бъдат постигнати с различни обеми и честоти на вентилиране при различни скорости на газовия поток. Процентите на кислорода могат да се видят за **6** възрастни, **6.1** деца, **6.2** бебета **6.3**.

Резервоарен балон за кислород 7

Тънкото найлоново фолио на резервоарния балон за кислород никога не трябва да се отделя от точката му на фиксиране към ресусцитатора.

Аксесоари 8

Конекторите на ресусцитатора Ambu SPUR II са в съответствие с ISO 5356-1 и EN 13544-2, което го прави съвместим с друго болнично оборудване. Ако свързвате външни устройства, задължително направете тест за функционалност и прочетете инструкциите за употреба, приложени към външното устройство.

Продуктите на Ambu, съвместими с ресусцитатора Ambu SPUR II, са посочени по-долу:

Лицева маска за еднократна употреба Ambu®

За повече информация вижте инструкциите за употреба на лицева маска за еднократна употреба Ambu.

Клапан за еднократна употреба Ambu® PEEP 20 8.1 8.2

За повече информация вижте инструкциите за употреба на клапана за еднократна употреба Ambu PEEP 20, или вижте илюстрацията 8.1 в тази инструкция за употреба. За да поставите клапана за еднократна употреба Ambu PEEP 20 (ако е необходимо) към ресусцитатора, премахнете предпазителя спрещу пръски. 8.2

Манометър за еднократна употреба Ambu® 8.3

За повече информация вижте инструкциите за употреба на манометъра Ambu за еднократна употреба.

4.4. След употреба

Използваните продукти трябва да се изхвърлят в съответствие с местните процедури.

5. Технически спецификации на продукта

5.1. Приложими стандарти

Ресусцитаторът Ambu SPUR II е в съответствие с конкретния стандарт за продукта EN ISO 10651-4.

5.2. Спецификации

	За бебета	Деца	Възрастни
Обем на кислородния апарат	около 220 ml	около 670 ml	около 1510 ml
Подаван обем с една ръка*	150 ml	450 ml	600 ml
Подаван обем с две ръце*	–	–	1000 ml
Размери (дължина x диаметър) без резервоар и аксесоари	около 190 x 71 mm	около 223 x 99 mm	около 284 x 127 mm
Тегло без резервоар и аксесоари	около 70 g	около 145 g	около 220 g
Клапан за ограничаване на налягането**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Мъртво пространство	≤ 5 ml + 10 % от подавания обем	≤ 5 ml + 10 % от подавания обем	≤ 5 ml + 10 % от подавания обем
Инспираторно съпротивление*	макс. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) при 5 l/min	макс. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) при 50 l/min	макс. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) при 50 l/min
Експираторно съпротивление***	макс. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) при 5 l/min	макс. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) при 50 l/min	макс. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) при 50 l/min
Обем на резервоара	около 300 ml (балон) около 100 ml (тръба)	около 2600 ml (балон)	около 2600 ml (балон)

	За бебета	Деца	Възрастни
Конектор за пациент		Външен 22 mm, мъжки (ISO 5356-1) Вътрешен 15 mm, женски (ISO 5356-1)	
Експираторен конектор (приставка за PEEP клапан)		30 mm, мъжки (ISO 5356-1)	
Конектор за порт за манометър		Ø 4,2 +/-0,1 mm	
Конектор за клапан за белите дробове	-	Вътрешен 32 mm, женски (EN ISO 10651-4)	
Изтичане напред и назад		Неизмерваемо	
M-Port		Конектор, съвместим с EN ISO 80369-7	
Входен конектор за O ₂		В съответствие с EN 13544-2	
Ограничения на работната температура	-18 до +50 °C (-0,4 до +122 °F), тествано съгласно EN ISO 10651-4		
Ограничения на температурата на съхранение	-40 до +60 °C (-40 до +140 °F), тествано съгласно EN ISO 10651-4		
Препоръчва се дългосрочно съхранение в затворена опаковка при стайна температура, далеч от слънчева светлина.			

* Тествано съгласно EN ISO 10651-4.

** По-високо налягане за доставяне може да се постигне чрез затваряне на клапана за ограничаване на налягането.

*** При общи условия за изпитване съгласно EN ISO 10651-4.



5.3. Информация за безопасност при ЯМР

Ресусцитаторът Ambu SPUR II¹ и ресусцитаторът Ambu SPUR II с прикрепен PEEP 20 клапан за еднократна употреба Ambu², както и ресусцитатор Ambu SPUR II с прикрепен PEEP 20 клапан за еднократна употреба Ambu², са безопасни за МР при определени условия и следователно могат да се използват безопасно в среда на МР (не в отвора на МР) при посочените по-долу условия.

Статично магнитно поле от 7 tesla и по-малко, със

- Максимален пространствен градиент на полето от
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Максимална сила на продукта от
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Използването в отвора за МР може да повлияе на качеството на изображението от МР.

Радиочестотно индуцирано нагряване и артефакти в изображението от МР не са тествани. Всички метални части са изцяло капсуловани и нямат контакт с човешкото тяло.

1. Důležité informace – Před použitím čtěte

Před použitím resuscitátoru Ambu® SPUR® II si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Tento návod k použití může být aktualizován bez předchozího oznámení. Kopie aktuální verze je k dispozici na vyžádání. Vezměte laskavě na vědomí, že tento návod nevysvětluje klinické postupy a ani se jimi nezabývá. Popisuje pouze základní úkony a opatření související s použitím resuscitátoru. Před prvním použitím resuscitátoru je důležité, aby jeho obsluha byla náležitě proškolena v resuscitačních technikách a byla obeznámena s určeným použitím, varovánimi, upozorněními a indikacemi uvedenými v tomto návodu. Na resuscitátor Ambu SPUR II se nevtahuje žádná záruka.

1.1. Určené použití

Resuscitátor Ambu SPUR II je prostředek určený k použití k pulmonální resuscitaci u jednoho pacienta.

1.2. Indikace pro použití

Resuscitátor Ambu SPUR II je určen k použití v situacích, kdy je zapotřebí ruční kardiopulmonální resuscitátor k provedení asistované ventilace.

Resuscitátor Ambu SPUR II je indikován pro ventilaci a oxygenaci pacientů do doby, než je možné zajistit dýchací cesty stabilnějším způsobem, nebo než se pacient zotaví.

1.3. Určená populace pacientů

Velikostní kategorie pro použití každé verze je:

– **Dospělí:** dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 30 kg (66 lb).

– **Děti:** kojenci a děti s tělesnou hmotností od 6 kg do 30 kg (13–66 lb).

– **Kojenci:** Novorozenci a kojenci s tělesnou hmotností do 10 kg (22 lb).

Pamatujte, že ne všechny konfigurace resuscitátoru Ambu SPUR II jsou dostupné pro všechny tři kategorie pacientů.

1.4. Určený uživatel

Zdravotnící pracovníci školení v postupech zajištění dýchacích cest, jako např. anesteziologové, zdravotní sestry, zdravotníci a jiní záchranaři.

1.5. Kontraindikace

Žádné nejsou známé.

1.6. Klinické přínosy

Základní technika zajištění dýchacích cest za použití ručního resuscitátoru umožňuje ventilaci a oxygenaci pacientů do doby, než je možné zajistit dýchací cesty stabilnějším způsobem, nebo než se pacient zotaví.

1.7. Varování a upozornění

Nedodržování těchto preventivních opatření může mít za následek nedostatečnou ventilaci a oxygenaci pacienta nebo poškození prostředku.

VAROVÁNÍ !

1. Resuscitátor nepoužívejte po dobu překračující v souhrnu 4 hodiny během maximálního časového rozpětí 1 týdne, abyste předešli riziku infekce.
2. Resuscitátor nepoužívejte, je-li uvnitř prostředku viditelná vlhkost anebo rezidua, abyste předešli riziku infekce a poruchy.
3. Zkontrolujte, zda je k exspirárnímu portu připojena ochrana před postříkáním nebo ventil Ambu PEEP. Otevřený expirační port může být nechtěně zablokován, což může mít za následek nadměrný objem vzduchu v plicích a tím i poranění tkáně.
4. Vyvarujte se použití resuscitátoru v toxickém nebo nebezpečném prostředí, aby nedošlo k poškození tkáně.

5. Vždy se ujistěte, že hadice kyslíkového rezervoáru není zablokovaná, jelikož její zablokování může bránit stlačenému vaku v opětovném nafouknutí, čímž může znemožnit ventilaci.
6. Nepoužívejte výrobek v případě, že došlo k jeho kontaminaci externími zdroji, neboť by to mohlo způsobit infekci.
7. Po vybalení, sestavení a před použitím výrobek vždy nejprve vizuálně zkontrolujte a proveďte test funkčnosti, protože vady a cizí látky mohou znemožnit anebo omezit ventilaci pacienta.
8. Výrobek nepoužívejte, pokud test funkčnosti neproběhl úspěšně, jelikož tím může dojít k omezení či znemožnění ventilace.
9. Nikdy nevyřazujte přetlakový ventil, pokud to není nezbytné na základě lékařského posouzení. Vysoké ventilační tlaky mohou zapříčinit barotrauma.
10. Pouze pro použití u jednoho pacienta. Použití u jiných pacientů může způsobit křížovou infekci.
11. Léky nelze podávat prostřednictvím M-portu, pokud je mezi resuscitátorem a obličejovou maskou připojeno příslušenství (např. filtr, detektor CO₂).
12. M-port po použití nenechávejte otevřený, aby nedošlo k úniku, který by mohl vést ke snížení množství O₂ dodávaného pacientovi.
13. M-port by se neměl používat pro monitorování EtCO₂ metodou sidestream u pacientů ventilovaných méně než 400 ml dechového objemu, aby se předešlo nepřesnému měření EtCO₂.
14. Při podávání léků o objemu nižším než 1 ml je nutné propláchnout M-port pro zajištění přesného dávkování léku.
15. Přívodní hadici kyslíku nepřipojujte k M-portu, neboť pacientovi nebude v takovém případě dodávána požadovaná koncentrace O₂.
16. Přidáním příslušenství se může zvýšit inspirační anebo exspirační odpor. Nepřipojte příslušenství, pokud by zvýšený odpor byl pro pacienta škodlivý.
17. Prostředek smí používat pouze určení uživatelé, kteří jsou obeznámeni s obsahem tohoto návodu, jelikož nesprávné použití může vést k poranění pacienta.
18. Z důvodu nebezpečí požáru nebo výbuchu při použití doplňkového kyslíku nedovolte nikomu kouřit ani používat prostředek v blízkosti otevřeného ohně, olejů, maziv či jiných hořlavých chemikálií anebo zařízení a nástrojů, které mohou způsobit jiskry.
19. Nepokusujte se připojit k verzi pro kojence žádný regulační ventil, jelikož by mohl zapříčinit vysoké koncentrace kyslíku, které mohou být pro novorozence škodlivé.
20. Při použití resuscitátoru připojeného k obličejové masce věnujte pozornost známkám úplné/částečné obstrukce horních cest dýchacích, v jejímž důsledku dochází ke znemožnění nebo omezení dodávky kyslíku. Namísto obličejové masky vždy zvolte jinou alternativu pro nasměrování vzduchu k pacientovi, je-li k dispozici.
21. Vzhledem k riziku insuflace nepoužívejte resuscitátor s připojenou obličejovou maskou při ventilaci kojenců s vrozenou brániční kýlou. Namísto obličejové masky zvolte jinou alternativu pro nasměrování vzduchu k pacientovi, je-li k dispozici.
22. Odborníci provádějící výkon by měli posoudit výběr velikosti resuscitátoru a příslušenství (např. obličejové masky, ventilu PEEP atd.) s přihlédnutím ke specifickému stavu pacienta, neboť nesprávné použití může pacientovi způsobit újmu.
23. Resuscitátor Ambu SPUR II nepoužívejte v případě, kdy je žádoucí dodávka volně proudícího kyslíku, vzhledem k možnému podání nedostatečného množství kyslíku, které může vést k hypoxii.
24. Není-li monitorován tlak, krytka manometru musí být vždy nasazena na portu manometru, aby se předešlo úniku, který může zapříčinit snížení množství O₂ dodávaného pacientovi.
25. Kyslíkovou hadici vždy předem připojte k přívodu kyslíku při teplotě nad 0 °C, jelikož při teplotě nižší než 0 °C může být montáž obtížná, což může vést ke snížení dodávky kyslíku pacientovi.
26. Při použití resuscitátoru s připojenou obličejovou maskou ověřte její správné umístění a těsné přilehnutí k obličeji, neboť netěsnící maska může způsobit šíření infekční nemoci vzadem a nakažení uživatele.

UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy resuscitátor neuchovávejte v deformovaném stavu, s výjimkou složení při dodávce od výrobce, jinak by mohlo dojít k trvalému narušení vakuu, které může snížit účinnost ventilace. Skládací zóna je jasně viditelná na vakuu (pouze verze pro dospělé a děti je možné skládat).
2. Vždy sledujte pohyb hrudníku a poslouchejte, zda z pacientského ventilu vychází exspirární proud, abyste ověřili účinnost ventilace. Okamžitě přejděte k ventilaci z úst do úst, pokud nelze dosáhnout účinné ventilace s resuscitátorem.
3. Zdravotnický prostředek nenamáčejte, neoplachujte ani nesterilizujte, jelikož tyto postupy na něm mohou zanechávat škodlivá rezidua anebo způsobit jeho poruchu. Provedení a použité materiály nejsou kompatibilní s konvenčními postupy čištění a sterilizace.
4. M-port používejte pouze k jednomu ze dvou účelů měření: k měření EtCO₂, nebo k podávání léků. Jinak může dojít k ovlivnění naměřených hodnot.
5. Podle potřeby si přečtěte balení k příslušenství, kde je uvedeno více informací o jednotlivém příslušenství. Nesprávnou manipulací totiž může dojít k poruše prostředku jako celku.
6. Použití výrobků a prostředků pro dodávku kyslíku (např. filtrů a regulačních ventilů) jiných výrobců s resuscitátorem Ambu SPUR II může ovlivnit výkon výrobku. Obratě se na výrobce takového prostředku, abyste si ověřili jeho kompatibilitu s resuscitátorem Ambu SPUR II a získali informace o možných změnách výkonu.
7. Kyslíkový rezervoár je trvale připojen ke vstupnímu ventilu u resuscitátorů pro dospělé a děti s výjimkou verzí s regulačním ventilem. Nepokoušejte se provést demontáž. Netahejte za kyslíkový rezervoár, jelikož by to mohlo mít za následek nesprávnou funkci prostředku.

1.8. Potenciální nepříznivé události

Potenciálními nepříznivými událostmi v souvislosti s resuscitací jsou (mimo jiných): barotrauma, volumotrauma, hypoxie, hyperkapnie a aspirační pneumonie.

1.9. Obecné poznámky

Jestliže v průběhu anebo v důsledku použití tohoto zdravotnického prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému národnímu úřadu.

2. Popis prostředku

Resuscitátor Ambu SPUR II lze připojit k jednorázovému tlakovému manometru Ambu®, ventilům Ambu® PEEP a obličejobým maskám Ambu®, jak je popsáno v části 4.3 Obsluha resuscitátoru.

3. Vysvětlení použitých symbolů

Použitý symbol	Popis
	Dospělí Určená ideální tělesná hmotnost vyšší než 30 kg
	Děti Určená ideální tělesná hmotnost v rozmezí 6 až 30 kg
	Kojenci Určená ideální tělesná hmotnost až 10 kg

Použitý symbol	Popis
	MR přípustný za určitých podmínek
	Země výrobce
	Zdravotnický prostředek
	Určeno k opakovanému použití u jednoho pacienta
	Za kyslíkový rezervoár netahejte silou

Úplný seznam vysvětlivek k symbolům naleznete na adrese <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Použití prostředku

4.1. Princip funkce

Na obrázku 1 je znázorněno, jak při ruční obsluze resuscitátoru směs ventilačního plynu proudí do vaku, z něj do pacienta a zpět. 1a Resuscitátor pro dospělé a děti, 1b resuscitátor pro kojence s uzavřeným kyslíkovým rezervoárem (vakový rezervoár), 1c resuscitátor pro kojence s otevřenou hadicí kyslíkového rezervoáru (hadicový rezervoár).

Proud plynu je podobný, když pacient dýchá přes zařízení spontánně.

Kyslíkový rezervoár je vybaven dvěma ventily, kdy jeden umožňuje nasáti okolního vzduchu, pokud je rezervoár prázdný, a druhý upouští nadbytečný kyslík, pokud je kyslíkový rezervoár plný.

M-port zajišťuje přístup k inspiračnímu a exspiračnímu proudění plynu a umožňuje připojení stříkačky pro podání léků 1d nebo linky pro odběr vzorku plynu za účelem měření EtCO₂ metodou sidestream 1e.

1.1 Uvolnění nadbytečného kyslíku, 1.2 přívod vzduchu, 1.3 přívod kyslíku, 1.4 pacientský konektor, 1.5 exspirace, 1.6 port manometru, 1.7 přetlakový ventil, 1.8 M-port.

POZNÁMKA: K 1.5 lze připojit ochranu před postříkáním nebo ventil PEEP.

4.2. Kontrola a příprava

Resuscitátor je nutné vybalit a připravit pro okamžité použití (včetně provedení testu funkčnosti) před jeho uložením na místo, kde bude připraven k použití v nouzové situaci.

4.2.1. Příprava

- Pokud je resuscitátor zabalen v komprimovaném stavu, rozbalete ho zatažením za pacientský ventil a vstupní ventil.
- Připravte resuscitátor a všechny části uložte do přenosného vaku dodávaného s ním.
- Je-li obličejoval maska dodávaná s resuscitátorem zabalena v ochranném obalu, před použitím by se měl odstranit.

Viz část 4.2.2. (kyslíková hadice) pro přípravu prostředku před použitím při teplotě nižší než 0 °C.

4.2.2. Test funkčnosti 2

Resuscitátor

Zavřete přetlakový ventil pomocí vyřazovací svorky a palcem uzavřete pacientský konektor **2.1**. Krátce stiskněte stlačitelný vak. Resuscitátor musí stlačení odolat.

Otevřete přetlakový ventil odsunutím vyřazovací svorky a postup opakujte. Přetlakový ventil by se měl nyní aktivovat a při krátkém stisknutí stlačitelného vaku by měl být slyšitelný vydechovaný proud vzduchu z ventilu.

Resuscitátor několikrát stlačte a uvolněte, abyste zajistili, že vzduch proudí ventilovým systémem a směrem ven z pacientského ventilu. **2.2**

POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že se lopatky ventilu během testu funkčnosti nebo během ventilace pohybují, může být slyšet slabý zvuk. To nenarušuje funkčnost resuscitátoru.

Kyslíková hadice

Připojení kyslíkové hadice a test funkčnosti kyslíkového rezervoáru a hadice kyslíkového rezervoáru by měly být prováděny při teplotách vyšších než 0 °C. Pro použití resuscitátoru při teplotách nižších než 0 °C ponechte po ukončení testu funkčnosti kyslíkovou hadici připojenou k přívodu kyslíku.

Kyslíkový rezervoár

Zajistěte přívod plynu o průtoku 10 l/min na konektoru přívodu kyslíku. Případně vak rozvíňte pomocí rukou. Ověřte, zda se kyslíkový rezervoár plní. Pokud se neplní, provedte kontrolu integrity dvou ventilových uzávěrů a možných trhlin na kyslíkovém rezervoáru.

Následně upravte průtok přiváděného plynu podle zdravotní indikace.

Hadice kyslíkového rezervoáru

Zajistěte přívod plynu o průtoku 10 l/min na konektoru přívodu kyslíku. Zkontrolujte, že kyslík proudí z konce hadice kyslíkového zásobníku. Pokud ne, zkontrolujte, zda není kyslíková hadice zablokovaná. Následně upravte průtok přiváděného plynu podle zdravotní indikace.

M-port

Odstraňte kryt z M-portu a zablokujte pacientský konektor. Stlačte vak a poslouchejte, zda uslyšíte zvuk vzduchu vytlačovaného přes M-port. **2.3**

4.3. Obsluha resuscitátoru

- Použijte doporučené techniky pro vyčištění úst a uvolnění dýchacích cest pacienta a pro jeho uvedení do správné polohy, abyste zprůchodnili jeho dýchací cesty.

- Masku pevně přiložte na pacientův obličej. **3.1**
- Posuňte svou ruku (verze pro dospělé) nebo prsteník a prostředník (verze pro děti) pod rukojet. Verze pro kojence není vybavena pomocnou rukojetí. Ventilace bez použití pomocné rukojeti lze dosáhnout otočením vaku. **3.2** Ventilace pacienta: Během insuflace sledujte, zda se zvedá hrudník. Rychlým pohybem uvolněte ruku, kterou jste vak svírali, a poslouchejte, zda z pacientského ventilu vychází exspirační proud, a zároveň sledujte, zda klesá hrudník pacienta.
- Pokud se při insuflaci setkáte s trvalým odporem, zkontrolujte, zda nedošlo k obstrukci dýchacích cest a upravte polohu pacienta, abyste zajistili průchodnost dýchacích cest.
- V případě, že během ventilace dojde u pacienta ke zvracení, neprodleně vyčistěte jeho dýchací cesty a před opětovným zahájením ventilace resuscitátorem několikrát zatřeste a opakovaně jej silně stlačte, abyste z něho odstranili zvratky. Podle potřeby prostředek otřete utěrkou s obsahem alkoholu a ochranu před postříkáním opláchněte vodou.

Port manometru

Jednorázový tlakový manometr Ambu i tlakoměry jiných výrobců lze připojit k portu manometru, který se nachází v horní části pacientského ventilu. Odstraňte krytku a připojte manometr/tlakoměr.

Systém omezení tlaku 4

Přetlakový ventil je nastaven tak, aby se otevřel při hodnotě tlaku 40 cm H₂O (4,0 kPa). 4.1

Jestliže je na základně lékařského a odborného posouzení žádoucí, aby tlak byl vyšší než 40 cm H₂O, je možné přetlakový ventil vyřadit posunutím vyřazovací svorky na ventil. 4.2

Alternativně je možné přetlakový ventil vyřadit položením prstu na červené tlačítko při současném stlačování vakuu.

M-port

Resuscitátor Ambu SPUR II je dodáván s M-portem nebo bez něj. M-port zajišťuje přístup k inspiračnímu a exspiračnímu proudění plynu a po připojení stříkačky ho lze použít k podání léků nebo k měření CO₂ metodou sidestream (EtCO₂). Pokud M-port nepoužíváte, nezapomeňte jej uzavřít červenou krytkou.

Měření EtCO₂

Pro měření EtCO₂ metodou sidestream připojte linku pro odběr vzorku plynu přístroje pro měření EtCO₂ k M-portu resuscitátoru Ambu SPUR II. Konektor linky pro odběr vzorku plynu připojte a otoče o ¼ proti směru chodu hodinových ručiček.

Podávání léků

Pozorně sledujte reakci pacienta na podávaný lék. Podávané objemy 1 ml tekutiny nebo vyšší prostřednictvím M-portu jsou srovnatelné s podáváním přímo do endotracheální rourky. M-port byl testován s epinefrinem, lidokainem a atropinem.

Verze resuscitátoru Ambu SPUR II s regulačním ventilem 5

Verze resuscitátoru Ambu SPUR II s regulačním ventilem je k dispozici pro velikostní kategorie dospělých a dětí, je možné ji použít s regulačním ventilem nebo bez něj a je dodávána s připojiteľným kyslíkovým rezervoárem.

Vstupní ventil resuscitátoru Ambu SPUR II se připojuje k regulačnímu ventilu pomocí adaptéra.

Připojení regulačního ventilu:

- Odpojte jednotku kyslíkového rezervoáru od vstupního ventilu resuscitátoru Ambu SPUR II, je-li připojena.
- Připojte adaptér k systému regulačního ventilu.
- Adaptér regulačního ventilu zasuňte do vstupního ventilu resuscitátoru Ambu SPUR II.

POZNÁMKA: S adaptérem a regulačním ventilem použijte pouze díl označený jako „kompresní jednotka“. Díl označený jako „kyslíkový rezervoár“ je považován za záložní pro případ poruchy regulačního ventilu.

Podávání kyslíku

Kyslík podávejte dle zdravotních indikací.

V tabulce 6 je uvedeno vypočtené procentuální množství dodávaného kyslíku, jehož lze dosáhnout s různými ventilačními objemy a frekvencemi při různých průtocích plynu.

Procentuální množství kyslíku je uvedeno v tabulce 6 : pro dospělé 6.1, děti 6.2 a kojence 6.3.

Kyslíkový rezervoár 7

Tenkou plastovou fólií kyslíkového rezervoáru nelze nikdy oddělit od resuscitátoru v místě jejího upevnění.

Příslušenství 8

Konektory resuscitátoru Ambu SPUR II splňují požadavky norem ISO 5356-1 a EN 13544-2 a jsou tak kompatibilní s jiným nemocničním vybavením. Připojujete-li k resuscitátoru externí zařízení, zkontrolujte funkčnost a řídte se návodem k použití dodaným s externím zařízením.

Výrobky Ambu kompatibilní s resuscitátorem Ambu SPUR II jsou uvedeny níže:

Jednorázová obličejobavá maska Ambu®

Další informace najeznete v návodu k použití jednorázové obličejobavé masky Ambu.

Jednorázový ventil Ambu® PEEP 20 8.1 8.2

Další informace najeznete v návodu k použití jednorázového ventilu Ambu PEEP 20, nebo se podívejte na obrázek 8.1 v tomto návodu k použití. Před připojením jednorázového ventilu Ambu PEEP 20 (je-li zapotřebí) k resuscitátoru nejprve odstraňte ochranu před postříkáním. 8.2

Jednorázový tlakový manometr Ambu® 8.3

Další informace najeznete v návodu k použití jednorázového tlakového manometru Ambu.

4.4. Po použití

Použité prostředky musí být zlikvidovány v souladu s místními postupy.

5. Technické specifikace prostředku

5.1. Použité normy

Resuscitátor Ambu SPUR II je v souladu se specifickou produktovou normou EN ISO 10651-4.

5.2. Specifikace

	Kojenci	Děti	Dospělí
Objem resuscitátoru	cca 220 ml	cca 670 ml	cca 1 510 ml
Objem podaný jednou rukou*	150 ml	450 ml	600 ml
Objem podaný dvěma rukama*	–	–	1 000 ml
Rozměry (délka x průměr) bez rezervoáru a příslušenství	cca 190 x 71 mm	cca 223 x 99 mm	cca 284 x 127 mm
Hmotnost bez rezervoáru a příslušenství	cca 70 g	cca 145 g	cca 220 g
Přetlakový ventil**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Mrtvý prostor	≤ 5 ml + 10 % podaného objemu	≤ 5 ml + 10 % podaného objemu	≤ 5 ml + 10 % podaného objemu
Inspirační odpor***	max. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) při 5 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) při 50 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) při 50 l/min
Exspirační odpor***	max. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) při 5 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) při 50 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) při 50 l/min

	Kojenci	Děti	Dospělí
Objem rezervoáru	cca 300 ml (vak) cca 100 ml (trubice)	cca 2 600 ml (vak)	cca 2 600 ml (vak)
Pacientský konektor	Zevní 22 mm samec (ISO 5356-1) Vnitřní 15 mm samice (ISO 5356-1)		
Exspiráční konektor (pro připojení ventilu PEEP)	30 mm samec (ISO 5356-1)		
Krytka portu manometru	\varnothing 4,2 +/-0,1 mm		
Konektor regulačního ventilu	-	Vnitřní 32 mm samice (ISO 10651-4)	
Netěsnost dopředu a dozadu	Neměřitelná		
M-port	Konektor kompatibilní s EN ISO 80369-7		
Vstupní konektor O ₂	V souladu s EN 13544-2		
Limity provozní teploty	-18 až +50 °C (-0,4 až +122 °F), testováno v souladu s EN ISO 10651-4		
Limity teploty skladování	-40 až +60 °C (-40 až +140 °F), testováno v souladu s EN ISO 10651-4		
Pro dlouhodobé skladování je doporučeno uchovávat prostředek v uzavřeném obalu při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního záření.			

* Testováno dle normy EN ISO 10651-4.

** Vyššího přívodního tlaku je možné dosáhnout vyřazením přetlakového ventilu.

*** Při obecných zkušebních podmínkách dle normy EN ISO 10651-4.

5.3. Informace o bezpečnosti pro MR



Resuscitátory Ambu SPUR II¹, Ambu SPUR II s připojeným jednorázovým ventilem Ambu PEEP 20² a Ambu SPUR II s připojeným jednorázovým ventilem Ambu PEEP 20 a jednorázovým tlakovým manometrem Ambu² jsou MR přípustné za určitých podmínek, a mohou tudíž být bezpečně používány v prostředí MR (nikoli uvnitř tunelu přístroje MR) za následujících podmínek.

Statické magnetické pole 7 tesel nebo méně

- Maximální prostorový gradient magnetického pole
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Maximální síla výrobku
 - 450 000 000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G2/cm (721 T²/m)²

Použití uvnitř tunelu přístroje MR může ovlivnit kvalitu zobrazení pomocí magnetické rezonance.

Zahřívání vyvolané vysokými frekvencemi a artefakty zobrazení pomocí magnetické rezonance nebyly testovány. Všechny kovové části jsou plně zapouzdřené a nepřicházejí do kontaktu s lidským tělem.

1. Vigtig information – Læs inden brug

Læs disse sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, inden Ambu® SPUR® II genoplivningspose tages i brug. Denne brugervejledning kan blive opdateret uden varsel. Eksemplarer af den aktuelle version fås ved henvendelse. Vær opmærksom på, at denne brugervejledning ikke forklarer eller forholder sig til kliniske procedurer. Den indeholder kun en beskrivelse af den grundlæggende betjening af genoplivningsposen og de dermed forbundne forholdsregler. Før genoplivningsposen tages i brug, er det vigtigt, at operatøren er blevet behørigt instrueret i de kliniske genoplivningsteknikker og er fortrolig med den tilsigtede anvendelse, de advarsler, forholdsregler og indikationer, som er anført i denne brugsanvisning. Der er ingen garanti på Ambu SPUR II genoplivningspose.

1.1. Tilsigtet anvendelse

Ambu SPUR II genoplivningspose er en genoplivningspose til enkeltpatientbrug beregnet til pulmonal genoplivning.

1.2. Indikationer for anvendelse

Ambu SPUR II genoplivningsposen er beregnet til brug i situationer, hvor der er behov for en manuel kardio-pulmonal genoplivningspose til assisteret ventilation.

Ambu SPUR II genoplivningsposen er indiceret til ventilation og oxygenering af patienter, indtil der kan etableres en mere definitiv luftvej, eller patienten er kommet sig.

1.3. Tilsigtet patientpopulation

Omfangen af størrelser for de enkelte versioner i sortimentet er som følger:

- Voksne:** Voksne og børn med en kropsvægt på mere end 30 kg (66 lbs.).
- Børn:** Spædbørn og børn med en kropsvægt fra 6 kg til 30 kg (13 - 66 lb).
- Spædbørn:** Nyfødte og spædbørn med en kropsvægt på højst 10 kg (22 lbs).

Bemærk, at ikke alle konfigurationer for Ambu SPUR II genoplivningspose er tilgængelige for alle tre patientområder.

1.4. Tilsigtede brugere

Læger, der er uddannet i luftvejhåndtering, såsom anæstesiologer, sygeplejersker, redningspersonale og redningspersonale.

1.5. Kontraindikationer

Ingen kendte.

1.6. Kliniske fordele

Den grundlæggende teknik til luftvejhåndtering ved hjælp af en manuel genoplivningspose giver mulighed for ventilation og oxygenering af patienter, indtil der kan etableres en mere definitiv luftvej, eller patienten er kommet sig.

1.7. Advarsler og forsigtighedsregler

Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan medføre utilstrækkelig ventilation og oxygenering af patienten eller beskadigelse af udstyret.

ADVARSLER

1. Genoplivningsposen må ikke anvendes i mere end 4 akkumulerede timer over et maksimalt tidsrum på 1 uge for at undgå risiko for infektion.
2. Genanvend ikke genoplivningsposen, hvis der er synlig fugt eller synlige rester inde i udstyret, for at undgå risiko for infektion og funktionsfejl.
3. Sørg for, at enten stænkskærmene eller Ambu PEEP-ventilen er tilsluttet eksspirationsporten. En åben eksspirationsport kan ved et uheld blive blokeret og resultere i for stort luftvolumen i lungerne, hvilket kan føre til vævstraume.
4. Undgå brug af genoplivningsposen i giftige eller farlige miljøer for at undgå risiko for vævsskade.

5. Sørg altid for, at oxygenreservoirlangen ikke er blokeret, da blokering af slangen kan forhindre kompressionsposen i at blive pustet op igen, hvilket kan medføre, at ventilation ikke er mulig.
6. Produktet må ikke anvendes, hvis det er forurennet fra eksterne kilder, da dette kan forårsage infektion.
7. Kontrollér altid produktet visuelt, og udfør en funktionstest efter udpakning, samling og før brug, da defekter og fremmedlegemer kan føre til ingen eller nedsat ventilation af patienten.
8. Brug ikke produktet, hvis funktionstesten mislykkes, da dette kan føre til ingen eller reduceret ventilation.
9. Tisidesæt aldrig trykbegrænsningsventilen, medmindre en lægelig vurdering viser, at det er nødvendigt. Høje ventilationstryk kan forårsage barotraume.
10. Kun til engangsbrug. Hvis udstyret anvendes til flere patienter, kan det medføre krydsinfektion.
11. Medicin kan ikke leveres gennem M-porten, hvis tilbehør (f.eks. filter, CO₂-detektor) tilsluttes mellem genoplivningsposen og ansigtmasken.
12. Efterlad ikke M-porten åben efter brug for at undgå lækage, hvilket kan medføre reduceret O₂-levering til patienten.
13. M-porten må ikke anvendes til overvågning af sidestream EtCO₂ hos patienter, der ventileres med et tidalvolumen på mindre end 400 ml for at undgå unøjagtige EtCO₂-målinger.
14. Ved administration af medicin med et volumen under 1 ml er det nødvendigt at skylle M-porten for at sikre, at medicindoseringen er nøjagtig.
15. Tilslut ikke oxygenforsyningsslangen til M-porten, da den tilsigtede O₂-koncentration ikke leveres til patienten.
16. Ved at tilføje tilbehør kan indåndings- og/eller eksspirationsmodstanden forhøjes. Tilslut ikke tilbehør, hvis forhøjet vejtrækningsmodstand kan være skadeligt for patienten.
17. Må kun anvendes af tilsigtede brugere, der er fortrolige med indholdet i denne vejledning, da forkert anvendelse kan skade patienten.
18. Når der anvendes supplerende oxygen, må der ikke ryges, og udstyret må ikke bruges i nærheden af åben ild, olie, fedt, andre brændbare kemikalier eller udstyr og værktøj, der forårsager gnister, på grund af risikoen for brand og/eller ekspllosion.
19. Forsøg ikke at tilslutte en lungeautomat til spædbarnsversionen, da dette kan forårsage høje oxygenkoncentrationer, som kan være skadelige for nyfødt.
20. Vær opmærksom på tegn på komplet/delvis øvre luftvejsobstruktion ved brug af genoplivningsposen fastgjort til en ansigtmaske, da dette vil medføre ingen eller begrænset oxygentilførsel. Skift altid til et alternativ til brug af en ansigtmaske til at dirigere luft til patienten, hvis et sådan er tilgængelig.
21. Anvend ikke produktet med påsat ansigtmaske ved ventilation af spædbørn med medfødt diafragmamaherie på grund af risikoen for insufflation. Skift til et alternativ til brug af en ansigtmaske til at dirigere luft til patienten, hvis et sådan er tilgængelig.
22. Fagfolk, der udfører proceduren, skal vurdere valget af genoplivningsposens størrelse og tilbehør (f.eks. ansigtmaske, PEEP-ventil osv.) i overensstemmelse med patientens specifikke tilstand(e), da forkert anvendelse kan skade patienten.
23. Ambu SPUR II må ikke anvendes, når der er behov for tilførsel af frit flow-oxygen, da der kan være utilstrækkelig administration af oxygen, hvilket kan medføre hypoksi.
24. Manometerhætten skal altid sættes på manometerporten, når trykket ikke overvåges, for at undgå lækage, hvilket kan medføre reduceret O₂-levering til patienten.
25. Oxygensslangen skal altid fortillsluttet oxygenforsyningen ved temperaturer over 0 °C, da monteringen kan blive vanskelig ved temperaturer under 0 °C, hvilket reducerer oxygentilførslen til patienten.
26. Ved brug af genoplivningsposen med påsat ansigtmaske skal det sikres, at ansigtmasken placeres og forsegles korrekt, da forkert forsegling kan medføre spredning af luftbåren infektionssygdom til bruger.

FORSIGTIGHEDSREGLER

1. Genoplivningsposen må aldrig opbevares i deformert tilstand, medmindre den er foldet som ved levering fra producenten. Ellers kan posen blive forvredet permanent, hvilket kan reducere ventilationseffektiviteten. Foldezonene ses tydeligt på posen (kun versioner til voksne og paediatrisk må foldes).
2. Hold altid øje med brystkassens bevægelse, og lyt efter udåndingsflow fra patientventilen for at kontrollere ventilationens effekt. Skift straks til mund-til-mund-ventilation, hvis ventilation med genoplivningsposen ikke kan opnås.
3. Udstyret må ikke lægges i væske, skylles eller steriliseres, da det kan efterlade skadelige rester eller forårsage fejlfunktion. Uformning og materiale egner sig ikke til traditionelle rengørings- og sterilisationsmetoder.
4. Brug kun M-porten til den ene af de to; EtCO₂-måling eller medicinindgivelse, da dette kan ændre de målte værdier.
5. Hvis det er relevant, henvises der til tilbehørets emballage for mere specifikke oplysninger om det enkelte tilbehør, da forkert håndtering kan medføre funktionsfejl af hele produktet.
6. Brug af tredjepartsprodukter og oxygentilførselsenheder (f.eks. filtre og lungeautomater) med Ambu SPUR II genoplivningsposen kan påvirke produktets ydeevne. Kontakt producenten af tredjepartsenheden for at bekraeftе kompatibilitet med Ambu SPUR II genoplivningsposen og få oplysninger om de mulige ydelsesændringer.
7. Oxygenreservoirposen er permanent fastgjort til indgangsventilen på genoplivningsposen til voksne og paediatriske patienter, undtagen udgaver med lungeautomat. Prøv ikke at skille dem ad. Træk ikke i oxygenreservoirposen, da det kan medføre fejlfunktion af enheden.

1.8. Potentielle utilsigtede hændelser

Potentielle utilsigtede hændelser relateret til genoplivning (ikke udtømmende): barotraume, volutraume, hypoxi, hyperkarbi og aspirationspneumoni.

1.9. Generelle bemærkninger

Hvis der sker en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som resultat af brugen af den, bedes det indberettet til producenten og til den nationale myndighed.

2. Beskrivelse af udstyret

Ambu SPUR II genoplivningsposen kan sluttet til Ambu® engangsmanometer, Ambu® PEEP Valves og Ambu® Face masks som beskrevet i afsnit 4.3 Betjening af genoplivningsposen.

3. Symbolforklaring

Symbolangivelse	Beskrivelse
	Voksne Tilsigtet ideel kropsvægt over 30 kg
	Børn Tilsigtet ideel kropsvægt fra 6 til 30 kg
	Spædbørn Tilsigtet ideel kropsvægt op til 10 kg
	Betinget egnet til MR
	Producentland

Symbolangivelse	Beskrivelse
	Medicinsk udstyr
	Multipel brug til en enkelt patient
	Træk ikke i oxygenreservoirposen med magt

En komplet liste over symbolforklaringer kan findes på
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Anvendelsesområde

4.1. Principper for drift

Illustrationen 1 viser blandingerne af ventilationsgasflow ind i posen og til og fra patienten under manuel betjening af genoplivningsposen. 1a Genoplivningspose til voksne og børn, 1b genoplivningspose til spædbørn med lukket oxygenreservoirpose (reservoirpose), 1c genoplivningspose til spædbørn med åben oxygenreservoirslange (slangereservoir).

Gastilførslen er den samme, når patienten trækker vejret spontant igennem udstyret.

Oxygenreservoirtet er udstyret med to ventiler, hvoraf den ene lader omgivende luft blive suget ind, når beholderen er tom, og den anden tilfører ekstra oxygen, når oxygenreservoirposen er fyldt.

M-porten giver adgang til inspirations- og ekspirationsgasflowet, så det er muligt at tilslutte en sprøjte til indgivelse af medicin 1d eller at tilslutte en gassamplingsslange til måling af sidestream EtCO₂ 1e.

1.1 Overskydende oxygenfrigivelse, 1.2 Luftindgang, 1.3 Oxygenindgang, 1.4 Patientkonnektør, 1.5 Eksspiration, 1.6 Manometerport, 1.7 trykbegrænsningsventil, 1.8 M-port.

BEMÆRK: fastgørelse til 1.5 kan enten være en stænkskærm eller en PEEP-ventil.

4.2. Inspektion og forberedelse

Genoplivningsposen skal pakkes ud og klargøres (inklusiv funktionstest) til øjeblikkelig brug, før den anbringes klar til brug i nødsituationer.

4.2.1. Klargøring

- Hvis genoplivningsposen er pakket i sammenpresset tilstand, foldes den ud ved at trække i patientventilen og indgangsventilen.
- Klargør genoplivningsposen, og læg alle genstande i den bæretaske, der følger med genoplivningsposen.
- Hvis ansigtsmasken, der leveres sammen med genoplivningsposen, er pakket ind i en beskyttelsespose, skal posen fjernes før brug.

Se afsnit 4.2.2. (Oxygenslange) til klargøring af udstyret før brug ved under 0 °C.

4.2.2. Funktionstest 2

Genoplivningspose

Luk trykbegrænsningsventilen med lukkehætten, og luk patientkonnektoren med tommelfingeren 2.1. Tryk hurtigt på den komprimerbare pose. Genoplivningsposen skal kunne modstå trykket.

Åbn trykbegrænsningsventilen ved at skubbe lukkehætten væk og gentage proceduren. Trykbegrænsningsventilen bør nu være aktiveret, og det skal være muligt at høre flowet fra ventilen under hurtig kompression af den komprimerbare pose.

Tryk på genoplivningsposen og slip den igen nogle gange for at sikre, at luften strømmer igennem ventilsystemet og ud igennem patientventilen. **2.2**

BEMÆRK: Der kan komme en smule lyd, når ventiklapperne bevæger sig under funktionstest eller ventilation. Dette påvirker ikke genoplivningsposens funktion.

Oxygenslange

Montering af oxygenslangen og funktionstest af oxygenreservoirposen og oxygenreservoirslangen skal udføres ved temperaturer over 0 °C. Ved brug af genoplivningsposen ved temperaturer under 0 °C skal oxygenslangen forblive tilsluttet oxygenforsyningen efter funktionstesten.

Oxygenreservoirpose

Tilfør et gasflow på 10 l/min ved oxygenindgangskonnektoren. Til sidst foldes posen ud med hånden. Kontrollér, at oxygenreservoirposen fyldes. Hvis ikke, skal du kontrollere de to ventillukkeres integritet, eller om oxygenreservoaret er utæt.

Juster derefter det tilførte gasflow i henhold til den medicinske indikation.

Oxygenreservoirslange

Tilfør et gasflow på 10 l/min ved oxygenindgangskonnektoren. Kontroller, at der strømmer oxygen ud for enden af oxygenreservoirslangen. Hvis ikke skal du kontrollere, om oxygenslangen er blokeret. Juster derefter det tilførte gasflow i henhold til den medicinske indikation.

M-port

Tag M-port-hætten af, og bloker patientkonnektoren. Tryk på posen, og lyt efter lyden af luft, der bliver presset ud igennem M-porten. **2.3**

4.3. Betjening af genoplivningsposen

- Brug anbefalede teknikker til at rense patientens mund og luftveje og til at placere patienten korrekt for at åbne luftvejene.
- Hold ansigtmasken fast mod patientens ansigt. **3.1**
- Hold hånden (voksenversion) eller ring- og langefinger (pædiatrisk version) under håndtaget. Spædbørnsversionen har ikke et støttehåndtag.
Ventilation uden brug af støttehåndtaget kan opnås ved at vende posen. **3.2**
Ventilation af patienten: Under insufflationen skal der holdes øje med, om brystkassen hæver sig. Giv hurtigt slip med hånden, der holder posen, og lyt efter udånding fra patientventilen, og hold desuden øje med, at brystkassen sænker sig synligt.
- Hvis der mødes fortsat modstand mod insufflation, skal luftvejene kontrolleres for obstruktion, og patienten skal positioneres på ny for at sikre, at luftvejene er åbne.
- Hvis patienten kaster op under ventilation, skal patientens luftveje straks rengøres, og opkastet skal fjernes fra genoplivningsposen ved at ryste og komprimere den kraftigt og hurtigt flere gange, før ventilationen genoptages.
Tør om nødvendigt produktet af med en klud, der indeholder sprit, og rengør stænkskærmen med vand.

Manometerport

Ambu engangstrykmåler samt tredjepartstrykmåler kan tilsluttes manometerporten, der er placeret oven på patientventilen. Tag hætten af, og monter manometeret/trykmåleren

Trykbegrænsningssystem **4**

Trykbegrænsningsventilen er indstillet til at åbne ved 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Hvis en medicinsk og professionel vurdering viser, at et tryk over 40 cm H₂O er påkrævet, kan trykbegrænsningsventilen omgås ved at flytte lukkehætten over på ventilen. **4.2**

Alternativt kan trykbegrænsningsventilen omgås ved at sætte en finger på den røde knap, mens posen klemmes.

M-port

Ambu SPUR II genoplivningsposen leveres enten med eller uden M-port. M-porten giver adgang til det inspiratoriske og eksspiratoriske gasflow og kan bruges til applicering af medicin, hvor den er tilsluttet en sprøjte, og kan også bruges til at måle sidestream CO_2 (EtCO_2). Husk at lukke M-porten med den røde hætte til M-porten, når den ikke er i brug.

Måling af EtCO_2

Til måling af sidestrom EtCO_2 : Slut gassamplingsslangen til EtCO_2 -måleapparatet til M-porten på Ambu SPUR II genoplivningsposen. Tilslut gassamplingsslangens konnektør ved at montere den og dreje den 1/4 omgang med uret.

Indgivelse af medicin

Patientens reaktion på den administrerede medicin skal observeres nøje. Indgivelse af væskemængder på 1 ml eller derover via M-porten kan sammenlignes med administration direkte i en endotrakealtube. M-porten er testet med efedrin, lidokain og atropin.

Lungeautomatversion af Ambu SPUR II genoplivningspose 5

Ambu SPUR II genoplivningsposer i lungeautomatversionen fås i størrelser til voksne og paediatriske patienter og kan anvendes enten med eller uden lungeautomat. Den leveres med en påsat oxygenreservoirpose.

Indgangsventilen på Ambu SPUR II genoplivningsposen tilsluttes lungeautomaten via en adapter.

Fastgørelse af lungeautomaten:

- Fjern oxygenreservoirenheden fra Ambu SPUR II genoplivningsposens indgangsventil, hvis den er tilsluttet.
- Fastgør adapteren til lungeautomatsystemet.
- Sæt lungeautomatadapteren i Ambu SPUR II genoplivningsposens indgangsventil.

BEMÆRK: Brug kun delen mærket "kompressionsenhed" med adapter og lungeautomat. Den del, der er mærket "Oxygenreservoirpose", betragtes som backup, hvis lungeautomaten sviger.

Oxygenadministration

Administrer oxygen i overensstemmelse med den medicinske indikation.

Figur 6 viser Beregnede leverede oxygenprocenter, som kan opnås med forskellige ventilationsvolumener og -frekvenser ved forskellige gasflowhastigheder.

Oxygenprocenterne kan ses i 6 Voksen, 6.1 Paediatric, 6.2 Spædbarn 6.3.

Oxygenreservoirpose 7

Den tynde oxygenreservoirposes plastfolie kan ikke på noget tidspunkt løsnes fra dens fikseringspunkt til genoplivningsposen.

Tilbehør 8

Ambu SPUR II genoplivningsposens konnektorer overholder ISO 5356-1 og EN 13544-2 og er dermed i overensstemmelse med andet hospitalsudstyr. Hvis der tilsluttes eksterne enheder, så husk at teste funktionaliteten og se brugervejledningen til den eksterne enhed.

Ambu produkter, der er kompatible med Ambu SPUR II genoplivningspose, er anført nedenfor:

Ambu® Disposable Face Mask

Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen til Ambu Disposable Face Mask.

Ambu® Disposable PEEP20-ventil 8.1 8.2

Yderligere oplysninger kan findes i brugsanvisningen til Ambu Disposable PEEP 20-ventil eller i illustrationen 8.1 i denne brugsanvisning. For at montere Ambu Disposable PEEP 20-ventil (om nødvendigt) på genoplivningsposen fjernes stænkskærmens 8.2

Ambu® Disposable Pressure Manometer 8.3

Yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen til Ambu engangstrykmåler.



4.4. Efter brug

Brugte produkter skal bortskaffes i henhold til lokale procedurer.

5. Tekniske produktspecifikationer

5.1. Anvendte standarder

Ambu SPUR II genoplivningsposen opfylder kravene i den produktspecifikke standard EN ISO 10651-4.

5.2. Specifikationer

	Spædbørn	Børn	Voksne
Genoplivningsposens volumen	ca. 220 ml	ca. 670 ml	ca. 1510 ml
Tilført volumen med én hånd*	150 ml	450 ml	600 ml
Tilført volumen med to hænder*	-	-	1000 ml
Dimensioner (længde x diameter) uden reservoir og tilbehør	ca. 190 x 71 mm	ca. 223 x 99 mm	ca. 284 x 127 mm
Vægt uden beholder og tilbehør	ca. 70 g	ca. 145 g	ca. 220 g
Trykbegrænsningsventil**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Dead space	≤ 5 ml + 10 % af det tilførte volumen	≤ 5 ml + 10 % af det tilførte volumen	≤ 5 ml + 10 % af det tilførte volumen
Inspirationsmodstand***	maks. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) ved 5 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) ved 50 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) ved 50 l/min

	Spædbørn	Børn	Voksne
Eksspirationsmodstand***	maks. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) ved 5 l/min	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) ved 50 l/min	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) ved 50 l/min
Reservoirvolumen	ca. 300 ml (pose) ca. 100 ml (slange)	ca. 2600 ml (pose)	ca. 2600 ml (pose)
Patientkonnektor	Udvendigt, 22 mm han (ISO 5356-1) Indvendigt, 15 mm hun (ISO 5356-1)		
Eksspirationskonnektor (til PEEP-ventilforbindelse)	30 mm hanstik (ISO 5356-1)		
Konnektor til manometerport	Ø 4,2 +/- 0,1 mm		
Lungeautomatkonnektor	-	Indvendigt, 32 mm hun (ISO 10651-4)	
Lækage fremad og bagud	Kan ikke måles		
M-port	Konnektor kompatibel med EN ISO 80369-7		
O ₂ -indgangskonnektor	I henhold til EN 13544-2		
Driftstemperaturbegrænsninger	-18 °C til +50 °C (-0,4 °F til +122 °F), testet i overensstemmelse med EN ISO 10651-4		
Opbevaringstemperaturbegrænsninger	-40 °C til +60 °C (-40 °F til +140 °F), testet i overensstemmelse med EN ISO 10651-4		
Anbefalet langtidsopbevaring i lukket emballage ved stuetemperatur, beskyttet mod sollys.			

* Testet i henhold til EN ISO 10651-4.

** Det er muligt at opnå et højere indblæsningstryk ved at omgå trykbegrænsningsventilen.

*** Ved generelle testforhold i henhold til EN ISO 10651-4.

5.3. MR-sikkerhedsoplysninger



Ambu SPUR II genoplivningspose¹ og Ambu SPUR II genoplivningspose med påsat Ambu Disposable PEEP 20 Valve² og Ambu SPUR II genoplivningspose med påsat Ambu Disposable PEEP 20 Valve og Ambu engangstrykmåler² er betinget MR-egnet og kan derfor anvendes sikkert i MR-miljøet (ikke inden for MR-åbningen) under følgende forhold.

Statisk magnetfelt på 7 Tesla og mindre, med

- Maks. rumlig feltgradient på
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²
- Maks. kraftprodukt af
 - 450.000.000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G²/cm (721 T²/m)²

Anvendelse inde i MR-åbningen kan påvirke MR-billedkvaliteten.

RF-induceret opvarmning og MR-billedartefakter er ikke blevet testet. Alle metaldele er fuldt indkapslede og har ingen kontakt med menneskekroppen.

1. Wichtige Informationen – Vor Verwendung lesen

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Ambu® SPUR® II Beatmungsbeutel verwenden. Die Bedienungsanleitung kann ohne besondere Benachrichtigung aktualisiert und ergänzt werden. Die aktuelle Version ist auf Anfrage erhältlich. In der hier vorliegenden Anleitung werden keine klinischen Verfahren erläutert oder behandelt. Sie beschreiben ausschließlich die grundlegenden Schritte und Vorsichtsmaßnahmen zur Bedienung des Beatmungsbeutels. Vor dem ersten Einsatz des Beatmungsbeutels ist es unerlässlich, dass der Bediener des Geräts über ausreichend Erfahrung mit Reanimationstechniken verfügt und mit der Zweckbestimmung und den Warnhinweisen, Sicherheitshinweisen und Indikationen in der vorliegenden Anleitung vertraut ist. Für den Ambu SPUR II Beatmungsbeutel wird keine Gewährleistung gegeben.

1.1. Zweckbestimmung

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel ist zur Beatmung bestimmt und für die Nutzung an einem Patienten (Single Patient Use) geeignet.

1.2. Indikationen

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel ist für den Einsatz in Situationen vorgesehen, in denen ein manueller Beatmungsbeutel zur Herz-Lungen-Wiederbelebung für die assistierte Beatmung benötigt wird.

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel ist für die Beatmung und Sauerstoffversorgung von Patienten indiziert, bis der Atemweg gesichert werden kann oder der Patient sich erholt hat.

1.3. Vorgesehene Patientengruppe

Größenbereich der Anwendung für jede Ausführungsform:

- Erwachsene:** Erwachsene und Kinder mit einem Körpergewicht von mehr als 30 kg.
- Kinder** Säuglinge und Kinder mit einem Körpergewicht von 6 kg bis 30 kg.
- Säuglinge:** Neugeborene und Säuglinge mit einem Körpergewicht von bis zu 10 kg.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Konfigurationen des Ambu SPUR II Beatmungsbeutels für alle drei Patientenbereiche verfügbar sind.

1.4. Vorgesehene Anwender

Medizinische Fachkräfte, die im Atemwegsmanagement geschult sind, wie Anästhesisten, Pflegepersonal, Rettungspersonal und Notfallpersonal.

1.5. Kontraindikationen

Keine bekannt.

1.6. Klinische Vorteile

Die grundlegende Atemwegsmanagementtechnik mit einem manuellen Beatmungsbeutel ermöglicht die Beatmung und Sauerstoffversorgung von Patienten, bis der Atemweg gesichert werden kann oder der Patient sich erholt hat.

1.7. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Ein Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise kann zu einer unzureichenden Beatmung und Sauerstoffversorgung des Patienten oder zu einer Beschädigung der Ausrüstung führen.

WARNHINWEISE

1. Verwenden Sie den Beatmungsbeutel nicht länger als 4 kumulierte Stunden über einen Zeitraum von maximal 1 Woche, um das Risiko einer Infektion zu vermeiden.
2. Verwenden Sie den Beatmungsbeutel nicht wieder, wenn sichtbare Feuchtigkeit oder Rückstände im Gerät zurückbleiben, um das Risiko einer Infektion und Fehlfunktion zu vermeiden.
3. Stellen Sie sicher, dass entweder der Spritzschutz oder das Ambu PEEP-Ventil am Exspirationsanschluss angeschlossen ist. Ein offener Exspirationsanschluss kann versehentlich blockiert werden und zu einem übermäßigen Luftvolumen in der Lunge führen, was zu Gewebetraumata führen kann.
4. Vermeiden Sie die Verwendung des Beatmungsbeutels in toxischen oder gefährlichen Umgebungen, um das Risiko von Gewebeschäden zu vermeiden.

- 5. Achten Sie immer darauf, dass der Sauerstoffreservoirschlauch nicht blockiert ist, da ein Blockieren des Schlauchs das Wiederbefüllen des Kompressionsbeutels verhindern kann, was dazu führen kann, dass keine Beatmung möglich ist.
- 6. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es durch externe Quellen kontaminiert ist, da dies zu Infektionen führen kann.
- 7. Führen Sie nach dem Auspacken, der Montage und vor der Verwendung immer eine Sichtprüfung des Produkts und einen Funktionstest durch, da Defekte und Fremdkörper dazu führen können, dass der Patient unzureichend oder gar nicht beatmet wird.
- 8. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Funktionstest fehlschlägt, da dies dazu führen kann, dass der Patient unzureichend oder gar nicht beatmet wird.
- 9. Umgehen Sie das Druckbegrenzungsventil nur dann, wenn es medizinisch notwendig ist. Einer zu hoher Beatmungsdruck kann ein Barotrauma verursachen.
- 10. Nur zum einmaligen Gebrauch (Single Patient Use). Eine Wiederverwendung bei anderen Patienten kann zu einer Kreuzinfektion führen.
- 11. Medikamente können nicht über den M-Port abgegeben werden, wenn Zubehör (z. B. Filter, CO₂-Detektor) zwischen Beatmungsbeutel und Gesichtsmaske angeschlossen ist.
- 12. Lassen Sie den M-Port nach der Verwendung nicht offen, um Leckagen zu vermeiden, die zu einer reduzierten O₂-Zufuhr zum Patienten führen können.
- 13. Der M-Port sollte nicht zur EtCO₂-Messung im Seitenstromverfahren verwendet werden, wenn der Patient mit weniger als 400 ml Tidalvolumen beatmet wird, um ungenaue EtCO₂-Messungen zu verhindern.
- 14. Bei der Verabreichung von Medikamenten mit einem Volumen von weniger als 1 ml muss der M-Port gespült werden, um eine genaue Medikamentendosierung zu gewährleisten.
- 15. Schließen Sie die Sauerstoffversorgungsleitung nicht an den M-Port an, da die vorgesehene O₂-Konzentration nicht an den Patienten abgegeben wird.
- 16. Die zusätzliche Verwendung von Zubehör kann den expiratorischen und/oder inspiratorischen Widerstand erhöhen. Schließen Sie kein Zubehör an, wenn ein erhöhter Atemwiderstand nachteilig für den Patienten wäre.
- 17. Darf nur von Anwendern verwendet werden, die mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut sind, da ein unsachgemäßer Gebrauch den Patienten schädigen kann.
- 18. Wenn Sie zusätzlichen Sauerstoff verwenden, dürfen Sie nicht rauchen oder das Gerät in der Nähe von offenem Feuer, Öl, Fett, anderen entflammbaren Chemikalien oder Geräten und Werkzeugen verwenden, die Funken erzeugen, da Brand- und/oder Explosionsgefahr besteht.
- 19. Versuchen Sie nicht, ein Demandventil an die Säuglingsversion anzuschließen, da dies zu hohen Sauerstoffkonzentrationen führen kann, die für Neugeborene schädlich sein können.
- 20. Achten Sie auf Anzeichen einer vollständigen/teilweisen Obstruktion der oberen Atemwege, wenn Sie den Beatmungsbeutel verwenden, der an eine Gesichtsmaske angeschlossen ist, da dies zu einer eingeschränkten oder gar keiner Sauerstoffzufuhr führt. Wechseln Sie immer zu einer Alternative zur Verwendung einer Gesichtsmaske, um dem Patienten Luft zuzuführen, falls verfügbar.
- 21. Verwenden Sie das Produkt nicht mit angebrachter Gesichtsmaske, wenn Sie Säuglinge mit angeborener Zwerchfellernie beatmen, da die Gefahr einer Insufflation besteht. Wechseln Sie immer zu einer Alternative zur Verwendung einer Gesichtsmaske, um dem Patienten Luft zuzuführen, falls verfügbar.
- 22. Fachkräfte, die das Verfahren durchführen, sollten die Auswahl der Beatmungsbeutelgröße und des Zubehörs (z. B. Gesichtsmaske, PEEP-Ventil usw.) gemäß des spezifischen Zustands des Patienten treffen, da eine unsachgemäße Verwendung den Patienten schädigen kann.
- 23. Verwenden Sie den Ambu SPUR II nicht, wenn die Zufuhr von Free-Flow-Sauerstoff erforderlich ist, da dies zu einer unzureichenden Sauerstoffzufuhr und damit zu einer Hypoxie führen kann.
- 24. Die Manometerkappe muss immer auf den Manometeranschluss gesetzt werden, wenn der Druck nicht überwacht wird, um Leckagen zu vermeiden, die zu einer reduzierten O₂-Versorgung des Patienten führen können.
- 25. Bringen Sie den Sauerstoffschlauch immer bei Temperaturen über 0 °C an der Sauerstoffversorgung an, da die Montage bei Temperaturen unter 0 °C schwierig werden kann, was zu einer reduzierten Sauerstoffzufuhr zum Patienten führt.
- 26. Bei Verwendung des Beatmungsbeutels mit aufgesetzter Gesichtsmaske ist auf die korrekte Positionierung und Abdichtung der Gesichtsmaske zu achten, da eine unsachgemäße Abdichtung zur Ausbreitung einer luftübertragenen Infektionskrankheit auf den Anwender führen kann.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bewahren Sie den Beatmungsbeutel nie in einem deformierten Zustand auf, außer der Faltung, wie bei Lieferung durch den Hersteller vorgegeben. Ansonsten könnte es zu einer permanenten Verformung des Beatmungsbeutels und einer nicht ausreichenden Beatmung kommen. Die Faltnarkierungen sind auf dem Beutel deutlich erkennbar (nur die Ausführungsformen für Erwachsene und Kinder können gefaltet werden).
2. Um die Effizienz der Beatmung zu beurteilen, kontrollieren Sie stets die Brustkorbbewegungen und hören Sie auf den Exspirationsflow der durch das Patientenventil strömt. Wechseln Sie sofort zur Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn die Beatmung mit dem Beatmungsbeutel nicht erreicht werden kann.
3. Das Gerät nicht einweichen, abspülen oder desinfizieren, da dies zur Bildung schädlicher Ablagerungen oder einer Fehlfunktion des Geräts führen kann. Der Aufbau und das verwendete Material sind nicht für herkömmliche Reinigungs- und Sterilisationsverfahren geeignet.
4. Verwenden Sie den M-Port nur für eines der beiden: EtCO₂-Messung oder Medikamentenabgabe, da dies die Messwerte verändern kann.
5. Falls zutreffend, beachten Sie bitte die genauen Informationen zu den einzelnen Zubehörteilen auf der Verpackung, da eine falsche Handhabung zu Fehlfunktionen des gesamten Produkts führen kann.
6. Die Verwendung von Fremdprodukten und Sauerstoffversorgungsgeräten (z. B. Filter und Demandventile) mit dem Ambu SPUR II Beatmungsbeutel können die Produktleistung beeinflussen. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller des Drittanbietergeräts, um die Kompatibilität mit dem Ambu SPUR II Beatmungsbeutel zu überprüfen und Informationen über mögliche Leistungsänderungen zu erhalten.
7. Der Sauerstoffreservoirbeutel ist fest am Einlassventil der Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder befestigt, mit Ausnahme der Demandventil-Versionen. Nicht auseinanderbauen. Nicht am Sauerstoffreservoirbeutel ziehen, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen kann.

1.8. Potenzielle unerwünschte Ereignisse

Mögliche unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit der Reanimation (Auflistung nicht vollständig): Barotrauma, Volutrauma, Hypoxie, Hyperkapnie und Aspirationspneumonie.

1.9. Allgemeine Hinweise

Falls während oder infolge der Verwendung des Produkts ein schwerer Zwischenfall aufgetreten ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und ihrer zuständigen nationalen Behörde.

2. Gerätebeschreibung

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel kann an das Ambu® Einweg-Manometer, die Ambu® PEEP-Ventile und die Ambu® Gesichtsmasken angeschlossen werden, wie in Abschnitt 4.3 Anwendung des Beatmungsbeutels beschrieben.

3. Erklärung der verwendeten Symbole

Symbolbedeutung	Beschreibung
	Erwachsene Vorgesehenes ideales Körpergewicht größer als 30 kg
	Kinder Vorgesehenes ideales Körpergewicht von 6 bis 30 kg
	Säuglinge Vorgesehenes ideales Körpergewicht bis 10 kg

Symbolbedeutung	Beschreibung
	Bedingt MR-sicher
	Produktionsland
	Medizinprodukt
	Mehrfachanwendung bei einem Patienten
	Nicht mit Gewalt am Sauerstoffreservoirbeutel ziehen

Eine vollständige Liste der Symbolerklärungen finden Sie unter <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Anwendung des Produkts

4.1. Funktionsprinzip

Abbildung 1 zeigt den Fluss des Beatmungsgasmischs in den Beutel sowie zum Patienten hin und vom Patienten weg, während des manuellen Betriebs des Beatmungsbeutels. 1a Beatmungsbeutel für Erwachsene und Kinder, 1b Beatmungsbeutel für Säuglinge mit geschlossenem Sauerstoffreservoirbeutel (Beutelreservoir), 1c Beatmungsbeutel für Säuglinge mit offenem Sauerstoffreservoirschlauch (Schlauchreservoir).

Der Gasstrom ist bei Spontanatmung des Patienten über den Beatmungsbeutel ähnlich.

Das Sauerstoffreservoir besitzt zwei Ventile, eines für das Einziehen von Umgebungsluft bei leerem Reservoir und eines für den Ausstoß von überschüssigem Sauerstoff bei vollem Sauerstoffreservoirbeutel.

Der M-Port bietet Zugang zum inspiratorischen und exspiratorischen Gasfluss, und ermöglicht den Anschluss einer Spritze zur Medikamentenverabreichung 1d oder den Anschluss einer Probeentnahmeeleitung zur Messung des EtCO₂ im Seitenstromverfahren 1e.

1.1 Auslass für überschüssigen Sauerstoff, 1.2 Lufteinlass, 1.3 Sauerstoffeinlass, 1.4 Patientenanschluss, 1.5 Expiration, 1.6 Manometeranschluss, 1.7 Druckbegrenzungsventil, 1.8 M-Port.

HINWEIS: Das Zubehörteil an 1.5 kann entweder ein Spritzschutz oder ein PEEP-Ventil sein.

4.2. Prüfung und Vorbereitung

Der Beatmungsbeutel muss ausgepackt und für den sofortigen Gebrauch vorbereitet werden (einschließlich der Durchführung eines Funktionstests), bevor er als gebrauchsfertige Einheit in Notfallsituationen bereitgestellt wird.

4.2.1. Vorbereitung

- Sofern der Beatmungsbeutel in einem komprimierten Zustand verpackt ist, entfalten Sie ihn durch Ziehen an Patientenventil und Einlassventil.
- Bereiten Sie den Beatmungsbeutel vor und legen Sie alle Teile in die mit dem Beatmungsbeutel mitgelieferte Tragetasche.
- Ist die Gesichtsmaske, welche mit dem Beatmungsbeutel geliefert wird, separat in einem Schutzebeutel verpackt, ist der Schutzbeutel vor der ersten Verwendung zu entfernen.

Siehe Abschnitt 4.2.2. (Sauerstoffschlauch) zur Vorbereitung des Geräts vor der Verwendung bei unter 0 °C.

4.2.2. Funktionstest 2

Beatmungsbeutel

Schließen Sie das Druckbegrenzungsventil mit der Umgehungskappe und den Patientenanschluss mit dem Daumen **2.1**. Drücken Sie den komprimierbaren Beutel kräftig zusammen. Der Beatmungsbeutel sollte beim Zusammendrücken Widerstand leisten.

Öffnen Sie das Druckbegrenzungsventil durch Öffnen der Umgehungskappe und wiederholen Sie den Vorgang. Das Druckbegrenzungsventil sollte nun aktiviert werden und der Luftstrom aus dem Ventil sollte während der schnellen Kompression des komprimierbaren Beutels zu hören sein.

Drücken Sie den Beatmungsbeutel mehrmals zusammen, um sicher zu stellen, dass die Luft durch das Ventilsystem und aus dem Patientenventil strömt. **2.2**

HINWEIS: Während des Funktionstests oder der Beatmung können durch die Bewegung der Ventilmembran geringfügige Geräusche auftreten. Dies beeinträchtigt jedoch nicht die Funktion des Beatmungsbeutels.

Sauerstoffschlauch

Die Montage des Sauerstoffschlauchs und der Funktionstest des Sauerstoffreservoirbeutels und des Sauerstoffreservoirschlauchs sollten bei Temperaturen über 0 °C durchgeführt werden. Für die Verwendung des Beatmungsbeutels bei Temperaturen unter 0 °C lassen Sie den Sauerstoffschlauch nach dem Funktionstest an der Sauerstoffversorgung angeschlossen.

Sauerstoffreservoirbeutel

Stellen Sie einen Gasfluss von 10 l/min am Sauerstoffeinlassanschluss bereit. Unterstützen Sie gegebenenfalls das Entfalten des Reservoirbeutels von Hand. Prüfen Sie, ob sich der Sauerstoffreservoirbeutel füllt. Falls nicht, überprüfen Sie die beiden Ventilmembranen auf ihre Unversehrtheit oder ob das Sauerstoffreservoir Risse aufweist.

Passen Sie anschließend den Gasfluss entsprechend der medizinischen Indikation an.

Sauerstoffreservoirschlauch

Stellen Sie einen Gasfluss von 10 l/min am Sauerstoffeinlassanschluss bereit. Prüfen Sie, ob der Sauerstoff am Ende des Sauerstoffreservoirschlauchs ausströmt. Falls nicht, prüfen Sie, ob der Sauerstoffschlauch blockiert ist. Passen Sie anschließend den Gasfluss entsprechend der medizinischen Indikation an.

M-Port

Entfernen Sie die M-Port-Kappe und blockieren Sie den Patientenanschluss. Drücken Sie den Beutel zusammen und achten Sie auf das Geräusch, das entsteht, wenn die Luft durch den M-Port herausgedrückt wird. **2.3**

4.3. Anwendung des Beatmungsbeutels

- Wenden Sie die empfohlenen Techniken an, um den Mund und die Atemwege des Patienten freizulegen sowie den Patienten korrekt zu positionieren, um die Atemwege zu öffnen.
- Halten Sie die Gesichtsmaske fest an das Gesicht des Patienten. **3.1**
- Führen Sie Ihre Hand (Erwachsenen-Ausführung) bzw. Ihren Ring- und Mittelfinger (Kinder-Ausführung) unter die Handschlaufe. Die Ausführung für Säugling besitzt keine Handschlaufe. Eine Beatmung ohne Verwendung der Handschlaufe kann durch Drehen des Beutels erreicht werden. **3.2** Beatmung des Patienten: Achten Sie während der Insufflation darauf, ob sich der Brustkorb anhebt. Lassen Sie die Hand, die den Beutel hält, abrupt los und achten Sie auf das Geräusch des Exspirationsflows aus dem Patientenventil und das sichtbare Absenken des Brustkorbs.
- Prüfen Sie bei anhaltendem Beatmungswiderstand, ob die Atemwege blockiert sind und positionieren Sie den Patienten neu, um einen offenen Atemweg zu gewährleisten.
- Falls der Patient während der Beatmung erbrechen muss, befreien Sie sofort die Atemwege des Patienten und entfernen Sie das Erbrochene aus dem Beatmungsbeutel, indem Sie ihn mehrmals kräftig und schnell schütteln und zusammendrücken, bevor Sie die Beatmung fortsetzen.
- Wischen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem alkoholhaltigen Tuch ab und reinigen Sie den Spritzschutz mit Wasser.

Manometeranschluss

Das Ambu Einweg-Manometer sowie Manometer von Drittanbietern können an den Manometeranschluss oben am Patientenventil angeschlossen werden. Nehmen Sie den Verschlussdeckel ab und schließen Sie das Manometer/Druckmessgerät an

Druckbegrenzungssystem 4

Das Druckbegrenzungsventil ist so eingestellt, dass es sich bei 40 cm H₂O (4,0 kPa) öffnet. 4.1

Wenn nach medizinischer und fachlicher Einschätzung ein Druck über 40 cm H₂O erforderlich ist, kann das Druckbegrenzungsventil verschlossen werden, indem die Umgehungskappe über das Ventil bewegt wird. 4.2

Alternativ können Sie das Druckbegrenzungsventil umgehen, indem Sie einen Finger auf die rote Kappe legen, während Sie den Beutel zusammendrücken.

M-Port

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel ist mit oder ohne M-Port erhältlich. Der M-Port bietet Zugang zum inspiratorischen und expiratorischen Gasfluss und kann zur Medikamentenverabreichung verwendet werden, wenn eine Spritze angeschlossen wird, sowie zur Messung der CO₂-Konzentration im Seitenstromverfahren (EtCO₂). Denken Sie daran, den M-Port bei Nichtgebrauch mit der roten M-Port-Kappe zu verschließen.

Messung des EtCO₂

Schließen Sie zur Messung des EtCO₂ im Seitenstromverfahren die Probeentnahmelleitung für das EtCO₂ Messgerät an den M-Port des Ambu SPUR II Beatmungsbeutels an. Verbinden Sie den Anschluss der Leitung durch eine 1/4-Drehung im Uhrzeigersinn.

Medikamentenverabreichung

Beobachten Sie sorgfältig die Reaktion des Patienten auf die verabreichten Medikamente. Die Verabreichung eines Volumens von 1 ml Flüssigkeit oder mehr durch den M-Port ist mit den direkten Verabreichung in einen Endotracheal-Tubus vergleichbar. Der M-Port wurde mit Epinephrin, Lidocain und Atropin getestet.

Ambu SPUR II Beatmungsbeutel mit Demandventilanschluss 5

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel mit Demandventilanschluss ist in Erwachsenen- und Kindergrößen erhältlich und kann mit oder ohne Demandventil verwendet werden und wird mit einem anschließbaren Sauerstoffreservoirbeutel geliefert.

Das Einlassventil des Ambu SPUR II Beatmungsbeutels wird über einen Adapter mit dem Demandventil verbunden.

Anbringen des Demandventils:

- Entfernen Sie die Sauerstoffreservoireinheit vom Einlassventil des Ambu SPUR II Beatmungsbeutels, falls es angebracht ist.
- Befestigen Sie den Adapter am Demandventilsystem.
- Stecken Sie den Demandventiladapter in das Einlassventil des Ambu SPUR II Beatmungsbeutels.

HINWEIS: Verwenden Sie nur das Teil, das mit „Kompressionseinheit“ gekennzeichnet ist, mit Adapter und Demandventil. Das mit „Sauerstoffreservoirbeutel“ gekennzeichnete Teil dient als Reserve, wenn das Demandventil ausfällt.

Sauerstoffverabreichung

Verabreichen Sie Sauerstoff gemäß der medizinischen Indikation.

Die Abbildung 6 zeigt die berechneten Prozentsätze des abgegebenen Sauerstoffs, die mit unterschiedlichen Beatmungsvolumina und -frequenzen bei unterschiedlichen Gasflussraten erreicht werden können. Die Sauerstoff-Prozentsätze können unter 6 Erwachsene 6.1, Kinder 6.2, Säuglinge 6.3 eingesehen werden.

Sauerstoffreservoirbeutel 7

Die dünne Kunststofffolie des Sauerstoffreservoirbeutels darf zu keinem Zeitpunkt von der Befestigungsstelle am Beatmungsbeutel gelöst werden.

Zubehör 8

Die Anschlüsse des Ambu SPUR II Beatmungsbeutels entsprechen ISO 5356-1 und EN 13544-2, wodurch er mit anderem Krankenhousequipment kompatibel ist. Stellen Sie beim Anschluss externer Geräte sicher, dass dieses Gerät auf seine Funktionstüchtigkeit geprüft wurde und beachten Sie die dem externen Gerät beigegebene Bedienungsanleitung.

Ambu-Produkte, die mit dem Ambu SPUR II Beatmungsbeutel kompatibel sind, sind nachstehend aufgeführt:

Ambu® Einweg-Gesichtsmaske

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Ambu Einweg-Gesichtsmaske.

Ambu® Einweg-PEEP-Ventil 20 8.1 8.2

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 oder in Abbildung 8.1 in dieser Bedienungsanleitung. Um das Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 (falls erforderlich) am Beatmungsbeutel anzubringen, entfernen Sie den Spritzschutz. 8.2

Ambu® Einweg-Manometer 8.3

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Ambu Einweg-Manometers.

4.4. Nach der Anwendung

Gebrauchte Produkte müssen gemäß den vor Ort gültigen Vorschriften entsorgt werden.

5. Technische Produktspezifikationen

5.1. Angewandte Normen

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel ist in Übereinstimmung mit der produktspezifischen Norm EN ISO 10651-4.

5.2. Spezifikationen

	Säuglinge	Kinder	Erwachsene
Beatmungsbeutelvolumen	etwa 220 ml	etwa 670 ml	etwa 1510 ml
Zugeführtes Volumen, einhändig*	150 ml	450 ml	600 ml
Zugeführtes Volumen, beidhändig*	–	–	1.000 ml
Abmessungen (Länge x Durchmesser) ohne Reservoir und Zubehör	etwa 190 x 71 mm	etwa 223 x 99 mm	etwa 284 x 127 mm
Gewicht ohne Reservoir und Zubehör	etwa 70 g	etwa 145 g	etwa 220 g
Druckbegrenzungsventil**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Totraumvolumen	≤5 ml + 10 % des zugeführten Volumens	≤5 ml + 10 % des zugeführten Volumens	≤5 ml + 10 % des zugeführten Volumens
Inspiratorischer Widerstand***	max. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) bei 5 l/min	max 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) bei 50 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) bei 50 l/min
Exspiratorischer Widerstand***	max. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) bei 5 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) bei 50 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) bei 50 l/min

	Säuglinge	Kinder	Erwachsene
Reservoirvolumen	etwa 300 ml (Beutel) etwa 100 ml (Tubus)	etwa 2600 ml (Beutel)	etwa 2600 ml (Beutel)
Patientenanschluss	Außen 22 mm männlich (ISO 5356-1) Innen 15 mm weiblich (ISO 5356-1)		
Expirationskonnektor (zur Befestigung des PEEP-Ventils)	30 mm männlich (ISO 5356-1)		
Manometeranschlussstutzen	\varnothing 4,2 +/- 0,1 mm		
Demandventil-Anschluss	-	Innen 32 mm weiblich (EN ISO 10651-4)	
Vorwärts- und Rückwärtsleckage	Nicht messbar		
M-Port	Steckverbinder kompatibel mit EN ISO 80369-7		
O ₂ -Einlassanschluss	Gemäß EN 13544-2		
Grenzwerte für die Betriebstemperatur	-18 °C bis +50 °C, getestet gemäß EN ISO 10651-4		
Grenzwerte für die Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C, getestet gemäß EN ISO 10651-4		
Empfohlene Langzeitlagerung in geschlossener Verpackung bei Raumtemperatur, vor Sonneneinstrahlung geschützt.			

* Getestet gemäß EN ISO 10651-4.

** Ein höherer Ausgangsdruck ist durch das Umgehen des Druckbegrenzungsventils möglich.

*** Bei allgemeinen Prüfbedingungen gemäß EN ISO 10651-4.

5.3. MRT-Sicherheitshinweise

Der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel sowie der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel mit angeschlossenem Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20² und der Ambu SPUR II Beatmungsbeutel mit angeschlossenem Ambu Einweg-PEEP-Ventil 20 und Ambu Einweg-Manometer² sind bedingt MR-sicher und können daher unter den folgenden Bedingungen sicher in einer MR-Umgebung (nicht innerhalb der MR-Öffnung) verwendet werden.

Statisches Magnetfeld von 7 Tesla und weniger mit

- Maximalem räumlichen Gradientenfeld von
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²
- Maximalem Kraftprodukt von
 - 450.000.000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G²/cm (721 T²/m)²

Die Verwendung innerhalb der MR-Öffnung kann die MRT-Bildqualität beeinträchtigen. HF-induzierte Erwärmung und MR-Bildartefakte wurden nicht getestet. Metallische Teile sind vollständig umhüllt und haben keinen Kontakt zum menschlichen Körper.

1. Σημαντικές πληροφορίες – Διαβάστε πριν από τη χρήση

Πριν από τη χρήση της συσκευής ανάνηψης Ambu® SPUR® II, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης ενδέχεται να ενημερωθούν χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση. Αντίγραφα της τρέχουσας έκδοσης παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Λάβετε υπόψη σας ότι αυτές οι οδηγίες δεν επεξήγουν ούτε αναλύουν τις κλινικές διαδικασίες. Περιγράφουν μόνο τη βασική λειτουργία και τις προφυλάξεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της συσκευής ανάνηψης. Πριν από την αρχική χρήση της συσκευής ανάνηψης, είναι σημαντικό οι χειριστές να έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τις τεχνικές ανάνηψης, καθώς και να έχουν εξοικειωθεί με την ενδεδειγμένη χρήση, τις προειδοποίησεις, τις συστάσεις προσοχής και τις ενδείξεις που περιέχονται στις παρούσες οδηγίες. Δεν υπάρχει εγγύηση για τη συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II.

1.1. Ενδεδειγμένη χρήση

Η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II είναι μια συσκευή ανάνηψης μίας χρήσης, η οποία προβλέπεται για πνευμονική ανάνηψη.

1.2. Ενδείξεις χρήσης

Η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου απαιτείται χειροκίνητη καρδιοπνευμονική συσκευή ανάνηψης για υποβοηθούμενο αερισμό.

Η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II ενδέκινυται για τον αερισμό και την οξυγόνωση των ασθενών μέχρι να είναι δυνατή η επίτευξη ενός πιο οριστικού αεραγωγού ή μέχρι ο ασθενής να αναρρώσει.

1.3. Ενδεδειγμένος πληθυσμός ασθενών

Το εύρος μεγεθών της κάθε έκδοσης έχει ως εξής:

- Ενήλικες:** Ενήλικες και παιδιά με σωματικό βάρος άνω των 30 κιλών (66 lb).
- Παιδιατρική:** Βρέφη και παιδιά με σωματικό βάρος μεταξύ 6 κιλών και 30 κιλών (13 – 66 lb).
- Βρέφη:** Νεογάνα και βρέφη με μέγιστο σωματικό βάρος 10 κιλών (22 lb).

Λάβετε υπόψη σας ότι δεν είναι διαθέσιμες όλες οι διαμορφώσεις της συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II και για τα τρία εύρη ασθενών.

1.4. Ενδεδειγμένος χρήστης

Επαγγελματίες υγείας που έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση των αεραγωγών, όπως αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές, προσωπικό διάσωσης και προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

1.5. Αντενδείξεις

Καμία γνωστή.

1.6. Κλινικά οφέλη

Η βασική τεχνική διαχείρισης αεραγωγών με χρήση χειροκίνητης συσκευής ανάνηψης επιτρέπει τον αερισμό και την οξυγόνωση των ασθενών μέχρι να καταστεί δυνατή η επίτευξη ενός πιο οριστικού αεραγωγού ή μέχρι ο ασθενής να αναρρώσει.

1.7. Προειδοποίησεις και προφυλάξεις

Τυχόν μη συμμόρφωση με αυτές τις προφυλάξεις μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή αερισμό και οξυγόνωση του ασθενούς ή σε βλάβη του εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάνηψης για περισσότερο από 4 αθροιστικές ώρες σε μέγιστο χρονικό διάστημα 1 εβδομάδας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος μόλυνσης.
2. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάνηψης εάν έχει απομείνει ορατή υγρασία ή υπολείμματα μέσα στη συσκευή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης και δυσλειτουργίας.
3. Διασφαλίστε ότι στη θύρα εκπνοής έχει συνδεθεί ο αντισταλαγμικός προφυλακτήρας ή η βαλβίδα Ambu PEEP. Μια ανοικτή θύρα εκπνοής μπορεί να φράξει ακούσια και να προκαλέσει υπερβολικό όγκο αέρα στους πνεύμονες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό του ιστού.
4. Αποφεύγετε τη χρήση της συσκευής ανάνηψης σε τοξικά ή επικίνδυνα περιβάλλοντα, για να αποφύγετε τον κίνδυνο βλάβης των ιστών.

5. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο σωλήνας δεξαμενής οξυγόνου δεν είναι φραγμένος, καθώς τυχόν φραγή του σωλήνα μπορεί να αποτρέψει την εκ νέου πλήρωση του σάκου συμπίεσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μη εφικτό αερισμό.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει μολύνθει από εξωτερικές πηγές, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.
7. Επιθεωρείτε πάντα οπτικά το προϊόν και πραγματοποιείτε δοκιμή λειτουργικότητας μετά την αποσυσκευασία, τη συναρμολόγηση και πριν από τη χρήση, καθώς τυχόν ελαττώματα και ξένα σώματα μπορούν να οδηγήσουν στην απουσία ή τη μείωση του αερισμού του ασθενούς.
8. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η δοκιμή λειτουργικότητας αποτύχει, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απουσία ή μείωση του αερισμού.
9. Μην παρακάμπτετε τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης, εκτός εάν μια ιατρική εκτίμηση υποδειξεί την αναγκαιότητα χρήσης της. Οι υψηλές πιέσεις αερισμού μπορούν να προκαλέσουν κάκωση των πνευμόνων.
10. Μιας χρήσης μόνο. Η χρήση σε άλλους ασθενείς μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση.
11. Η φαρμακευτική αγωγή δεν μπορεί να παρασχεθεί μέσω της θύρας M, εάν έχουν συνδεθεί παρελκόμενα (π.χ. φίλτρο, ανιχνευτής CO₂) μεταξύ της συσκευής ανάνηψης και της μάσκας προσώπου.
12. Μην αφήνετε τη θύρα M ανοικτή μετά τη χρήση, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη χορήγηση O₂ στον ασθενή.
13. Η θύρα M δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την περιφερική παρακολούθηση του EtCO₂ σε ασθενείς, στους οποίους χορηγείται μικρότερος των 400 ml αναπνεόμενος όγκος αερισμού, για την αποφυγή ανακριβών μετρήσεων EtCO₂.
14. Όταν χορηγείται φάρμακο με όγκο μικρότερο του 1 ml, απαιτείται έκπλυση της θύρας M για να διασφαλιστεί η ακριβής δοσολογία του φαρμάκου.
15. Μην συνδέετε σωλήνα παροχής οξυγόνου στη θύρα M, καθώς η προβλεπόμενη συγκέντρωση O₂ δεν θα χορηγηθεί στον ασθενή.
16. Η προσθήκη παρελκόμενων μπορεί να αυξήσει την εισπνευστική ή/και εκπνευστική αντίσταση. Μην συνδέετε παρελκόμενα εάν η αυξημένη αναπνευστική αντίσταση είναι επιβλαβής για τον ασθενή.
17. Τα παρελκόμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από προοριζόμενους χρήστες, οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειρίδιου, καθώς η εσφαλμένη χρήση μπορεί να βλάψει τον ασθενή.
18. Όταν χρησιμοποιείτε συμπληρωματικό οξυγόνο, μην επιτρέπετε το κάπνισμα ή τη χρήση της συσκευής κοντά σε γυμνή φλόγα, λάδι, γράσο, άλλα εύφλεκτα χημικά ή εξοπλισμό και εργαλεία, τα οποία προκαλούν σπινθήρες, εξαιτίας του κινδύνου πυρκαγιάς ή/και έκρηξης.
19. Μην επιχειρήσετε να συνδέσετε οποιαδήποτε βαλβίδα ρύθμισης στην έκδοση για βρέφη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υψηλές συγκέντρωσεις οξυγόνου, οι οποίες ενδέχεται να είναι επιβλαβείς για τα νεογνά.
20. Κατά τη χρήση της συσκευής ανάνηψης που έχει συνδεθεί σε μάσκα προσώπου, προσέχετε για τυχόν σημάδια πλήρους/μερικούς φραγής του ανώτερου αεραγωγού, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε απουσία παροχής οξυγόνου ή σε περιορισμένη παροχή οξυγόνου. Πρέπει να επιλέγετε πάντα μια άλλη εναλλακτική λύση από τη χρήση της μάσκας προσώπου για τη διοχέτευση του αέρα στον ασθενή, εφόσον μια εναλλακτική είναι διαθέσιμη.
21. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με συνδεδεμένη μάσκα προσώπου κατά τον αερισμό βρεφών με συγγενή διαφραγματική κήλη, λόγω του κινδύνου εμφύσησης. Επιλέξτε μια άλλη εναλλακτική λύση από τη χρήση της μάσκας προσώπου για τη διοχέτευση του αέρα στον ασθενή, εφόσον μια εναλλακτική είναι διαθέσιμη.
22. Οι επαγγελματίες που εκτελούν τη διαδικασία θα πρέπει να αξιολογούν την επιλογή του μεγέθους και των παρελκόμενων της συσκευής ανάνηψης (π.χ. μάσκα προσώπου, βαλβίδα PEEP, κ.λπ.) σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες του ασθενούς, καθώς η λανθασμένη χρήση μπορεί να βλάψει τον ασθενή.
23. Μην χρησιμοποιείτε το Ambu SPUR II όταν απαιτείται παροχή οξυγόνου ελεύθερης ροής λόγω πιθανής ανεπαρκούς χορήγησης οξυγόνου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υποξία.
24. Το καπάκι του μανόμετρου πρέπει να τοποθετείται πάντα στη θύρα του μανόμετρου όταν η πίεση δεν παρακολουθείται, για την αποφυγή διαρροής η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη χορήγηση O₂ στον ασθενή.



- Eκτελείτε πάντα προκαταρκτική σύνδεση του σωλήνα οξυγόνου στην παροχή οξυγόνου σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C, καθώς η συναρμολόγηση μπορεί να είναι δύσκολη σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C, γεγονός που προκαλεί τη μείωση της παροχής οξυγόνου προς τον ασθενή.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ανάνηψης με συνδεδεμένη μάσκα προσώπου, διασφαλίστε τη σωστή τοποθέτηση και στεγανοποίηση της μάσκας προσώπου, καθώς η λανθασμένη στεγανοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε εξάπλωση λοιμωδών νόσων στον χρήστη μέσω του αέρα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΙΣ

- Μην αποθηκεύετε ποτέ τη συσκευή ανάνηψης παραμορφωμένη, διπλωμένη σε οποιαδήποτε μορφή πέραν αυτής που είχε κατά την παράδοση από τον κατασκευαστή, διότι διαφορετικά μπορεί να προκύψει μόνιμη παραμόρφωση του σάκου, γεγονός που ενδέχεται να μειώσει την αποτελεσματικότητα του αερισμού. Η ζώνη διπλώματος είναι σαφώς ορατή στον σάκο (μόνο οι εκδόσεις Ενηλίκων και Παιδιατρικής μπορούν να διπλωθούν).
- Παρακαλούσθείτε πάντα την κίνηση του θώρακα και ακούτε τη ροή εκπνοής από τη βαλβίδα του ασθενούς, ώστε να ελέγχετε τον αερισμό. Στραφείτε αμέσως σε αερισμό στόματος-στόματος, εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί αερισμός με τη συσκευή ανάνηψης.
- Μη μουλιάζετε, ξεπλένετε ή αποστειρώνετε αυτήν τη συσκευή, καθώς αυτές οι διαδικασίες ενδέχεται να αφήσουν επιβλαβή υπολείμματα ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία στη συσκευή. Ο σχεδιασμός και τα υλικά που χρησιμοποιούνται δεν είναι συμβατά με τις συνήθεις διαδικασίες καθαρισμού και αποστείρωσης.
- Χρησιμοποιείτε τη θύρα M μόνο για έναν από του παρακάτω δύο λόγους: Για τη μέτρηση EtCO₂ ή για τη χορήγηση φαρμάκων, καθώς αυτό μπορεί να τροποποιήσει τις μετρούμενες τιμές.
- Κατά περίπτωση, ανατρέξτε στη συσκευασία των παρελκόμενων για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το κάθε εξάρτημα, καθώς ο εσφαλμένος εσιτησμός μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ολόκληρου του προϊόντος.

- Η χρήση προιόντων τρίτων κατασκευαστών και συσκευών χορήγησης οξυγόνου (π.χ. φίλτρα και βαλβίδες ρύθμισης) με τη συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της τρίτης συσκευής για να επαλθεύσετε τη συμβατότητα με τη συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II και για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στην απόδοση.
- Ο σάκος δεξαμενής οξυγόνου είναι μόνιμα προσαρτημένος στη βαλβίδα εισόδου των συσκευών ανάνηψης ενηλίκων και παιδιατρικής, εκτός από τις εκδόσεις με βαλβίδα ρύθμισης. Μην επιχειρήσετε να τον αποσυνδέσετε. Μην τραβάτε τον σάκο δεξαμενής οξυγόνου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

1.8. Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα

Πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με την ανάνηψη (ενδεικτικά): κάκωση πνευμόνων, τοπική υπερδιόγκωση της φυσιολογικής κυψελίδας, υποξία, περίσσεια διοξειδίου του άνθρακα και πνευμονία από αναρρόφηση.

1.9. Γενικές παρατηρήσεις

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης της παρούσας συσκευής ή ως αποτέλεσμα της χρήσης της προκύψει σοβαρό περιστατικό, μην παραλείψετε να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

2. Περιγραφή της συσκευής

Η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II μπορεί να συνδεθεί με το μανόμετρο πίεσης μίας χρήσης Ambu®, τις βαλβίδες PEEP Ambu® και τις μάσκες προσώπου Ambu®, όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.3 Χειρισμός της συσκευής ανάνηψης.

3. Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται

Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή
	Ενήλικες Προβλεπόμενο ιδανικό βάρος σώματος πάνω από 30 kg
	Παιδιατρική Προβλεπόμενο ιδανικό βάρος σώματος μεταξύ 6 και 30 kg
	Βρέφη Προβλεπόμενο ιδανικό βάρος σώματος έως 10 kg
	MR υπό όρους
	Χώρα κατασκευαστή
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Για πολλαπλές χρήσεις σε έναν ασθενή

Σύμβολο Ένδειξη	Περιγραφή
	Μην τραβάτε με δύναμη το σάκο δεξαμενής οξυγόνου

Μπορείτε να βρείτε μια πλήρη λίστα των επεξηγήσεων συμβόλων στο <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Χρήση προϊόντος

4.1. Αρχή λειτουργίας

Η εικόνα ① δείχνει τα μείγματα ροής αερίων αερισμού στο σάκο και από και προς τον ασθενή κατά τη χειροκίνητη λειτουργία της συσκευής ανάνηψης. Συσκευή ανάνηψης για ενήλικες και παιδιά ①a, συσκευή ανάνηψης για βρέφη με κλειστό σάκο δεξαμενής οξυγόνου (δεξαμενή σάκου) ①b, συσκευή ανάνηψης για βρέφη με ανοιχτό σωλήνα δεξαμενής οξυγόνου (δεξαμενή σωλήνα) ①c.

Η ροή αερίων είναι παρόμοια όταν ο ασθενής αναπνέει αυθόρμητα μέσω της συσκευής.

Η δεξαμενή οξυγόνου είναι εξοπλισμένη με δύο βαλβίδες: Η μία επιτρέπει την άντληση αέρα περιβάλλοντος όταν η δεξαμενή είναι άδεια και η άλλη εξάγει τυχόν πλεονάζουσα ποσότητα οξυγόνου όταν ο σάκος δεξαμενής οξυγόνου είναι γεμάτος.

Η Θύρα M παρέχει πρόσβαση στη ροή εισπνευστικού και εκπνευστικού αερίου, επιτρέποντας τη σύνδεση σύριγγας για την παροχή φαρμάκων ①d ή τη σύνδεση γραμμής δειγματοληψίας αερίου για την περιφερική μέτρηση του EtCO₂ ①e.

①.1 Αποδέσμευση υπερβολικής ποσότητας οξυγόνου, Είσοδος αέρα ①.2, Είσοδος οξυγόνου ①.3, Σύνδεσμος ασθενούς ①.4, Εκπνοή ①.5, Θύρα μανόμετρου ①.6, Βαλβίδα περιορισμού πίεσης ①.7, Θύρα M ①.8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προσάρτημα στο 1.5 μπορεί να είναι είτε ένας αντισταλαγμικός προφυλακτήρας, είτε μια βαλβίδα PEEP.

4.2. Επιθεώρηση και προετοιμασία

Η συσκευή ανάνηψης πρέπει να αποσυσκευάζεται και να προετοιμάζεται (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής λειτουργικότητας) για άμεση χρήση προτού τεθεί σε ετοιμότητα για χρήση σε επείγοντα περιστατικά.

4.2.1. Προετοιμασία

- Εάν η συσκευή ανάνηψης είναι συσκευασμένη σε συμπιεσμένη κατάσταση, ξεδιπλώστε την τραβώντας τη βαλβίδα ασθενούς και τη βαλβίδα εισόδου.
- Προετοιμάστε τη συσκευή ανάνηψης και τοποθετήστε όλα τα στοιχεία στον σάκο μεταφοράς που παρέχεται μαζί με τη συσκευή ανάνηψης.
- Εάν η μάσκα προσώπου που παρέχεται με τη συσκευή ανάνηψης είναι τυλιγμένη σε προστατευτική θήκη, η θήκη πρέπει να αφαιρείται πριν από τη χρήση.

Ανατρέξτε στην ενότητα 4.2.2. (Σωλήνας οξυγόνου) για την προετοιμασία της συσκευής πριν από τη χρήση σε θερμοκρασία κάτω από 0 °C.

4.2.2. Δοκιμή λειτουργίας ②

Συσκευή ανάνηψης

Κλείστε τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης με το κλιπ παράκαμψης και κλείστε τον σύνδεσμο ασθενούς με τον αντίχειρα 2.1. Πίέστε κοφτά τον συμπιεζόμενο σάκο. Η συσκευή ανάνηψης πρέπει να αντιστέκεται στην πίεση.

Ανοίξτε τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης σέρνοντας μακριά το κλιπ παράκαμψης και επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Τώρα η βαλβίδα περιορισμού πίεσης θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε τη ροή από τη βαλβίδα κατά την κοφτή πίεση του συμπιεζόμενου σάκου.

Πίέστε και αφήστε τη συσκευή ανάνηψης μερικές φορές, για να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας διέρχεται από το σύστημα βαλβίδας και εξέρχεται από τη βαλβίδα ασθενούς. 2.2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς οι δίσκοι βαλβίδας κινούνται κατά τη δοκιμή λειτουργικότητας ή κατά τον αερισμό, μπορεί να ακούγεται ένας ελαφρύς ήχος. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα της συσκευής ανάνηψης.

Σωλήνας οξυγόνου

Η τοποθέτηση του σωλήνα οξυγόνου και η δοκιμή λειτουργίας του σάκου δεξαμενής οξυγόνου και του σωλήνα δεξαμενής οξυγόνου πρέπει να εκτελούνται σε θερμοκρασίες άνω των 0 °C. Για χρήση της συσκευής ανάνηψης σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C, αφήστε το σωλήνα οξυγόνου συνδεδεμένο στην παροχή οξυγόνου μετά τη δοκιμή λειτουργίας.

Σάκος δεξαμενής οξυγόνου

Παράσχετε μια ροή αερίου 10 l/min στον σύνδεσμο εισόδου οξυγόνου. Ενδεχομένως, υποστηρίξτε το ξεδίπλωμα του σάκου με το χέρι. Ελέγχετε αν ο σάκος δεξαμενής οξυγόνου γεμίζει. Εάν όχι, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα των δύο διαφραγμάτων της βαλβίδας ή ελέγχετε για τυχόν φθορά στη δεξαμενή οξυγόνου.

Στη συνέχεια, προσαρμόστε την παρεχόμενη ροή αερίου σύμφωνα με την ιατρική ένδειξη.

Σωλήνας δεξαμενής οξυγόνου

Παράσχετε μια ροή αερίου 10 l/min στον σύνδεσμο εισόδου οξυγόνου. Βεβαιωθείτε ότι το οξυγόνο εξέρχεται από το άκρο του σωλήνα δεξαμενής οξυγόνου. Εάν όχι, ελέγχετε για τυχόν εμπόδια στο σωλήνα οξυγόνου. Στη συνέχεια, προσαρμόστε την παρεχόμενη ροή αερίου σύμφωνα με την ιατρική ένδειξη.

Θύρα M

Αφαιρέστε το πώμα της θύρας M και αποκλείστε το σύνδεσμο ασθενούς. Πιέστε τον σάκο και ακούστε τον ήχο του αέρα που εξέρχεται από τη θύρα M. 2.3

4.3. Χειρισμός της συσκευής ανάνηψης

- Εφαρμόστε τις προτεινόμενες τεχνικές για να καθαρίσετε το στόμα και τον αεραγωγό του ασθενούς και να τοποθετήσετε τον ασθενή σωστά, ώστε να ανοίξετε τον αεραγωγό.
- Κρατήστε τη μάσκα προσώπου σταθερά πάνω στο πρόσωπο του ασθενούς. 3.1

- Περάστε το χέρι σας (έκδοση ενηλίκων) ή τον μέσο και τον παράμεσο δάκτυλο (παιδιατρική έκδοση) κάτω από τη λαβή. Η βρεφική έκδοση δεν διαθέτει λαβή υποστήριξης. Ο αερισμός χωρίς τη χρήση της λαβής υποστήριξης μπορεί να επιτευχθεί στρέφοντας το σάκο. **3.2** Αερισμός του ασθενούς: Κατά τη διάρκεια της εμφύσησης, παρατηρήστε την άνοδο του θώρακα. Αφήστε απότομα το χέρι που κρατάει τον σάκο και ακούστε τον ήχο της ροής εκπνοής από τη βαλβίδα ασθενούς και παρατηρήστε την κάθοδο του θώρακα.
- Εάν συναντάτε συνεχή αντίσταση στην εμφύσηση, ελέγχτε τον αεραγωγό για τυχόν εμπόδια και τοποθετήστε εκ νέου τον ασθενή, για να διασφαλίσετε τον ανοιχτό αεραγωγό.
- Εάν ο ασθενής κάνει εμετό κατά τη διάρκεια του αερισμού, καθαρίστε αμέσως τον αεραγωγό του ασθενούς και αποβάλετε τον εμετό από τη συσκευή ανάνηψης κουνώντας και πιέζοντάς την με δύναμη, γρήγορα και πολλές φορές προτού συνεχίσετε τον αερισμό. Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε το προϊόν με ένα πανί που περιέχει αλκοόλη και καθαρίστε τον αντισταλαγμικό προφυλακτήρα με νερό.

Θύρα μανόμετρου

Το μανόμετρο πίεσης Ambu μίας χρήσης και ο μετρητής πίεσης τρίτων κατασκευαστών μπορούν να συνδεθούν στη θύρα του μανόμετρου που βρίσκεται στο επάνω μέρος της βαλβίδας ασθενούς. Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το μανόμετρο / τον μετρητή πίεσης

Σύστημα περιορισμού πίεσης **4**

Η βαλβίδα περιορισμού πίεσης έχει ρυθμιστεί να ανοίγει στα 40 cm H₂O (4,0kPa). **4.1**

Εάν βάσει της ιατρικής και επαγγελματικής εκτίμησης κριθεί ότι απαιτείται πίεση άνω των 40 cm H₂O, η βαλβίδα περιορισμού πίεσης μπορεί να παρακαμφθεί μετακινώντας το κλίπ παράκαμψης επάνω στη βαλβίδα. **4.2**

Εναλλακτικά, μπορείτε να παρακάμψετε τη βαλβίδα περιορισμού πίεσης τοποθετώντας ένα δάχτυλο στο κόκκινο κουμπί ενώ πιέζετε τον σάκο.

Θύρα M

Η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II παρέχεται με ή χωρίς θύρα M. Η θύρα M παρέχει πρόσβαση στη ροή αερίου εισπνοής και εκπνοής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή φαρμακευτικής αγωγής, όπου είναι συνδεδεμένη με μια σύριγγα, καθώς και για την περιφερική μέτρηση του CO₂ (EtCO₂). Όταν δεν χρησιμοποιείται, μην ξεχνάτε να κλείνετε τη θύρα M με το κόκκινο καπάκι της θύρας M.

Μέτρηση του EtCO₂

Για την περιφερική μέτρηση του EtCO₂, συνδέστε τη γραμμή δειγματοληψίας αερίου για τη συσκευή μέτρησης EtCO₂ στη θύρα M της συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II. Συνδέστε τον συνδετήρα της γραμμής δειγματοληψίας αερίου τοποθετώντας και περιστρέφοντάς τον κατά το 1/4 της περιστροφής δεξιόστροφα.

Εισαγωγή φαρμάκων

Παρατηρήστε με προσοχή την απόκριση του ασθενούς στη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. Η χορήγηση όγκων υγρού 1 ml ή ανώτερου μέσω της θύρας M είναι συγκρίσιμη με την απευθείας χορήγηση στον ενδοτραχειακό σωλήνα. Η θύρα M έχει ελεγχθεί με επινεφρίνη, λιδοκαΐνη και ατροπίνη.

Έκδοση βαλβίδας ρύθμισης συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II **5**

Η έκδοση βαλβίδας ρύθμισης της συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II διατίθεται σε μεγέθη ενηλίκων και παιδιών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με ή χωρίς βαλβίδα ρύθμισης και συνοδεύεται από σάκο δεξαμενής οξυγόνου με δυνατότητα σύνδεσης.

Η βαλβίδα εισόδου της συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II συνδέεται στη βαλβίδα ρύθμισης μέσω ενός προσαρμογέα.

Σύνδεση της βαλβίδας ρύθμισης:

- Αφαιρέστε τη μονάδα δεξαμενής οξυγόνου από τη βαλβίδα εισόδου της συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II, εάν είναι συνδεδεμένη.
- Στερεώστε τον προσαρμογέα στο σύστημα βαλβίδας ρύθμισης.
- Εισαγάγετε τον προσαρμογέα βαλβίδας ρύθμισης στη βαλβίδα εισόδου της συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα που φέρει τη σήμανση "μονάδα συμπίεσης" με τον προσαρμογέα και τη βαλβίδα ρύθμισης. Το εξάρτημα με τη σήμανση "Σάκος δεξαμενής οξυγόνου" θεωρείται ως εφεδρικό σε περίπτωση βλάβης της βαλβίδας ρύθμισης.

Χορήγηση οξυγόνου

Χορηγήστε οξυγόνο σύμφωνα με τις ιατρικές ενδείξεις.

Η εικόνα **6** δείχνει τα υπολογισμένα, παρεχόμενα ποσοστά οξυγόνου, τα οποία μπορούν να επιτευχθούν με διαφορετικούς όγκους και συχνότητες αερισμού σε διαφορετικούς ρυθμούς ροής αερίου. Μπορείτε να δείτε τα ποσοστά οξυγόνου στις ενότητες **6** Ενήλικες **6.1**, Παιδιατρική **6.2**, Βρέφη **6.3**.

Σάκος δεξαμενής οξυγόνου **7**

Το πλαστικό φύλλο του λεπτού σάκου δεξαμενής οξυγόνου δεν μπορεί να αποσπαστεί από το σημείο στερέωσής του στη συσκευή ανάνηψης οποιαδήποτε στιγμή.

Παρελκόμενα **8**

Οι σύνδεσμοι της συσκευής ανάνηψης Ambu SPUR II συνάδουν με τις οδηγίες των προτύπων ISO 5356-1 και EN 13544-2 καθιστώντας τους συμβατούς με άλλο νοσοκομειακό εξοπλισμό. Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικές συσκευές, ελέγχετε οπωσδήποτε τη λειτουργικότητά τους και συμβουλεύστε τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν την εξωτερική συσκευή.

Τα προϊόντα Ambu που είναι συμβατά με τη συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II αναφέρονται παρακάτω:

Μάσκα προσώπου μίας χρήσης Ambu®

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της μάσκας προσώπου Ambu μίας χρήσης.

Βαλβίδα μίας χρήσης Ambu® PEEP 20 **8.1** **8.2**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της βαλβίδας μίας χρήσης Ambu PEEP 20 ή ανατρέξτε στην εικόνα **8.1** στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Για να τοποθετήσετε τη βαλβίδα μίας χρήσης Ambu PEEP 20 (εάν απαιτείται) στη συσκευή ανάνηψης, αφαιρέστε τον αντισταλαγμικό προφυλακτήρα. **8.2**

Μανόμετρο πίεσης μίας χρήσης Ambu® **8.3**

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Μανόμετρου πίεσης Ambu μίας χρήσης.

4.4. Μετά τη χρήση

Τα χρησιμοποιημένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες.

5. Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

5.1. Ισχύοντα πρότυπα

Η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II συμμορφώνεται με το πρότυπο προϊόντων EN ISO 10651-4.

5.2. Προδιαγραφές

	Βρέφη	Παιδιατρική	Ενήλικες
Όγκος συσκευής ανάνηψης	περίπου 220 ml	περίπου 670 ml	περίπου 1510 ml
Παρεχόμενος όγκος με ένα χέρι*	150 ml	450 ml	600 ml
Παρεχόμενος όγκος με δύο χέρια*	-	-	1000 ml
Διαστάσεις (μήκος x διάμετρος) χωρίς δεξαμενή και παρελκόμενο	περίπου 190 x 71 mm	περίπου 223 x 99 mm	περίπου 284 x 127 mm
Βάρος χωρίς δεξαμενή και παρελκόμενο	περίπου 70 g	περίπου 145 g	περίπου 220 g

	Βρέφη	Παιδιατρική	Ενήλικες
Βαλβίδα περιορισμού πίεσης**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Κενός χώρος	≤ 5 ml + 10 % του παρεχόμενου όγκου	≤ 5 ml + 10 % του παρεχόμενου όγκου	≤ 5 ml + 10 % του παρεχόμενου όγκου
Εισπνευστική αντίσταση***	μέγ. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) στα 5 l/min	μέγ. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) στα 50 l/min	μέγ. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) στα 50 l/min
Εκπνευστική αντίσταση***	μέγ. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) στα 5 l/min	μέγ. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) στα 50 l/min	μέγ. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) στα 50 l/min
Όγκος δεξαμενής	περίπου 300 ml (σάκος) περίπου 100 ml (σωλήνας)	περίπου 2600 ml (σάκος)	περίπου 2600 ml (σάκος)
Σύνδεσμος ασθενούς	Eξωτερικά 22 mm αρσενικός (ISO 5356-1) Εσωτερικά 15 mm θηλυκός (ISO 5356-1)		
Σύνδεσμος εκπνοής (για εξάρτημα βαλβίδας PEEP)	30 mm αρσενικός (ISO 5356-1)		
Σύνδεσμος θύρας μανόμετρου		Ø 4,2 +/- 0,1 mm	
Σύνδεσμος βαλβίδας ρύθμισης	-	Εσωτερικά 32 mm θηλυκός (EN ISO 10651-4)	
Διαρροή προς τα εμπρός και προς τα πίσω		Μη μετρήσιμη	
Θύρα M		Σύνδεσμος συμβατός με το EN ISO 80369-7	
Σύνδεσμος εισόδου O ₂		Κατά το EN 13544-2	
Όρια θερμοκρασίας λειπουργίας	-18 °C έως +50 °C (-0,4 °F έως +122 °F), με έλεγχο κατά το πρότυπο EN ISO 10651-4		

	Βρέφη	Παιδιατρική	Ενήλικες
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης	-40 °C έως +60 °C (-40 °F έως +140 °F), με έλεγχο κατά το πρότυπο EN ISO 10651-4		

Συνιστώμενη μακροπρόθεσμη αποθήκευση σε κλειστή συσκευασία, σε θερμοκρασία δωματίου, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

* Ελεγμένο κατά το πρότυπο EN ISO 10651-4.

** Υψηλότερη πίεση παροχής μπορεί να επιτευχθεί μέσω παράκαμψης της βαλβίδας περιορισμού πίεσης.

*** Γενικές συνθήκες δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10651-4.

5.3. Πληροφορίες για την ασφάλεια σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MRI)

Η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II¹, η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II με συνδεδεμένη βαλβίδα² Ambu PEEP 20 μίας χρήσης και η συσκευή ανάνηψης Ambu SPUR II με συνδεδεμένη βαλβίδα Ambu PEEP 20 μίας χρήσης και μανόμετρο πίεσης² Ambu μίας χρήσης ενδείκνυνται για μαγνητική τομογραφία υπό όρους και, επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον MR (όχι στο εσωτερικό της οπής MR) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Στατικό μαγνητικό πεδίο 7 Tesla ή μικρότερο, με

- Μέγιστη διαβάθμιση χωρικού πεδίου
 - 10,000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16,000 G/cm (160 T/m)²
- Προϊόν μέγιστης δύναμης
 - 450,000,000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721,000,000 G2/cm (721 T²/m)²

Η χρήση εντός της οπής MR μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας MR.

Δεν έχει ελεγχθεί η θέρμανση επαγόμενη από ραδιοσυχνότητες και τα τεχνονοργήματα εικόνας MR. Τα μεταλλικά μέρη είναι πλήρως ενθυλακωμένα και δεν έρχονται σε επαφή με το ανθρώπινο σώμα.



1. Información importante (Leer antes de utilizar el dispositivo)

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el resucitador Ambu® SPUR® II. Estas instrucciones de uso están sujetas a actualizaciones sin previo aviso. Con previa solicitud le facilitaremos las copias disponibles de la versión actual. Tenga en cuenta que estas instrucciones no explican ni analizan las intervenciones clínicas. Únicamente describen el funcionamiento básico y las precauciones relacionadas con el funcionamiento del resucitador. Antes de empezar a usar el resucitador, es esencial que los usuarios hayan recibido una formación suficiente acerca de las técnicas de reanimación y que estén familiarizados con la finalidad de uso, las advertencias, los avisos de precaución y las indicaciones que se presentan en estas instrucciones de uso. El resucitador Ambu SPUR II no tiene garantía.

1.1. Uso previsto

El resucitador Ambu SPUR II es un resucitador desecharable diseñado para la reanimación pulmonar.

1.2. Indicaciones de uso

El resucitador Ambu SPUR II está previsto para su uso en situaciones en las que se necesite un resucitador cardiopulmonar manual para la ventilación asistida.

El resucitador Ambu SPUR II está indicado para la ventilación y oxigenación de pacientes hasta que se pueda establecer una vía aérea más definitiva o hasta que el paciente se haya recuperado.

1.3. Población de pacientes objetivo

La gama de tamaños de las aplicaciones para cada versión es la siguiente:

- **Adultos:** Adultos y niños con un peso corporal superior a 30 kg (66 lb).
- **Pediátrico:** Bebés y niños con un peso corporal de 6 kg a 30 kg (13-66 lb).
- **Neonatal:** Neonatos y bebés con un peso corporal de hasta 10 kg (22 lb).

Tenga en cuenta que no todas las configuraciones del resucitador Ambu SPUR II están disponibles para los tres rangos de pacientes.

1.4. Usuario previsto

Profesionales médicos formados en el control de la vía aérea, como anestesistas, personal de enfermería, personal de rescate y personal de urgencias.

1.5. Contraindicaciones

Ninguna conocida.

1.6. Beneficios clínicos

La técnica básica de control de la vía aérea con un resucitador manual permite la ventilación y oxigenación de los pacientes hasta que se pueda establecer una vía aérea más definitiva o hasta que el paciente se haya recuperado.

1.7. Precauciones y advertencias

La falta de seguimiento de las precauciones puede tener como resultado una ventilación y oxigenación inefficientes del paciente o daños en el equipo.

ADVERTENCIAS

1. No utilice el resucitador durante más de cuatro horas acumuladas durante un periodo máximo de una semana para evitar el riesgo de infección.
2. No reutilice el resucitador si queda humedad visible o residuos en el interior del dispositivo, para evitar el riesgo de infección y de funcionamiento incorrecto.
3. Asegúrese de que el protector contra salpicaduras o la válvula Ambu PEEP estén conectados al puerto respiratorio. Un puerto respiratorio abierto puede bloquearse accidentalmente y provocar la entrada de un volumen de aire excesivo en los pulmones, lo que puede provocar un traumatismo tisular.
4. Evite el uso del resucitador en entornos tóxicos o peligrosos para evitar el riesgo de daño tisular.

5. Asegúrese siempre de que el tubo del depósito de oxígeno no esté bloqueado, ya que bloquear el tubo puede evitar que la bolsa de compresión se vuelva a inflar, lo que podría impedir la ventilación.
6. No utilice el producto si está contaminado por fuentes externas, ya que esto puede provocar infecciones.
7. Inspeccione siempre visualmente el producto y realice una prueba de funcionamiento después de desembalarlo, montarlo y antes de usarlo, ya que los defectos y las materias extrañas pueden provocar la ausencia o reducción de ventilación para el paciente.
8. No utilice el producto si no supera la prueba de funcionamiento, ya que esto puede dar lugar a una ventilación reducida o inexistente.
9. No anule la válvula limitadora de presión a menos que una valoración médica indique esta necesidad. Las presiones de ventilación altas pueden causar un barotrauma.
10. Dispositivo de uso único. El uso con otros pacientes puede provocar contaminación cruzada.
11. La medicación no se puede administrar a través del M-Port si los accesorios (por ejemplo, el filtro o el detector de CO₂) se conectan entre el resucitador y la mascarilla.
12. No deje el M-Port abierto después de su uso para evitar fugas, ya que podrían reducir el suministro de O₂ al paciente.
13. El M-Port no se debería utilizar para controlar el flujo lateral de EtCO₂ de los pacientes ventilados con menos de 400 ml de volumen corriente para evitar mediciones imprecisas de EtCO₂.
14. Cuando se administre medicación con un volumen inferior a 1 ml, es necesario purgar el M-Port para garantizar una dosificación precisa de la medicación administrada.
15. No conecte tubos de suministro de oxígeno al M-Port, ya que no se suministrará la concentración de O₂ prevista al paciente.
16. Añadir estos accesorios puede aumentar la resistencia de inspiración y/o espiración. No conecte accesorios si una mayor resistencia respiratoria puede ser perjudicial para el paciente.
17. Solo deben utilizarlos usuarios que estén familiarizados con el contenido de este manual, ya que un uso incorrecto podría dañar al paciente.
18. Cuando utilice oxígeno suplementario, no permita que se fume ni el uso del dispositivo cerca de llamas abiertas, aceites, grasas u otros productos químicos inflamables, o equipos y herramientas que puedan provocar chispas debido al riesgo de incendio y/o explosión.
19. No intente acoplar ninguna válvula de demanda a la versión neonatal, ya que esto puede causar altas concentraciones de oxígeno, lo que podría ser perjudicial para los neonatos.
20. Tenga cuidado con las señales de obstrucción total/parcial de la vía aérea superior cuando utilice el resucitador acoplado a una mascarilla, ya que esto provocará que el suministro de oxígeno sea nulo o limitado. Cambie siempre a una alternativa al uso de una mascarilla para dirigir el aire hacia el paciente, si hay alguna opción disponible.
21. No utilice el producto con la mascarilla acoplada cuando ventile a bebés con una hernia diafragmática congénita debido al riesgo de insuflación. Cambie a una alternativa al uso de una mascarilla para dirigir el aire hacia el paciente, si hay alguna opción disponible.
22. Los profesionales que llevan a cabo el procedimiento deben evaluar la elección del tamaño del resucitador y los accesorios (p. ej., máscara, válvula PEEP, etc.) de acuerdo con las condiciones específicas del paciente, ya que un uso incorrecto puede dañar al paciente.
23. No utilice el Ambu SPUR II cuando necesite administrar oxígeno de flujo libre debido a una posible administración insuficiente de oxígeno, lo que puede provocar hipoxia.
24. La tapa del manómetro debe colocarse siempre en el puerto del manómetro cuando no se esté controlando la presión para evitar fugas, lo que podría reducir el suministro de O₂ al paciente.
25. Conecte siempre el tubo de oxígeno al suministro de oxígeno a temperaturas superiores a 0 °C, ya que el montaje puede ser difícil a temperaturas inferiores a 0 °C, lo que reduce el suministro de oxígeno al paciente.

26. Cuando utilice el resucitador con una mascarilla acoplada, asegúrese de colocar y sellar correctamente la mascarilla, ya que un sellado incorrecto puede provocar la propagación de enfermedades infecciosas en el aire suministrado al usuario.

PRECAUCIONES

1. No guarde nunca el resucitador con un plegado diferente al realizado por el fabricante. De lo contrario, podría producirse una deformación permanente de la bolsa, lo que podría reducir la eficiencia de ventilación. La zona de plegado se ve claramente en la bolsa (solo pueden plegarse las versiones para adultos y pediátrico).
2. Observe siempre el movimiento del pecho y escuche el flujo espiratorio de la válvula del paciente para comprobar la ventilación. Cambie inmediatamente a la ventilación boca a boca si no puede lograrse la ventilación con el reanimador.
3. No empape ni esterilice este dispositivo, puesto que estos procedimientos pueden dejar residuos nocivos o causar averías en el dispositivo. El diseño y material utilizado no son compatibles con los procedimientos de limpieza y esterilización convencionales.
4. Utilice el M-Port solo para una de las dos funciones, la medición de EtCO₂ o la administración de fármacos, ya que esto puede modificar los valores medidos.
5. Si fuese necesario, consulte el envase de los accesorios para obtener información más específica sobre cada uno de ellos, dado que una manipulación incorrecta puede provocar un funcionamiento incorrecto del producto.
6. El uso de productos y dispositivos de suministro de oxígeno de terceros (p. ej., filtros y válvulas de demanda) con el resucitador Ambu SPUR II pueden afectar al rendimiento del producto. Consulte al fabricante del dispositivo de terceros para verificar la compatibilidad con el resucitador Ambu SPUR II y obtener información sobre los posibles cambios en el rendimiento.
7. La bolsa del depósito de oxígeno está conectada de forma permanente a la válvula de admisión en resucitadores para adultos y pediátricos, excepto en las versiones con válvula de demanda. No intente desmontarla. No tire de la bolsa del depósito de oxígeno, ya que podría causar un funcionamiento incorrecto del dispositivo.

1.8. Sucesos potencialmente adversos

Possibles efectos adversos relacionados con la reanimación (lista no exhaustiva): barotrauma, volutrauma, hipoxia, hipercarbia y neumonía por aspiración.

1.9. Notas generales

Si, durante el uso del dispositivo o como resultado de su uso, se produce un accidente grave, informe de ello al fabricante y a sus autoridades nacionales.

2. Descripción del dispositivo

El resucitador Ambu SPUR II se puede conectar al manómetro desecharable Ambu®, a las válvulas Ambu® PEEP y a las mascarillas Ambu®, tal como se describe en el apartado 4.3 Funcionamiento del resucitador.

3. Explicación de los símbolos utilizados

Indicación de los símbolos	Descripción
	Adulto Masa corporal ideal prevista superior a 30 kg
	Pediátrico Masa corporal ideal prevista de 6 a 30 kg
	Neonatal Masa corporal ideal prevista de hasta 10 kg

Indicación de los símbolos	Descripción
	Compatible con RM
	País de origen del fabricante
	Producto sanitario
	Varios usos en un único paciente
	No tire con fuerza de la bolsa del depósito de oxígeno

Encontrará una lista con la explicación de todos los símbolos en
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>.

4. Uso del producto

4.1. Principio de funcionamiento

La ilustración 1 muestra cómo se mezcla el flujo de gas de ventilación en la bolsa y su bombeo hacia y desde el paciente durante el funcionamiento manual del resucitador. Resucitador para adultos y niños 1a, resucitador neonatal 1b con bolsa de depósito de oxígeno cerrada (depósito de bolsa), resucitador neonatal 1c con tubo de depósito de oxígeno abierto (depósito de tubo).

El flujo de gas es similar cuando el paciente respira de forma espontánea a través del dispositivo.

El depósito de oxígeno cuenta con dos válvulas, una que permite absorber el aire ambiente cuando el depósito está vacío y otra para expulsar el exceso de oxígeno cuando la bolsa del depósito de oxígeno está llena.

El M-Port proporciona acceso al flujo de gas de inspiración y espiración, permitiendo conectar una jeringa para la administración de fármacos 1d o un conducto de muestreo de gas para la medición del flujo lateral de EtCO₂ 1e.

1.1 Liberación del exceso de oxígeno, 1.2 Entrada de aire, 1.3 Entrada de oxígeno, 1.4 Conector del paciente, 1.5 Espiración, 1.6 Puerto del manómetro, 1.7 Válvula limitadora de presión, 1.8 M-Port.

NOTA: el acoplamiento a 1.5 puede ser una protección contra salpicaduras o una válvula PEEP.

4.2. Inspección y preparación

Antes de disponer el resucitador de manera tal que pueda utilizarse en situaciones de emergencia (incluida la realización de una prueba de funcionalidad), se debe desembalar y preparar para su uso inmediato.

4.2.1. Preparación

- Si el resucitador está comprimido dentro de su embalaje, despliéguelo tirando de la válvula del paciente y de la válvula de admisión.
- Prepare el resucitador y coloque todos los elementos en la bolsa de transporte suministrada con el resucitador.
- Si la mascarilla suministrada junto con el resucitador está envuelta en una funda protectora, se deberá retirar dicha funda antes de su uso.

Consulte el apartado 4.2.2. (Tubo de oxígeno) para la preparación del dispositivo antes de su uso a menos de 0 °C.

4.2.2. Prueba de funcionamiento ②

Resucitador

Cierre la válvula limitadora de presión con el pasador de anulación y cierre el conector del paciente con el pulgar ②.1. Apriete ligeramente la bolsa comprimible. El resucitador debe resistir la presión.

Abra la válvula limitadora de presión deslizando el pasador de anulación y repitiendo el procedimiento. La válvula limitadora de presión debería activarse y debería ser posible escuchar el flujo de la válvula durante la compresión ligera de la bolsa comprimible.

Apriete y suelte el resucitador varias veces para asegurarse de que el aire se desplaza a través del sistema de válvulas y que sale por la válvula del paciente. ②.2

NOTA: Puesto que los discos de las válvulas se mueven durante la prueba de funcionamiento o durante la ventilación, puede que escuche un ligero sonido. Esto no supone ninguna merma en la funcionalidad del resucitador.

Tubo de oxígeno

El montaje del tubo de oxígeno y la prueba de funcionamiento de la bolsa del depósito de oxígeno y del tubo del depósito de oxígeno deben realizarse a temperaturas superiores a 0 °C. Para utilizar el resucitador a temperaturas inferiores a 0 °C, deje el tubo de oxígeno conectado al suministro de oxígeno después de la prueba de funcionamiento.

Bolsa del depósito de oxígeno

Proporcione un flujo de gas de 10 l/min en el conector de entrada de oxígeno. Finalmente, ayude a desplegar la bolsa con la mano. Compruebe que la bolsa del depósito de oxígeno se llena. De lo contrario, compruebe la integridad de los dos obturadores de válvula o si el depósito de oxígeno está rasgado.

A continuación, ajuste el flujo de gas suministrado de acuerdo con la indicación médica.

Tubo del depósito de oxígeno

Proporcione un flujo de gas de 10 l/min en el conector de entrada de oxígeno. Compruebe que el oxígeno sale por el extremo del tubo del depósito de oxígeno. De lo contrario, compruebe si el tubo de oxígeno está bloqueado. A continuación, ajuste el flujo de gas suministrado de acuerdo con la indicación médica.

MediPort

Retire el tapón del MediPort y bloquee el conector del paciente. Apriete la bolsa y compruebe que se escucha el sonido del aire que sale a través del M-Port. ③.3

4.3. Funcionamiento del resucitador

- Utilice las técnicas recomendadas para despejar la boca y la vía aérea del paciente, y para colocar correctamente al paciente con el fin de abrir la vía aérea.
- Sujete la mascarilla firmemente contra el rostro del paciente. ③.1
- Deslice la mano (versión para adultos) o los dedos anular y corazón (versión para niños) por debajo del asa. La versión neonatal no tiene asa de apoyo. La ventilación sin el asa de apoyo se puede lograr girando la bolsa. ③.2 Ventilación del paciente: Durante la insuflación, observe si se produce una elevación torácica. Retire la mano que sujetaba la bolsa de forma rápida, escuche el flujo respiratorio de la válvula del paciente y compruebe visualmente el descenso del pecho.
- Si se detecta una resistencia continuada a la insuflación, compruebe si hay alguna obstrucción en la vía aérea y recoloque al paciente para asegurarse de que la vía aérea esté abierta.
- Si el paciente vomita durante la ventilación, limpie inmediatamente la vía aérea del paciente y expulse el vómito del resucitador agitándolo y comprimiéndolo con fuerza y de forma rápida varias veces antes de reanudar la ventilación.
Si fuera necesario, límpie el producto con un paño que contenga alcohol y límpie la protección contra salpicaduras con agua.

Puerto del manómetro

El manómetro desechable de Ambu, así como un manómetro de terceros, puede conectarse al puerto del manómetro, situado en la parte superior de la válvula del paciente. Retire la tapa y acople el manómetro.

Sistema limitador de presión 4

La válvula limitadora de presión está ajustada para abrirse a 40 cm H₂O (4,0 kPa). 4.1

Si la valoración médica y profesional indica que se necesita una presión superior a 40 cm H₂O, la válvula limitadora de presión puede anularse desplazando el pasador de anulación sobre la válvula. 4.2

De forma alternativa, la válvula limitadora de presión puede anularse colocando un dedo sobre el botón rojo mientras se aprieta la bolsa.

MediPort

El resucitador Ambu SPUR II se suministra con o sin M-Port. El M-Port proporciona acceso al flujo de gas inspiratorio y espiratorio, y se puede utilizar para aplicar medicación, cuando se conecta a una jeringa, y también para medir el CO₂ del flujo lateral (EtCO₂). Cuando no lo utilice, recuerde cerrar el M-Port con la tapa roja.

Medición de EtCO₂

Para medir el EtCO₂ del flujo lateral, conecte la línea de muestreo de gas para el dispositivo de medición de EtCO₂ al M-Port del resucitador Ambu SPUR II. Conecte el conector de la línea de muestreo de gas girándolo 1/4 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

Administración de la medicación

Observe con atención la respuesta del paciente a la medicación administrada.

La administración de volúmenes de 1 ml de líquido o mayores a través del MediPort es comparable a la administración directa por un tubo endotraqueal. El M-Port se ha probado con epinefrina, lidocaína y atropina.

Versión de válvula de demanda del resucitador Ambu SPUR II 5

La versión de válvula de demanda del resucitador Ambu SPUR II está disponible en tamaños para adultos y pediátricos, y se puede utilizar con o sin válvula de demanda y se suministra con una bolsa de depósito de oxígeno acoplable.

La válvula de admisión del resucitador Ambu SPUR II se conecta a la válvula de demanda mediante un adaptador.

Acoplamiento de la válvula de demanda:

- Retire la unidad del depósito de oxígeno de la válvula de entrada del resucitador Ambu SPUR II, si está acoplada.
- Acople el adaptador al sistema de válvula de demanda.
- Inserte el adaptador de la válvula de demanda en la válvula de admisión del resucitador Ambu SPUR II.

NOTA: Utilice únicamente la pieza etiquetada como «unidad de compresión» con el adaptador y la válvula de demanda. La pieza etiquetada como «Bolsa del depósito de oxígeno» se considera una unidad auxiliar que se debe utilizar si falla la válvula de demanda.

Administración de oxígeno

Administre oxígeno de acuerdo con las indicaciones médicas.

La figura 6 muestra los porcentajes de oxígeno suministrado calculados que se pueden obtener con diferentes volúmenes y frecuencias de ventilación a diferentes velocidades de flujo de gas. Los porcentajes de oxígeno se pueden ver en 6. Adultos 6.1, Pediátricos 6.2, Neonatal 6.3.

Bolsa del depósito de oxígeno 7

La lámina fina de plástico de la bolsa del depósito de oxígeno no se puede separar de su punto de fijación al resucitador en ningún momento.

Accesarios 8

Los conectores del resucitador Ambu SPUR II cumplen las normas ISO 5356-1 y EN 13544-2, lo que hace que sea compatible con otros equipos hospitalarios. Al conectar dispositivos externos, asegúrese de comprobar su funcionamiento y de consultar las instrucciones de uso del dispositivo externo.

Los productos Ambu compatibles con el resucitador Ambu SPUR II se indican a continuación:

Mascarilla facial desechable de Ambu®

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso de la mascarilla desechable de Ambu.

Válvula Ambu® PEEP 20 desechable 8.1 8.2

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso de la válvula Ambu PEEP 20 desechable o consulte la ilustración 8.1 de estas instrucciones de uso. Para colocar la válvula Ambu PEEP 20 desechable (si fuera necesario) en el resucitador, retire la protección contra salpicaduras. 8.2

Manómetro desechable Ambu® 8.3

Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso del manómetro desechable de Ambu.

4.4. Tras la utilización

Los productos utilizados se deben desechar y eliminar de conformidad con los procedimientos locales.

5. Especificaciones técnicas del producto

5.1. Estándares aplicados

El resucitador Ambu SPUR II cumple la norma específica para este tipo de productos EN ISO 10651-4.

5.2. Especificaciones

	Neonatal	Pediátrico	Adulto
Volumen del resucitador	aprox. 220 ml	aprox. 670 ml	aprox. 1510 ml
Volumen administrado con una mano*	150 ml	450 ml	600 ml
Volumen administrado con dos manos*	-	-	1000 ml
Dimensiones (longitud x diámetro) sin depósito ni accesorio	aprox. 190 x 71 mm	aprox. 223 x 99 mm	aprox. 284 x 127 mm
Peso sin depósito ni accesorio	aprox. 70 g	aprox. 145 g	aprox. 220 g
Válvula limitadora de presión**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Espacio muerto	≤5 ml + 10 % del volumen deseado	≤5 ml + 10 % del volumen deseado	≤5 ml + 10 % del volumen deseado
Resistencia inspiratoria**	máx. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) a 5 l/min	máx. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) a 50 l/min	máx. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) a 50 l/min
Resistencia espiratoria***	máx. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) a 5 l/min	máx. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) a 50 l/min	máx. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) a 50 l/min
Volumen del depósito	aprox. 300 ml (bolsa) aprox. 100 ml (tubo)	aprox. 2600 ml (bolsa)	aprox. 2600 ml (bolsa)

	Neonatal	Pediátrico	Adulto
Conejero del paciente		Exterior, 22 mm, macho (ISO 5356-1) Interior, 15 mm, hembra (ISO 5356-1)	
Conejero de espiración (para acoplamiento de válvula PEEP)		30 mm, macho (ISO 5356-1)	
Conejero del puerto del manómetro		Ø 4,2 +/- 0,1 mm	
Conejero de la válvula de demanda	-	Interior, 32 mm, hembra (EN ISO 10651-4)	
Fugas de avance y retroceso		Sin medición	
MediPort		Conejero compatible con EN ISO 80369-7	
Conejero de admisión de O ₂		De conformidad con la norma EN 13544-2	
Límites de temperatura de funcionamiento	-18 °C a +50 °C (-0,4 °F a +122 °F), probados de conformidad con la norma EN ISO 10651-4		
Límites de temperatura de almacenamiento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F), probados de conformidad con la norma EN ISO 10651-4		
Almacenamiento de larga duración recomendado en un envase cerrado a temperatura ambiente, alejado de la luz solar.			

* Probado de conformidad con la norma EN ISO 10651-4.

** Puede obtenerse una presión de suministro superior anulando la válvula limitadora de presión.

*** En condiciones de prueba generales de conformidad con la norma EN ISO 10651-4.

5.3. Información de seguridad sobre RM

El resucitador Ambu SPUR II¹y el resucitador Ambu SPUR II con válvula desecharable Ambu PEEP 20² acoplada, y el resucitador Ambu SPUR II con la válvula desecharable Ambu PEEP 20 y el manómetro de presión desecharable Ambu² acoplados son compatibles con resonancia magnética, por lo que se pueden utilizar de forma segura en el entorno de resonancia magnética (no dentro del túnel de RM) en las siguientes condiciones.

Campo magnético estático de 7 teslas o menos, con

- Gradiente de campo espacial máximo de
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Fuerza máxima del producto de
 - 450 000 000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G2/cm (721 T²/m)²

El uso dentro del túnel de resonancia magnética puede influir en la calidad de la imagen de RM.

No se han probado el calentamiento inducido por RF ni los artefactos en las imágenes de RM. Las piezas metálicas están totalmente encapsuladas y no entran en contacto con el cuerpo humano.

1. Oluline teave – Lugege enne kasutamist

Enne Ambu® SPUR® II hingatamisseadme kasutamist lugege käesolevad ohutusjuhised tähelepanelikult läbi. Kasutusjuhiseid võidakse täiendada ilma etteateamiseta. Käesoleva versiooni koopiaid saab soovi avaldamisel tootjalt. Palun võtke arvesse, et need juhised ei selgita ega käsitle kliinilisi protseduure. Need kirjeldavad ainult hingatamisseadme üldist kasutamist ja kasutamisega seotud ettevaatusabinöusid. Enne hingatamisseadme esmakordset kasutamist peavad kasutajad läbima piisava väljaõppe hingatamisseadmete kasutamisel ja viima end kurssi käesolevais kasutusjuhistes leiduvate suuniste, hoiatuste, ettevaatusabinöude ja vastunäidustustega. Ambu SPUR II hingatamisseadmel pole garantii.

1.1. Kasutusotstarve

Ambu SPUR II hingatamisseade on ühel patsiendil kasutatav pulmonaarseks elustamiseks möeldud seade.

1.2. Kasutamise näidustused

Ambu SPUR II hingatamisseade on möeldud kasutamiseks olukordades, kus kunstlikuks ventilatsiooniks on vajalik manuaalne kardiopulmonaarne hingatamisseade.

Ambu SPUR II hingatamisseade on näidustatud patsientidele ventileerimiseks ja hapnikuga varustumiseks seni, kuni on võimalik luua püsivam hingamistee või patsient on taastunud.

1.3. Ettenähtud sihtrühm

Versioonide rakenduste suurusvahemikud.

- Täiskasvanute versioon:** üle 30 kg (66 naela) kaaluvad täiskasvanud ja lapsed.
- Pediaatriline versioon:** imikud ja lapsed kehakaaluga 6 kg kuni 30 kg (13–66 naela).
- Imikute versioon:** kuni 10 kg (22 naela) kaaluvad vastsündinud ja imikud.

Pange tähele, et köik Ambu SPUR II hingatamisseadme konfiguratsioonid ei ole köigi kolme patsiendivahemiku jaoks saadaval.

1.4. Kasutajate sihtgrupp

Hingamisteede alase väljaõppe saanud meditsiinitöötajad, nagu anestesioloogid, öed, päästetöötajad ja hädaabitöötajad.

1.5. Vastunäidustused

Ei ole teada.

1.6. Kliinilised eelised

Hingamisteede lahtihoidmise baastehnika, milles kasutatakse manuaalset hingatamisseadet ning mis võimaldab patsienti ventileerida ja hapnikuga varustada seni, kuni on võimalik luua püsivam hingamistee või patsient on taastunud.

1.7. Hoiatused ja ettevaatusabinöud

Ettevaatusabinöude eiramine võib põhjustada patsiendi ebapiisava ventileerimise ja hapnikuga varustumise või seadme kahjustuse.

HOIATUSED

1. Nakkusohu välimiseks ärge kasutage hingatamisseadet kauem kui kokku 4 tundi maksimaalselt 1 nädala jooksul.
2. Nakkus- ja rikkeohu välimiseks ärge kasutage hingatamisseadet uuesti, kui seadmesse jäab nähtavat niiskust või jäÄe.
3. Veenduge, et ekspiratoorse porti oleks ühendatud kas pritsmekaitse või Ambu PEEP-klapp. Avatud ekspiratoorne port võib kogemata ummistuda ja tekitada kopsudes liiga suure õhumahu, mis võib põhjustada koetrauma.
4. Koekahjustuste välimiseks ärge kasutage hingatamisseadet toksilistes või ohtlikest keskkondades.
5. Veenduge alati, et hapnikumahutivoolik ei oleks ummistonud, kuna vooliku ummistonumine võib takistada kompressioonikoti uuesti täitumist, muutes ventileerimise võimatust.

- 6. Ärge kasutage toodet, kui see on saastunud väliste allikatega, sest see võib pöhjustada infektsiooni.
- 7. Kontrollige toodet alati visuaalselt ja tehke toimivustest pärast lahtipakkimist ja kokkupanemist ning enne kasutamist, sest defektid ja võörkehad võivad pöhjustada patsiendi mitteventileerimise või ebapiisava ventileerimise.
- 8. Ärge kasutage toodet, kui toimivustest nurjub, kuna see võib pöhjustada patsiendi mitteventileerimise või ebapiisava ventileerimise.
- 9. Ärge alistage ülerõhuklappi muul juhul, kui ainult meditsiinilise hinnanguga tuvastatud vajaduse korral. Suured ventileerimisröhud võivad pöhjustada barotraumasid.
- 10. Ainult ühel patsiendil kasutamiseks. Teistel patsientidel kasutamine võib pöhjustada ristsaastumist.
- 11. Ravimit ei saa M-pordi kaudu manustada, kui hingatamisseadme ja näomaski vahele on ühendatud tarvikuid (nt filter, CO₂ andur).
- 12. Ärge jätké pärast kasutamist M-porti avatuks, et vältida lekkeid, mis võivad pöhjustada patsiendile edastatava O₂ koguse vähenemist.
- 13. M-Porti ei tohi kasutada patsientide külgvoolu EtCO₂ jälgimiseks patsientide puhul, keda ventileeritakse alla 400 ml ventilatsioonimahuga, et vältida EtCO₂ mõõtmiste ebatäpsusi.
- 14. Kui manustate ravimit alla 1 ml mahuga, tuleb ravimi täpsse manustamisannuse tagamiseks M-porti loputada.
- 15. Ärge ühendage M-porti hapnikuvarustusvoolikut, kuna patsiendile ei edastata ettenähtud O₂ kontsentratsiooni.
- 16. Tarvikute lisamine võib suurendada inspiratoorset ja/või ekspiratoorset takistust. Ärge paigaldage tarvikuid, kui hingamistakistuse suurenemine võib patsienti kahjustada.
- 17. Kasutamiseks ainult ettenähtud kasutajatele, kes on tuttavad käesolevate kasutamisjuhiste sisuga, sest valesti kasutamine võib patsienti kahjustada.
- 18. Täiendava hapniku kasutamisel ärge lubage tulekahju- ja/või plahvatusohu töötu suitsetamist ega kasutage seadet lahtise leegi, öli, rasva, muude tuleohtlike kemikaalide või seadmete ja tööriistade läheduses, mis võivad tekitada sädemeid.
- 19. Ärge proovige kinnitada koormusklappi seadme imikuversiooni külge, kuna see võib pöhjustada suuri hapnikukontsentratsioone, mis võib mõjuda vastsündinule kahjustavalt.
- 20. Kui hingatamisseade on kinnitatud näomaski külge, olge eriti tähelepanelik ülemiste hingamisteede täieliku/osalise obstruktsiooni tundmärkide suhtes, kuna selline kasutus pöhjustab hapniku mitteedastamist või edastatava hapnikukoguse vähenemist. Vöimaluse korral kasutage õhu patsiendile edastamiseks näomaskile alternatiivset moodust.
- 21. Insuflatsiooniohu töötu ärge kasutage toodet koos selle külge kinnitatud näomaskiga kaasasündinud diafragmasongaga imikute ventileerimiseks. Vöimaluse korral kasutage õhu patsiendile edastamiseks näomaskile alternatiivset moodust.
- 22. Protseduuri teostavad spetsialistid peavad hindama valitava hingatamisseadme suurust ja kasutatavaid tarvikuid (nt näomask, PEEP-klapp jne) vastavalt konkreetse patsiendi seisundi(te),le, kuna valesti kasutamine võib patsienti kahjustada.
- 23. Ärge kasutage seadet Ambu SPUR II, kui on vajalik vaba vooluga hapniku manustamine, kuna võimalik ebapiisav hapnikuvarustus võib pöhjustada hüopksiat.
- 24. Kui rõhku ei jälgita, tuleb manomeetri kork alati manomeetri pordile tagasi panna, et vältida leket, mis võib pöhjustada patsiendile edastava O₂ koguse vähenemist.
- 25. Eelpaigaldage hapnikuvoolik alati hapnikuvarustuse külge temperatuuril üle 0 °C, sest temperatuuril alla 0 °C võib paigaldamine olla raskendatud, mis omakorda pöhjustab patsiendile edastava hapniku koguse vähenemist.
- 26. Kui kasutate hingatamisseadet koos kinnitatud näomaskiga, veenduge, et näomask oleks õigesti ja tihealt asetatud, sest ebapiisav tihindus võib pöhjustada õhu kaudu levivate nakkushaiguste jöudmist kasutajani.

ETTEVAATUSABINÖUD

- 1. Ärge hoiundage hingatamisseadet kunagi väänatult (välia arvatum tootja volditud tarneolekus): vastasel juhul moondub kott püsivalt, mis võib mõjutada ventilatsiooni tõhusust. Voltimiskohat on kobil selgelt nähtav (voltida tohib vaid täiskasvanute ja pediatrilist versiooni).

- Ventileerimise kontrollimiseks jälgige alati rindkere liikumist ja kuulake patsiendiklapि ekspiratoorset voolu. Kui hingatamisseadmega ei ole võimalik patsienti ventileerida, siis asuge kohe tegema patsiendile suust-suhu hingamist.
- Ärge leotage, loputage ega steriliseerige seadet, sest see võib jätta seadmele kahjulikke jääke või pöhjustada seadme riket. Seadme ehituse ja materjalgi töttu ei saa seda tavapärasest puhastus- ja steriliseerimisprotseduuridega puhastada.
- Kasutage M-porti ainult ühel juhul kahest: EtCO₂ mõõtmiseks või ravimi manustumiseks, kuna see võib mõõdetud väärtsusi muuta.
- Võimalusel lugege tarviku pakendilt konkreetse tarviku kohta lisateavet, kuna valesti käsitlemine võib pöhjustada kogu toote rikke.
- Muu tootja toodete ja hapnikuedastusseadmete (nt filtri ja koormusklapid) kasutamine koos Ambu SPUR II hingatamisseadmega võib möötudata toote toimimist. Palun konsulteerige muu tootja seadme tootjaga, et kontrollida seadme ühilduvust Ambu SPUR II hingatamisseadmega ja saada teavet võimalike toimimismuutuste kohta.
- Hapnikumahutikott on täiskasvanute ja pediaatriliste hingatamisseadmete sisselaskeklapि külge püsivalt kinnitatud, välja arvatud koormusklapiga versioonidel. Ärge üritage seda lahti monteerida. Ärge tömmake hapnikumahutikotti, kuna see võib pöhjustada seadme rikke.

1.8. Võimalikud körvaltoimed

Hingatamisega seotud võimalikud körvaltoimed (mittetäielik nimekiri): barotrauma, volutrauma, hüpoksia, hüperkarbia ja aspiratsionipneumoonia.

1.9. Üldised märkused

Kui selle seadme kasutamise ajal või kasutamise tulemusel on aset leidnud tösine vahejuhtum, teatage sellest palun tootjale ja vastavale riiklikule asutusele.

2. Seadme kirjeldus

Ambu SPUR II hingatamisseadme saab ühendada Ambu® ühekordsest kasutatava manomeetriga, Ambu® PEEP-klappide ja Ambu® näomaskidega vastavalt kirjeldustele jaotises 4.3. Hingatamisseadme kasutamine.

3. Kasutatud sümbolite selgitused

Sümbolite tähendused	Kirjeldus
	Täiskasvanute versioon Ettenähtud ideaalne kehamass üle 30 kg
	Pediaatriline versioon Ettenähtud ideaalne kehamass alates 6 kuni 30 kg
	Imikute versioon Ettenähtud ideaalne kehamass kuni 10 kg
	Tingimuslikult MR-sobiv
	Tootja riik
	Meditsiiniseade

Sümbolite tähendused	Kirjeldus
	Korduskasutuseks ühel patsiendil
	Ärge tömmake hapnikumahutikotti jõuga

Täielik nimekiri sümbolite selgitustest on leitav aadressil
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Toote kasutamine

4.1. Tööpöhimötted

Joonis 1 kujutab ventilatsioonigaasisegude liikumist kotti ning patsiendile ja patsiendilt tagasi hingatamisseadme kätsi kasutamise korral. 1a Täiskasvanute ja pediaatriline hingatamisseade, 1b imikute hingatamisseade suletud hapnikumahutikotiga (kottmahuti), 1c imikute hingatamisseade avatud hapnikumahutivoolikuga (voolikmahuti).

Hingamisgaaside vool sarnaneb vooluga, mis tekib, kui patsient hingab spontaanselt läbi seadme.

Hapnikumahuti on varustatud kahe klapiga. Üks võimaldab ümbritseva õhu sissemistemist, kui mahuti on tühi, ja teine liigse hapniku väljutamist, kui hapnikumahutikott on täitunud.

M-port tagab juurdepääsu inspiratoorsele ja ekspiratoorsele gaasivoolule, võimaldades ühendada süstla ravimi manustumiseks 1d või ühendada gaasi proovivõtuliini kõrvalvoolu EtCO₂ mõõtmiseks 1e.

1.1 Ülemäärase hapniku väljutamine, 1.2 õhu sisselase, 1.3 hapniku sisselase, 1.4 patsiendiliitmik, 1.5 ekspiratsioon, 1.6 manomeetri port, 1.7 üleröhuklapp, 1.8 M-port.

MÄRKUS. Kinnitus 1.5 külge võib olla kas pritsmekaitse või PEEP-klapp.

4.2. Ülevaatus ja ettevalmistamine

Enne, kui hingatamisseade asetatakse hädaolukorras kasutamiseks ettenähtud kohta, tuleb see lahti pakkida ja koheseks kasutamiseks ette valmistada.

4.2.1. Ettevalmistamine

- Kui hingatamisseade on pakendatud kokkusurutult, avage see, hoides kinni ning tömmates patsiendiklapist ja sisselaskeklapist.
- Valmistage hingatamisseade ette ja asetage kõik esemed hingatamisseadmega kaasas olnud kandekotti.
- Kui hingatamisseadmega kaasas olev näomask on pakitud kaitsekotti, siis tuleks see kott enne kasutamist eemaldada.

Vt jaotist 4.2.2. (hapnikuvoolik) seadme ettevalmistamiseks enne kasutamist temperatuuril alla 0 °C.

4.2.2. Toimivuse testimine 2

Hingatamisseade

Sulgege üleröhuklapp alistusklambriga ja sulgege patsiendiliitmik pöidlaga 2.1. Pigistage intensiivselt kokkusurutavat kotti. Hingatamisseade avaldab pigistamisele vastupanu.

Avage üleröhuklapp, libistades alistusklamibri eemale ja korrates protseduuri. Üleröhuklapp peaks nüüd olema aktiveeritud ja kokkusurutava koti intensiivsel pigistamisel peaks olema kuulda klapist õhu voolamist.

Suruge hingatamisseadet mõned korrad kokku ja lahti, et veenduda õhu liikumises läbi klapisüsteemi ja patsiendiklapist välja. 2.2

MÄRKUS. Kuna klapi kettad toimivustesti või ventileerimise ajal liiguavad, võib kostuda nörka heli. See ei mõjuta hingatamisseadme töökindlust.

Hapnikuvoolek

Hapnikuvooleku paigaldamine ning hapnikumahutikoti ja hapnikumahutivoooliku toimivustest tuleb teha temperatuuril üle 0 °C. Hingatamisseadme kasutamiseks temperatuuril alla 0 °C jätke hapnikuvoolek pärast toimivustesti tegemist hapnikuvärvustusega ühendatuks.

Hapnikumahutikott

Rakendage hapniku sisselaskeliitmikusse gaasivool 10 l/min. Löpuks toetage käega koti lahti voltimist. Kontrollige, et hapnikumahutikott täituks. Kui ei täitu, kontrollige, kas kaks klapi sulgurit on terved ja ega hapnikumahutil pole rebendeid.

Seejärel reguleerige gaasivoolu vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

Hapnikumahutivoolek

Rakendage hapniku sisselaskeliitmikusse gaasivool 10 l/min. Kontrollige, kas hapnik voolab hapnikumahutivooleku otsast välja. Kui ei, kontrollige, ega hapnikuvoolek ole ummistonud. Seejärel reguleerige gaasivoolu vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

M-port

Eemaldage M-pordi kork ja blokeerige patsiendiliitmik. Pigistage kotti ja kontrollige, kas on kuulda M-pordist väljuva õhu häält. **2.3**

4.3. Hingatamisseadme kasutamine

- Kasutades soovitatud tehnikaid avage patsiendi suu ja hingamisteed ning asetage patsient õigesse asendisse, et hingamisteed poleks takistatud.
- Hoidke näomaski kindlalt vastu patsiendi nägu. **3.1**
- Libistage käsi (täiskasvanute versioon) või keskmine ja nimeta sõrm (pediaatriline versioon) sanga alla Imikute versioonil ei ole tugisanga. Ilma tugisangata ventileerimiseks

keerake kotti. **3.2** Patsiendi ventileerimine. Insuflatsiooni ajal jälgige rindkere tõusu. Vabastage kotti hoidev käsi järsult ning kuulake ekspiratoorset voolu patsiendiklapist ja jälgige rindkere langemist.

- Kui insuflatsioon on jätkuvalt takistatud, veenduge, et hingamisteed poleks takistatud, ning muutke patsiendi asendit, et tagada hingamisteede avatus.
- Kui patsient ventileerimise ajal oksendab; puhastage kohe patsiendi hingamisteed ja enne ventileerimise jätkamist väljutage okse hingatamisseadmost hingatamisseadet mitu korda raputades ning tugevalt ja kiiresti kokku surudes. Vajaduse korral pühkige toode alkoholis immutatud lapiga üle ja puhastage pritsmekaitse veega.

Manomeetri port

Patsiendiklapile ülaosas asuvasse manomeetri porti saab ühendada Ambu ühekordsele kasutatava manomeetri või muu tootja manomeetri. Eemaldage kork ja ühendage manomeeter.

Ülerõhusüsteem **4**

Ülerõhuklap on seadistatud avanema 40 cm H₂O (4,0 kPa) juures. **4.1**

Kui meditsiinilise ja professionaalse hinnangu alusel on vajalik rõhk üle 40 cm H₂O, saab ülerõhuklapile alistada, liigutades klapile alistusklambris. **4.2**

Teine võimalus ülerõhuklapile alistamiseks on koti pigistamise ajal asetada sõrm punasele nupule.

M-port

Ambu SPUR II hingatamisseade tarnitakse kas M-pordiga või ilma selleta. M-port võimaldab juurdepääsu inspiratoorsele ja ekspiratoorsele gaasivoolule ning süstlagu ühendamisel saab seda kasutada ravimite manustamiseks, samuti körvalvoolu CO₂ (EtCO₂) mõõtmiseks. Kui M-porti ei kasutata, tuleb see kindlasti punase M-pordi korgiga sulgeda.

EtCO₂ mõõtmine

Kõrvalvoolu EtCO₂ mõõtmiseks; ühendage EtCO₂ mõõteseadme gaasiproovi voolik Ambu SPUR II hingatamisseadme M-pordiga. Ühendage gaasiproovi vooliku liitmik, paigaldades selle ja pöörates seejärel 1/4 pööret päripäeva.

Ravimite manustamine

Jälgige hoolikalt patsiendi reaktsiooni määratud ravimihulgale. 1 ml või enama vedeliku manustamine läbi M-pordi on vörreldav otse intubatsioonitorru manustamisega. M-porti on testitud epinefriini, lidokaiini ja atropiiniga.

Ambu SPUR II hingatamisseadme koormusklapiga versioon 5

Ambu SPUR II hingatamisseadme koormusklapiga versioon on saadaval täiskasvanute ja pediaatrilistel seadmetel ning seda saab kasutada nii koormusklapiga kui ka ilma selleta; seadme komplekti kuulub eemaldatav hapnikumahutikott.

Ambu SPUR II hingatamisseadme sisselaskeklapp ühendatakse koormusklapiga adapteri abil. Koormusklapi kinnitamine

- Eemaldage hapnikumahutiseade Ambu SPUR II hingatamisseadme sisselaskeklapi küljest, kui see on paigaldatud.
- Kinnitage adapter koormusklapisüsteemi külge.
- Sisestage koormusklapi adapter Ambu SPUR II hingatamisseadme sisselaskeklappi.

MÄRKUS. Kasutage adapteri ja koormusklapiga ainult osa sildiga „compression unit“ (kompressiooniseade). Osa sildiga „Oxygen Reservoir Bag“ (Hapnikumahutikott) on varuks koormusklapi rikke korral.

Hapniku edastamine

Edastage hapnikku vastavalt meditsiinilisele näidustusele.

Joonisel 6 kujutatakse hapniku arvutatud edastusprotsente, mis on saavutatavad erinevate ventilatsioonimahtude ja -sagedustega erinevatel gaasivoolukiirustel. Hapniku protsente saab vaadata versioonides 6 Täiskasvanud 6.1, Pediaatriline 6.2, Imikud 6.3.

Hapnikumahutikott 7

Öhukest hapnikumahutikoti plastkilet ei ole võimalik hingatamisseadme kinnituspunktidel küljest lahti võtta.

Tarvikud 8

Ambu SPUR II hingatamisseadme liitmikud vastavad standarditele ISO 5356-1 ja EN 13544-2, mistöötu sobivad ka muude haiglaseadmetega. Väliste seadmete ühendamisel tehke kindlasti toimivustest ja lugege välise seadme kasutamisjuhiseid.

Allpool on loetletud Ambu tooted, mis ühilduvad Ambu SPUR II hingatamisseadmega.

Ambu® ühekordselt kasutatav näomask

Lisateavet vt Ambu ühekordselt kasutatava näomaski kasutamisjuhistest.

Ambu® ühekordselt kasutatav PEEP 20 klapp 8.1 8.2

Lisateavet leiate Ambu ühekordselt kasutatava PEEP 20 klapi kasutamisjuhistest või vaadake joonist 8.1 käesolevaid kasutamisjuhistes. Ambu ühekordselt kasutatava PEEP 20 klapi paigaldamiseks (kui see on vajalik) hingatamisseadmele eemaldage pritsmekaitse. 8.2

Ambu® ühekordselt kasutatav manomeeter 8.3

Lisateavet vt ühekordselt kasutatava Ambu manomeetri kasutamisjuhistest.

4.4. Pärist kasutamist

Kasutatud tooted tuleb kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

5. Toote tehnilised andmed

5.1. Kohaldatavad standardid

Ambu SPUR II hingatamisseade vastab tootepõhisele standardile EN ISO 10651-4.

5.2. Tehnilised andmed

	Imikute versioon	Pediaatriline versioon	Täiskasvanute versioon
Hingatamisseadme maht	umbes 220 ml	umbes 670 ml	umbes 1510 ml
Edastav maht ühe käega*	150 ml	450 ml	600 ml
Edastav maht kahe käega*	-	-	1000 ml
Mõõtmed (pikkus x läbimõõt) ilmal mahuti ja tarvikuta	umbes 190 x 71 mm	umbes 223 x 99 mm	umbes 284 x 127 mm
Kaal ilma mahuti ja tarvikuta	umbes 70 g	umbes 145 g	umbes 220 g
Üleröhuklapp**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Tühimaht	≤ 5 ml + 10 % edastatavast mahust	≤ 5 ml + 10 % edastatavast mahust	≤ 5 ml + 10 % edastatavast mahust
Inspiratoorne takistus***	max 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) kiiruse 5 l/min	max 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) kiiruse 50 l/min	max 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) kiiruse 50 l/min
Ekspiratoorne takistus***	max 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) kiiruse 5 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) kiiruse 50 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) kiiruse 50 l/min
Mahuti maht	umbes 300 ml (kott) umbes 100 ml (voolek)	umbes 2600 ml (kott)	umbes 2600 ml (kott)
Patsiendiliitnik	Väljine 22 mm, pistikühendus (ISO 5356-1) Sisemine 15 mm, pesähendus (ISO 5356-1)		
Ekspiratoorne liitnik (PEEP-klapi kinnituseks)	30 mm, pistikühendus (ISO 5356-1)		
Manomeetri pordi liitnik	Ø 4,2 +/- 0,1 mm		
Koormusklapi liitnik	-	Sisemine 32 mm, pesähendus (EN ISO 10651-4)	
Edasi- ja tagasipidine leke	Ei ole mõõdetav		

	Imikute versioon	Pediaatriline versioon	Täiskasvanute versioon
M-port	Standardiga EN ISO 80369-7 ühilduv liitnik		
O ₂ sisselaskeliitnik	Vastavalt standardile EN 13544-2		
Töötemperatuuri piirid	-18 °C kuni +50 °C (-0,4 °F kuni +122 °F), testitud vastavalt standardile EN ISO 10651-4		
Hoiustamistemperatuuri piirid	-40 °C kuni +60 °C (-40 °F kuni +140 °F), testitud vastavalt standardile EN ISO 10651-4		
Pikaajaliselt on soovitatav hoiustada suletud pakendis toatemperatuuril, eemal päikesevalgusest.			

* Kontrollitud vastavalt EN ISO 10651-4

** Suurema väljundröhü saab üleröhuklapi alistamisel.

*** Üldistel katsetingimustel vastavalt standardile EN ISO 10651-4.

5.3. MRT ohutusteave

Ambu SPUR II hingatamisseade¹ ja Ambu SPUR II hingatamisseade koos paigaldatud Ambu ühekordsest kasutatava PEEP 20 klapiga² ning Ambu SPUR II hingatamisseade koos paigaldatud Ambu ühekordsest kasutatava PEEP 20 klapi ja Ambu ühekordsest kasutatava manomeetriga² on tingimuslikult MR-sobivad ning neid võib seetõttu ohultult kasutada MR-keskkonnas (mitte MR-seadme sees), kui täidetud on järgmised tingimused.

Staatiline magnetväli 7 teslat ja vähem

- Maksimaalne ruumiline väljagradient
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Maksimaalne jõuprodukt
 - 450 000 000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G2/cm (721 T²/m)²

MR-seadme sees kasutamine võib mõjutada MR-kujutise kvaliteeti.

Raadiosageduslikust (RF) kiirgusest tingitud kuumenemist ja MR-kujutise artefakte ei ole testitud. Kõik metallosad on täielikult kapseldatud ja ei puutu inimkehaga kokku.

1. Tärkeää tietoa – Lue ennen käyttöä

Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen Ambu® SPUR® II -elvytyspalkeen käyttöä. Tätä käyttöopasta voidaan päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Lisäkopiota voimassa olevasta versiosta saa pyydettäässä. Huomioi, että näissä ohjeissa ei selitetä eikä käsittellä kliinisiä toimenpiteitä. Ohjeissa kuvataan vain elvytyspalkeen käyttöön liittyvästä perustoinnista ja varotoimia. Ennen elvytyspalkeen käytön aloittamista on tärkeää, että käyttäjille on opetettu riittävästi elvytystekniikoilta käyttöä ja että he ovat tutustuneet näiden ohjeiden sisältämiin käyttötarkoituksiin, varoituksiin, huomautuksiin ja kontraindikaatioihin. Ambu SPUR II -elvytyspalkeella ei ole takuuta.

1.1. Käyttötarkoitus

Ambu SPUR II on yhden potilaan keuhkoelvytykseen tarkoitettu elvytyspalje.

1.2. Käyttöindikaatiot

Ambu SPUR II -elvytyspalje on tarkoitettu tilanteisiin, joissa manuaalista sydän-keuhkoelvyystä tarvitaan ventilaation tukemiseen.

Ambu SPUR II -elvytyspalje on tarkoitettu potilaan ventilaatioon ja hapetukseen, kunnes varmempi ilmatie saadaan aikaan tai potilas elpyy.

1.3. Potilaskohderyhmä

Eri versioiden kokovalikoima:

- **Aikuinen:** Aikuiset ja lapset, ruumiinpaino yli 30 kg (66 lb).
 - **Lapsi:** Vauvat ja lapset, ruumiinpaino 6 – 30 kg (13 – 66 lb).
 - **Vauva:** Vastasyntyneet ja vauvat, ruumiinpaino korkeintaan 10 kg (22 lb).
- Ota huomioon, että kaikkia Ambu SPUR II -kokoonpanoja ei ole saatavilla kaikille kolmelle potilasryhmälle.

1.4. Käyttäjä

Hengitysteiden hallintakoulutuksen saaneet ammattilaiset, kuten anestesiologit, sairaanhoitajat, pelastushenkilökunta ja ensivastehenkilökunta.

1.5. Vasta-aiheet

Ei tunnettuja.

1.6. Kliiniset edut

Perustason ilmatien hallinta elvytyspalkeella mahdollistaa potilaan ventilaation ja hapetukseen, kunnes varmempi ilmatie saadaan aikaan tai potilas elpyy.

1.7. Varoitukset ja huomautukset

Näiden varotoimien noudattamatta jättämisestä voi seurata potilaan tehoton ventilaatio tai hapetus tai laitteiston vahingoittuminen.

VAROITUKSET

1. Älä käytä elvytyspaljetta yhteensä yli neljän tunnin ajan enintään viikon kuluessa infektoriskin torjumiseksi.
2. Älä käytä elvytyspaljetta, jos laitteen sisälle on jäyntä näkyvää kosteutta tai jäämiä infektoriskin ja toimintähäiriön välttämiseksi.
3. Varmista, että uloshengityslitätäntä on liitetty joko roiskesuoja tai Ambu PEEP -venttiili. Avoin uloshengityslitätäntä voi mennä vahingossa tukkoon, jolloin keuhkoihin joutuu liian suuri määrä ilmaa, mikä voi johtaa kudosvaarioihin.
4. Vältä elvytyspalkeen käyttöä myrkyllisessä ja vaarallisissa ympäristöissä kudosvarioriskin välttämiseksi.
5. Varmista aina, ettei hapenkeräyuspussin letku ole tukossa, sillä letkun tukkeutuminen voi estää painelupussin täyttymisen, mikä voi estää ventiloinnin.

6. Älä käytä tuotetta, jos se on ulkoisten lähteiden kontaminoima, sillä se voi aiheuttaa infektion.
7. Tarkista tuote aina silmämääriäisesti ja suorita toimintatesti pakauksesta ottamisen jälkeen, kokoamisen jälkeen ja ennen käyttöä, sillä häiriöt ja vierasesineet voivat estää potilaan ventilaation tai heikentää sitä.
8. Älä käytä tuotetta, jos toimintatesti epäonnistuu, sillä se voi estää potilaan ventilaation tai heikentää sitä.
9. Älä ohita paineenrajoitusventtiiliä ellei se ole tarpeen lääketieteellisen arvioinnin perusteella. Korkea ventiloointipaine voi aiheuttaa barotrauman.
10. Vain kertakäytöön. Jos laitetta käytetään toisilla potilailla, seurauksena voi olla risti-infektio.
11. M-port-lääkkeenantoportin kautta ei voi antaa lääkitystä, jos elvytyspalkeen ja kasvomaskin välissä on lisävarusteita (esim. suodatin, CO₂-ilmainsi).
12. Älä jätä M-port-lääkkeenantoportia auki käytön jälkeen. Nämä vältetään vuoto, joka voi heikentää O₂:n toimitusta potilaalle.
13. M-Port-lääkkeenantoportia ei saa käyttää sivuvirtauksen EtCO₂:n tarkkailuun potilaille, joiden ventiloitava kertahengitystilavuus on alle 400 ml, sillä tässä tapauksessa EtCO₂-mittaus voi olla epätarkka.
14. Kun annostellaan alle 1 ml lääkevalmistetta, M-port-lääkkeenantoportti on huuhdeltava oikean lääkeannoksen toimituksen varmistamiseksi.
15. Älä liitä happiletkua M-port-lääkkeenantoporttiin, sillä tarkoitettua O₂-pitoisuutta ei toimiteta potilaalle.
16. Lisävarusteiden liittäminen voi lisätä sisäänhengitys- tai uloshengitysvastusta. Älä liitä lisävarusteita, mikäli suurempi hengitysvastus olisi haitallista potilaalle.
17. Tarkoitettu vain näihin käyttöohjeisiin tutustuneiden käyttäjien käyttöön, sillä vääränlainen käyttö voi vahingoittaa potilaasta.
18. Kun käytetään lisähappea, tupakointi ja laitteen käyttäminen avotulen, öljyn, voiteiluaineiden, muiden sytytysten kemikaalien tai kipinöitä tuottavien laitteiden ja työkalujen lähellä on kielletty tulipalo- ja/tai räjähdyksvaaran takia.
19. Älä yritä liittää tarveventtiiliä vauvan tuoteversioon, sillä se voi nostaa happipitoisuuden vastasyntyneelle haitalliselle tasolle.
20. Tarkkaile ylähengitystien osittaista tai kokonaan tukkeutumista, kun käytät elvytyspaljettä kasvomaskin kanssa, sillä se voi estää tai heikentää hapen toimittamisen. Jos saatavilla on kasvomaskille vaihtoehtoinen tapa toimittaa ilmaa potilaalle, käytä sitä.
21. Älä käytä tuotetta kasvomaskiin liitettyinä, kun ventiloit vauvaa, jolla on synnynnäinen palleatyrä, insufflaatioriskin vuoksi. Jos saatavilla on kasvomaskille vaihtoehtoinen tapa toimittaa ilmaa potilaalle, käytä sitä.
22. Toimenpidettä suorittavien ammattilaisten tulee arvioida elvytyspalkeen koon ja lisävarusteiden (esim. kasvomaski, PEEP-venttiili jne.) valintaa potilaskohtaisesti tämän vammojen mukaan, sillä vääränlainen käyttö voi vahingoittaa potilaasta.
23. Älä käytä Ambu SPUR II -elvytyspaljettä, jos tarvitaan vapaasti virtaavaa happea mahdollisesti puitteellisen hapen annostelun takia, joka voi johtaa hypokisiaan.
24. Painemittarin korkki on aina laitettava painemittariliitintään, kun painetta ei tarkkailla. Nämä vältetään vuoto, joka voi heikentää O₂:n toimittamista potilaalle.
25. Kiinnitä happiletku aina ennalta happilähteeeseen yli 0 °C:n lämpötilassa, sillä kiinnittäminen voi olla vaikeaa alle 0 °C:n lämpötilassa, mikä voi heikentää hapen toimittamista potilaalle.
26. Kun elvytyspaljetta käytetään kasvomaski kiinnitettyinä, varmista kasvomaskin oikea asento ja tiivisyys, sillä heikko tiivisyys voi levittää ilmassa levivää taudinauheuttajia käyttäjälle.

HUOMIOITAVAA

1. Älä koskaan säilytä elvytyspaljetta taitettuna muuten kuin valmistajan toimitettaessa taittamalla tavalla. Muuten palkeen muoto voi väärystyä pysyvästi, mikä voi heikentää ventiloinnin tehoa. Taittamalue näkyy palkeessa selvästi (vain aikuisen versio ja pediatrin veriso voidaan taittaa).

2. Seura aina rintakehän liikettä ja tarkista ventiloointi kuuntelemalla uloshengitysvirtausta potilasventtiilistä. Siirry heti suusta suuhun -ventiloointiin, jos ventiloointi ei onnistu elvytyspalkeella.
3. Älä liota, huuhtele äläkä steriloit laitetta, koska seurauksena voi olla haitallisia jäämiä tai laitteen toimintahäiriö. Tavanomaisia puhdistus- ja steriloointitapoja ei saa käyttää laitteen rakenteen ja materiaalien vuoksi.
4. Käytä M-Port-lääkkeenantoporttia vain joko EtCO₂-mittaukseen tai lääkkeen antoon, sillä se voi väärinä mittausarvoja.
5. Katso tarvittaessa lisätietoja lisävarusteen pakkauksesta, sillä vääränlainen käsitteily voi aiheuttaa toimintahäiriön koko tuotteessa.
6. Muiden valmistajien tuotteiden ja hapentoimituslaitteiden (esim. suodattimien ja tarveventtiilien) käyttö Ambu SPUR II -elvytyspalkeen kanssa voi vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn. Varmista muiden laitteiden valmistajalta yhteensopivuus Ambu SPUR II -elvytyspalkeen kanssa ja kysy tietoja mahdollisesta vaikutuksesta suorituskykyyn.
7. Hapenkeräyspussi on pysyvästi liitetty tuloventtiiliin aikuisen ja lapsen elvytyspalkeessa lukuun ottamatta tarveventtiilillä varustettuja versioita. Älä yritä purkaa sitä. Älä vedä hapenkeräyspussista, sillä se voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.

1.8. Mahdolliset haittavaikutukset

Esimerkkejä elvytykseen liittyvistä mahdollisista haittavaikutuksista: barotrauma, volutrauma, hypoksia, hyperkarbia ja aspiraatiokeuhkokume.

1.9. Yleisiä huomioita

Jos laitteen käytön aikana tapahtuu tai käytöstä aiheutuu vakava haitta, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle viranomaiselle.

2. Laitteen kuvaus

Ambu SPUR II -elvytyspalje voidaan yhdistää Ambu® kertakäyttöiseen painemittariin, Ambu® PEEP -venttiileihin ja Ambu®-kasvomaskeihin, kuten kuvillaan kohdassa 4.3 Elvytyspalkeen käytö.

3. Käytettyjen symbolien selitykset

Symbolien selitykset	Kuvaus
	Aikuinen Tarkoitettu kehonpaino yli 30 kg
	Lapsi Tarkoitettu kehonpaino 6 – 30 kg
	Vauva Tarkoitettu kehonpaino korkeintaan 10 kg
	MRI-yhteensopiva
	Valmistusmaa
	Lääkinnällinen laite
	Yhden potilaan käyttöön, monta käyttökertaa

Symbolien selitykset	Kuvaus
	Älä vedä hapenkeräyspussista voimakkaasti

Kaikkien symbolien selitykset ovat osoitteessa <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Tuotteen käyttö

4.1. Toimintaperiaate

Kuvassa 1 näytetään ventiloointikaasuseoksen virtaus pussiin sekä potilaaseen ja pois potilaasta elvytyspalkeen manuaalisen käytön aikana. 1a Aikuisen ja lapsen elvytyspalje, 1b vauvan elvytyspalje, jossa on suljettu hapenkeräyspussi, 1c vauvan elvytyspalje, jossa on avoin hapenkeräyspussi.

Kaasun virtaus on samanlainen, kun potilas hengittää spontaanisti laitteen läpi.

Hapenkeräyspussissa on kaksi venttiiliä, joista toinen päästää ympäristön ilmaa sisään, kun pussi on tyhjä, ja toinen päästää liikahappea ulos, kun hapenkeräyspussi on täynnä.

M-port-lääkkeenantopotti tarjoaa pääsyn sisäänhengityksen ja uloshengityksen kaasuvirtaukseen ja mahdollisuuden kytkeä ruiskun lääkkeen antamista varten 1d tai kaasunäytteen ottoletkun sivuvirtauksen EtCO₂ 1e-arvon mittaamista varten.

1.1 Liikahapan vapautus, 1.2 ilmaliitäntä, 1.3 happiliitäntä, 1.4 potilasliitin, 1.5 poistoventtiili, 1.6 painemittariliitäntä, 1.7 paineenrajoitusventtiili, 1.8 M-port.

HUOMAUTUS: kohtaan 1.5 voidaan liittää joko roiskesuoja tai PEEP-venttiili.

4.2. Tarkastus ja valmistelu

Elvytyspalje on purettava pakkauksesta ja valmisteltava käyttövalmiiksi (toimintatesti mukaan lukien), ennen kuin se asetetaan saataville hätätalteissa käyttöä varten.

4.2.1. Valmistelu

- Jos elvytyspalje on pakkausessa kokoon puristettuna, avaa se vetämällä potilasventtiilistä ja imuventtiilistä.
- Valmistele elvytyspalje ja laita kaikki elvytyspalkeen mukana tulleet osat kantolaukuun.
- Jos elvytyspalkeen mukana tuleva kasvomaski on suojauspussissa, pussi on poistettava ennen käyttöä.

Katso kohta 4.2.2. (Happiletku) laitteen valmistelusta ennen käyttöä alle 0 °C:n lämpötilassa.

4.2.2. Toimintatesti 2

Elvytyspalje

Sulje paineenrajoitusventtiili ohituspuristimella ja sulje potilasliitin peukalolla 2.1. Purista paljettia rivakasti. Elvytyspalje vastustaa puristusta.

Avaa paineenrajoitusventtiili liu'uttamalla ohituspuristin pois ja toista prosessi.

Paineenrajoitusventtiiliin tulisi nyt olla aktivoituna, ja venttiilissä virtaavan ilman pitäisi olla kuultavissa palkeen puristelun aikana.

Varmista, että ilma liikkuu venttiilijärjestelmän läpi ja ulos potilasliittimestä purstamalla ja vapauttamalla elvytyspalje muutaman kerran. 2.2

HUOMAUTUS: Koska venttiiliin levyt liikkuvat toimintatestin ja ventilaation aikana, niistä saattaa kuulua vaimea ääni. Tämä ei heikennä elvytyspalkeen toimintakykyä.

Happiletku

Happiletku tulee kiinnittää ja hapenkeräyspussin ja hapenkeräysletkun toimintatesti tulee suorittaa yli 0 °C:n lämpötilassa. Jos elvytyspaljetta käytetään alle 0 °C:n lämpötilassa, jätä happiletku kiinni happilähteeseen toimintatestin jälkeen.

Hapenkeräyspussi

Säädä kaasuvirtaukseksi 10 l/min happiliitännän kohdalle. Tue lopuksi pussin avautumista kädellä. Tarkista, että hapenkeräyspussi täyttyy. Jos ei täty, tarkista kahden venttiilin sulkioiden eheys ja ettei hapenkeräyspussissa ole repeämä.

Säädä tämän jälkeen kaasuvirtausta lääkinnällisen indikaation mukaiseksi.

Hapenkeräysletku

Säädä kaasuvirtaukseksi 10 l/min happiliitännän kohdalle. Tarkista, että happy virtaa ulos hapenkeräysletkun päästä. Jos niin ei käy, tarkista, ettei hapenkeräysletku ole tukossa. Säädä tämän jälkeen kaasuvirtausta lääkinnällisen indikaation mukaiseksi.

M-Port

Poista M-Port-lääkkeenantopordin suojuks ja tuki potilasliitin. Purista paljetta ja tarkkaile, kuuluuko M-port-lääkkeenantoprista ulos puristuvan ilman ääni. **2.3**

4.3. Elvytyspalkeen käyttö

- Käytä suositeltuja teknikoita potilaan suun ja ilmatien avaamiseen ja potilaan oikeaan asentoon laittamiseen, jotta ilmatie on auki.
- Pitele kasvomaskia tiiviisti potilaan kasvoja vasten. **3.1**
- Työnnä kätesi (aikuisen versio) tai nimetön ja keskisormi (lapsen versio) kahvan alle. Vauvan versiossa ei ole tukikahvaa. Ventiloointi ilman tukikahvaa tapahtuu käänämällä paljettia. **3.2** Potilaan ventiloointi: Takkale rinnan kohoamista insufflaation aikana. Vapauta paljettia pitelevä käsi nopeasti ja kuuntele uloshengityksen virtausta potilasventtiilistä. Takkale samalla rintakehän laskemista.
- Jos sisäänpuhallukselle on havaittavissa vastusta, tarkista, ettei hengitystiessä ole tukosta tai korjaa potilaan asentoa, ja varmista näin ilmatien avoimuus.
- Jos potilas oksentaa ventiloinnin aikana: tyhjennä potilaan ilmatie välittömästi, poista oksennus elvytyspalkeesta ravistamalla ja purista paljetta voimakkaasti ja nopeasti useita kertoja ennen ventilaation jatkamista. Pyyhi tuote tarvittaessa alkoholiin kostutetulla pyyhkeellä ja puhdista roiskesuoja vedellä.

Painemittariliitintä

Ambu kertakäytöinen painemittari tai muun valmistajan painemittari voidaan liittää painemittariliitintään, joka on potilasventtiiliin päällä. Irrota korkki ja liitä painemittari.

Paineenrajoitusjärjestelmä **4**

Paineenrajoitusventtiili on asetettu avautumaan paineessa 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Mikäli lääketieteen ammattilaisen arvio edellyttää yli 40 cm H₂O:n painetta, paineenrajoitusventtiili voidaan ohittaa siirtämällä ohituspuristin venttiiliin päälle. **4.2**

Paineenrajoitusventtiili voidaan ohittaa myös laittamalla sormi punaisen painikkeen päälle paljettaa puristaessa.

M-Port

Ambu SPUR II -elvytyspaljetta on saatavilla varustettuna M-port-lääkkeenantoportilla tai ilman. M-port-lääkkeenantoportti tarjoaa pääsyn sisään- ja ulosvirtaukseen, ja sitä voidaan käyttää lääkkeen annosteluun ruiskun avulla sekä sivuvirtauksen CO₂:n (EtCO₂) mittamiseen. Kun M-port ei ole käytössä, muista sulkea se punaisella M-portin korkilla.

EtCO₂:n mittaaminen

Sivuvirtauksen EtCO₂:n mittaaminen: liitä EtCO₂ -mittauslaitteen kaasunäytteen ottoletku Ambu SPUR II -elvytyspalkeen M-port-lääkkeenantoporttiin. Kiinnitä kaasunäytteen ottoletkuun liitin paikalleen asettamisen jälkeen käänämällä sitä 1/4 kierrosta myötäpäivään.

Lääkkeen antaminen

Potilaan vastetta annettuun lääkkeeseen on seurattava huolellisesti. Vähintään 1 ml nestettä annettuna M-Port-lääkkeenantopordin kautta on verrattavissa lääkkeen antamiseen suoraan intubaatioputkeen. M-Port-lääkkeenantoporttia on testattu adrenaliinilla, lidokaiinilla ja atropiinilla.

Ambu SPUR II -elvytyspalkeen tarveventtiiliversio 5

Ambu SPUR II -elvytyspalkeen tarveventtiiliversiota on saatavilla aikuisen ja lapsen koossa. Elvytyspaljettä voidaan käyttää tarveventtiiliin kanssa tai ilman, ja tuotteen mukana on kiinnitettävä hapenkeräyspussi.

Ambu SPUR II -elvytyspalkeen tuloventtiili yhdistetään tarveventtiiliin sovittimen avulla. Tarveventtiiliin kiinnittäminen:

- Irrota Ambu SPUR II -elvytyspalkeen tuloventtiilistä hapenkeräsyskikkö, jos se on kiinnitetty.
- Kiinnitä sovitin tarveventtiilijärjestelmään.
- Työnnä tarveventtiiliin sovitin Ambu SPUR II -elvytyspalkeen tuloventtiiliin.

HUOMAUTUS: Käytä sovitimen ja tarveventtiiliin kanssa ainostaan osaa "paineyksikkö". Osa "hapenkeräyspussi" on varajärjestelmä, mikäli tarveventtiiliin tulee häiriö.

Hapen annostelu

Annostelee happea lääkinnällisen tarpeen mukaan.

Kuvassa 6 näkyvät laskennalliset toimitetut happiprosenttiosuudet, jotka saavutetaan erilaisilla ventilaatiotilavuuksilla ja -nopeuksilla erilaisilla kaasunvirtausnopeuksilla.

Hapen prosenttiosuudet esitetään potilasluokille 6 aikuinen 6.1, lapsi 6.2, vauva 6.3.

Hapenkeräyspussi 7

Ohutta hapenkeräyspussin muovikalvoa ei saa koskaan irrottaa elvytyspalkeessa olevasta kiinnityskohdastaan.

Lisävarusteet 8

Ambu SPUR II -elvytyspalkeen liittimet noudattavat ISO 5356-1- ja EN 13544-2 -standardeja, joten ne ovat yhteensopivia muiden sairaalan laitteistojen kanssa. Kun käytetään ulkoisia laitteita, suorita toimintatesti ja katso ulkoisen laitteen mukana tulevat käyttöohjeet.

Ambu SPUR II -elvytyspalkeen kanssa yhteensopivat Ambu-tuotteet on mainittu alla:

Ambu® kertakäyttöinen kasvomaski

Katso lisätietoja Ambu kertakäyttöisen kasvomaskin käyttöohjeista.

Ambu® PEEP 20 -kertakäyttöventtiili 8.1 8.2

Katso lisätietoja Ambu PEEP 20 -kertakäyttöventtiiliin käyttöohjeista tai katso näiden käyttöohjeiden kuva 8.1. Irrota roiskesuoja, jotta voit sovittaa Ambu PEEP 20 -kertakäyttöventtiiliin (tarvittaessa) elvytyspalkeeseen. 8.2

Ambu® kertakäyttöinen painemanometri 8.3

Katso lisätietoja kertakäyttöisen Ambu-painemittarin käyttöohjeista.

4.4. Käytön jälkeen

Käytetyt tuotteet on hävitetävä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

5. Tekniset tiedot

5.1. Soveltuvat standardit

Ambu SPUR II -elvytyspalje täyttää tuotekohtaisen standardin EN ISO 10651-4 vaatimukset.

5.2. Spesifikaatiot

	Vauva	Lapsi	Aikuinen
Elvytyspalkeen tilavuus	noin 220 ml	noin 670 ml	noin 1510 ml
Toimitettu tilavuus yhdellä kädellä*	150 ml	450 ml	600 ml
Toimitettu tilavuus kahdella kädellä*	-	-	1000 ml
Mitat (pituus x halkaisija) ilman hapenkeräyspussia ja lisävarustetta:	noin 190 x 71 mm	noin 223 x 99 mm	noin 284 x 127 mm

	Vauva	Lapsi	Aikuinen		
Paino ilman haperkeräyspussia ja lisävarustetta	noin 70 g	noin 145 g	noin 220 g		
Paineenrajoitusventtiili**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)		
Tyhjä tila	≤ 5 ml + 10 % toimitetusta tilavuudesta	≤ 5 ml + 10 % toimitetusta tilavuudesta	≤ 5 ml + 10 % toimitetusta tilavuudesta		
Sisähengitysvastus***	korkeintaan 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) nopeudella 5 l/min	korkeintaan 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) nopeudella 50 l/min	korkeintaan 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) nopeudella 50 l/min		
Ulos'hengitysvastus***	korkeintaan 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) nopeudella 5 l/min	korkeintaan 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) nopeudella 50 l/min	korkeintaan 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) nopeudella 50 l/min		
Haperkeräyspussin tilavuus	noin 300 ml (pussi) noin 100 ml (letku)	noin 2600 ml (pussi)	noin 2600 ml (pussi)		
Potilasliitin	Ulkomitta 22 mm, uros (ISO 5356-1) Sisämitta 15 mm, naaras (ISO 5356-1)				
Ulos'hengitysliitin (PEEP-venttiilin kiinnitystä varten)	30 mm, uros (ISO 5356-1)				
Painemittariliitin	Ø 4,2 +/- 0,1 mm				
Tarveventtiilin liitin	-	Sisämitta 32 mm, naaras (ISO 10651-4)			
Etu- ja takavuoto	Ei mitattavissa				
M-Port	Liitin EN ISO 80369-7 -standardin mukainen				
O ₂ -tuloliitin	Standardin EN 13544-2 mukaan				

	Vauva	Lapsi	Aikuinen
Käyttölämpötilarajat	-18 °C ... +50 °C (-0,4 °F ... +122 °F), testattu standardin EN ISO 10651-4 mukaisesti		
Säilytyslämpötilarajat	-40 °C ... +60 °C (-40 °F ... +140 °F), testattu standardin EN ISO 10651-4 mukaisesti		
Pitkääikaiseen säilytykseen suositellaan säilytystä suljetussa pakkaussessa huoneenlämmössä auringonvalolta suojaattuna.			

* Testattu standardin EN ISO 10651-4 mukaisesti.

** Suurempi syöttöpaine saadaan ohittamalla paineenrajoitusventtiili.

*** Standardin EN ISO 10651-4 yleisten testiolosoitteiden mukaan.

5.3. MRI-turvallisuustiedot

Ambu SPUR II -elvytyspalje¹, ja Ambu SPUR II -elvytyspalje, johon on liitetty Ambu PEEP 20 -kertakäytöventtiili², ja Ambu SPUR II -elvytyspalje, johon on liitetty Ambu PEEP 20 -kertakäytöventtiili ja Ambu kertakäytöinen painemittari³ ovat MRI-ehdollaisia, joten niitä voidaan turvallisesti käyttää MRI-ympäristössä (ei MRI-laitteen sisäpuolella) seuraavin ehdoin: Staattinen magneettikenttä korkeintaan 7 Teslaa, ja

- Suurin tilan gradienttikenttä
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Voimantuotto enintään
 - 450 000 000 G₂/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G₂/cm (721 T²/m)²

Käytöllä MRI-laitteen sisäpuolella voi vaikuttaa MRI-kuvan laatuun.

RF-säteilystä aiheutuvaa lämpenemistä ja MRI-kuvan artefakteja ei ole testattu. Kaikki metalliosat on täysin koteloitu, eivätkä ne ole kontaktissa ihmiskehoon.

1. Informations importantes – À lire avant utilisation

Lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser l'insufflateur Ambu SPUR® II. Ce mode d'emploi peut être mis à jour sans notification préalable. Des exemplaires de la version en vigueur sont disponibles sur demande. Il convient de noter que le présent mode d'emploi n'explique pas et ne décrit pas les procédures cliniques. Il présente uniquement le fonctionnement de base et les consignes liées au fonctionnement de l'insufflateur. Avant d'utiliser l'insufflateur pour la première fois, il est indispensable que les utilisateurs aient été suffisamment formés aux techniques d'insufflation et se soient familiarisés avec l'usage prévu de l'insufflateur, ainsi qu'avec les avertissements, les précautions et les indications figurant dans le présent mode d'emploi. L'insufflateur Ambu SPUR II n'est couvert par aucune garantie.

1.1. Usage prévu

L'insufflateur Ambu SPUR II est un insufflateur à usage patient unique conçu pour la réanimation cardio-pulmonaire.

1.2. Indications d'utilisation

L'insufflateur Ambu SPUR II est destiné à être utilisé dans les situations où un insufflateur cardio-pulmonaire manuel est nécessaire pour la ventilation assistée.

L'insufflateur Ambu SPUR II est indiqué pour la ventilation et l'oxygénation des patients jusqu'à ce qu'une voie aérienne plus définitive puisse être établie ou que le patient soit rétabli.

1.3. Population de patients cible

Pour chaque version, la gamme de taille est la suivante :

- **Adulte** : adultes et enfants dont le poids corporel est supérieur à 30 kg (66 lb).
- **Enfant** : nourrissons et enfants dont le poids corporel est compris entre 6 kg et 30 kg (13 – 66 lb).
- **Nourrisson** : nouveau-nés et nourrissons dont le poids corporel est inférieur à 10 kg (22 lb).

Noter que toutes les configurations d'insufflateur Ambu SPUR II ne sont pas disponibles pour les trois types de patients.

1.4. Utilisateur prévu

Professionnels médicaux formés à la gestion des voies aériennes tels que les anesthésistes, les infirmiers, le personnel de secours et le personnel d'urgence.

1.5. Contre-indications

Aucune connue.

1.6. Avantages cliniques

La technique de base de gestion des voies aériennes à l'aide d'un insufflateur manuel permet la ventilation et l'oxygénation des patients jusqu'à ce qu'une voie aérienne plus définitive puisse être établie ou que le patient soit rétabli.

1.7. Avertissements et précautions

Le non-respect de ces précautions peut entraîner une ventilation et une oxygénation insuffisantes du patient ou endommager l'équipement.

AVERTISSEMENTS

1. Ne pas utiliser l'insufflateur pendant plus de 4 heures accumulées sur une période maximale d'une semaine afin d'éviter tout risque d'infection.
2. Ne pas réutiliser l'insufflateur s'il reste de l'humidité ou des résidus visibles à l'intérieur du dispositif afin d'éviter le risque d'infection et de dysfonctionnement.
3. S'assurer que le pare-éclaboussure ou la valve Ambu PEEP est fixé(e) au port expiratoire. Un port expiratoire ouvert peut être accidentellement obstrué et entraîner un volume d'air excessif dans les poumons, ce qui peut entraîner un traumatisme tissulaire.

- 4. Éviter d'utiliser l'insufflateur dans des environnements toxiques ou dangereux afin d'éviter tout risque de lésion des tissus.
- 5. Toujours s'assurer que le tuyau du réservoir d'oxygène n'est pas obstrué, car le blocage du tuyau peut empêcher le ballon de compression de se gonfler, ce qui peut empêcher la ventilation.
- 6. Ne pas utiliser le produit s'il est contaminé par des sources externes, car cela peut provoquer une infection.
- 7. Toujours inspecter visuellement le produit et effectuer un test de fonctionnement après le déballage et l'assemblage et avant utilisation, car les défauts et les corps étrangers peuvent entraîner une absence de ventilation ou une ventilation réduite du patient.
- 8. Ne pas utiliser le produit si le test de fonctionnement échoue car cela peut entraîner une absence de ventilation ou une ventilation réduite.
- 9. Ne jamais bypasser la valve de surpression hormis dans le cas où une évaluation sur le plan médical en indiquerait la nécessité. Des pressions de ventilation élevées peuvent provoquer un barotraumatisme.
- 10. Dispositif à usage unique. Toute utilisation sur un autre patient risque de provoquer une contamination croisée.
- 11. Les médicaments ne peuvent pas être administrés par le MédiPort si des accessoires (p. ex. filtre, détecteur de CO₂) sont connectés entre l'insufflateur et le masque facial.
- 12. Ne pas laisser le MédiPort ouvert après utilisation afin d'éviter toute fuite qui pourrait réduire l'administration d'O₂ au patient.
- 13. Le MédiPort ne doit pas être utilisé pour la surveillance du flux latéral d'EtCO₂ chez les patients ventilés avec moins de 400 ml de volume courant afin d'éviter des mesures d'EtCO₂ incorrectes.
- 14. Lors de l'administration de médicaments d'un volume inférieur à 1 ml, il est nécessaire de rincer le MédiPort pour garantir l'administration précise du médicament.
- 15. Ne pas raccorder la tubulure d'alimentation en oxygène au MédiPort, car la concentration d'O₂ prévue ne sera pas administrée au patient.
- 16. L'ajout d'accessoires peut provoquer une augmentation de la résistance inspiratoire et/ou expiratoire. Ne pas fixer d'accessoires si une augmentation de la résistance respiratoire peut nuire au patient.
- 17. Ne doit être utilisé que par des utilisateurs familiarisés avec le contenu de ce manuel, car une utilisation incorrecte peut nuire au patient.
- 18. Lors de l'utilisation d'oxygène supplémentaire, ne pas fumer ni utiliser l'appareil à proximité d'une flamme nue, d'huile, de graisse, d'autres produits chimiques inflammables ou d'équipements et d'outils qui provoquent des étincelles, en raison du risque d'incendie et/ou d'explosion.
- 19. Ne pas essayer de fixer une valve à la demande à la version nourrisson, car cela pourrait entraîner des concentrations élevées d'oxygène et être nocif pour les nouveau-nés.
- 20. Préter attention aux signes d'obstruction totale/partielle des voies aériennes supérieures lors de l'utilisation de l'insufflateur fixé à un masque facial, car cela entraînera un apport d'oxygène insuffisant ou nul. Toujours choisir une alternative à l'utilisation d'un masque facial pour diriger l'air vers le patient, si disponible.
- 21. Ne pas utiliser le produit avec le masque facial fixé lors de la ventilation de nourrissons présentant une hernie congénitale du diaphragme en raison du risque lié à l'insufflation. Choisir une alternative à l'utilisation d'un masque facial pour diriger l'air vers le patient, si disponible.
- 22. Les professionnels effectuant la procédure doivent évaluer le choix de la taille et des accessoires de l'insufflateur (p. ex. masque facial, valve PEEP, etc.) en fonction de la ou des conditions spécifiques du patient, car une utilisation incorrecte peut nuire au patient.
- 23. Ne pas utiliser l'insufflateur Ambu SPUR II lorsqu'un débit d'oxygène continu est nécessaire en raison d'une éventuelle administration d'oxygène insuffisante, ce qui peut entraîner une hypoxie.
- 24. Le bouchon du manomètre doit toujours être placé sur le port du manomètre lorsque la pression n'est pas surveillée pour éviter les fuites, ce qui peut entraîner une réduction de l'administration d'O₂ au patient.

25. Toujours pré-attacher le tuyau d'oxygène à l'alimentation en oxygène à des températures supérieures à 0 °C, car le montage peut devenir difficile à des températures inférieures à 0 °C, ce qui réduit l'apport d'oxygène au patient.
26. Lors de l'utilisation de l'insufflateur avec le masque facial fixé, s'assurer que le masque facial est correctement positionné et étanche, car une mauvaise étanchéité peut entraîner la propagation d'une maladie infectieuse aéroportée à l'utilisateur.

MISES EN GARDE

1. S'assurer que l'insufflateur n'est jamais rangé sous une forme autre que replié comme lors de sa livraison par le fabricant. À défaut, le ballon pourrait être déformé de manière permanente, ce qui risque de réduire l'efficacité de la ventilation. La zone de pliage est clairement indiquée sur le ballon (seules les versions Adulte et Enfant peuvent être pliées).
2. Toujours surveiller les mouvements de la poitrine et écouter le débit respiratoire provenant de la valve patient afin de s'assurer de l'efficacité de la ventilation. Passer immédiatement en ventilation au bouche-à-bouche si la ventilation avec l'insufflateur ne peut pas être obtenue.
3. Ne jamais nettoyer par trempage ni stériliser ce dispositif, ces procédures étant susceptibles de laisser des résidus nocifs ou de provoquer un dysfonctionnement du dispositif. La conception et le matériau utilisés ne sont pas compatibles avec les procédures de nettoyage et de stérilisation conventionnelles.
4. Utiliser le MédiPort uniquement pour l'une de ces deux procédures : la mesure de l'EtCO₂ ou l'administration de médicament, car cela peut modifier les valeurs mesurées.
5. Le cas échéant, se reporter à l'emballage des accessoires pour obtenir des informations plus spécifiques sur chaque accessoire, car une mauvaise manipulation peut entraîner un dysfonctionnement de l'ensemble du produit.

6. L'utilisation de produits tiers et d'appareils d'apport en oxygène (p. ex. filtres et valves à la demande) avec l'insufflateur Ambu SPUR II peut influer sur les performances du produit. Consulter le fabricant du dispositif tiers pour vérifier la compatibilité avec l'insufflateur Ambu SPUR II et obtenir des informations sur les différences de performances possibles.
7. Le ballon réservoir d'oxygène est fixé en permanence à la valve d'admission sur les insufflateurs adultes et enfants, sauf sur les versions à valve à la demande. Ne pas tenter de désassembler. Ne pas tirer sur le ballon réservoir d'oxygène, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du dispositif.

1.8. Effets secondaires potentiels

Effets secondaires potentiels liés à la réanimation (liste non exhaustive) : barotraumatisme, volutraumatisme, hypoxie, hypercarbie et pneumonie par aspiration.

1.9. Remarques générales

Si, pendant ou après l'utilisation de ce dispositif, un grave incident a lieu, le rapporter au fabricant et à l'autorité nationale.

2. Description du dispositif

L'insufflateur Ambu SPUR II peut être connecté au manomètre de pression jetable Ambu®, aux valves PEP Ambu® et aux masques faciaux Ambu®, comme décrit à la section 4.3. Utilisation de l'insufflateur.

3. Explication des symboles utilisés

Symbol/indication	Description
	Adulte Masse corporelle idéale prévue supérieure à 30 kg
	Enfant Masse corporelle idéale prévue de 6 à 30 kg
	Nourrisson Masse corporelle idéale prévue jusqu'à 10 kg
	Compatibilité conditionnelle à la résonance magnétique
	Pays du fabricant
	Dispositif médical
	Usage multiple pour un seul patient

Symbol/indication	Description
	Ne pas tirer le ballon réservoir d'oxygène en forçant

Une liste complète des explications des symboles est disponible à l'adresse
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Utilisation du produit

4.1. Principe de fonctionnement

L'illustration 1 montre les mélanges de gaz de ventilation dans le ballon entrer et sortir du patient pendant le fonctionnement manuel de l'insufflateur. 1a Insufflateur adulte et enfant, 1b insufflateur nourrisson avec ballon réservoir d'oxygène fermé (réservoir à ballon), 1c insufflateur nourrisson avec tuyau réservoir d'oxygène ouvert (réservoir à tube).

Le débit de gaz est similaire lorsque le patient respire spontanément avec le dispositif.

Le réservoir d'oxygène est muni de deux valves. L'une permet d'alimenter le réservoir en air ambiant lorsqu'il est vide et l'autre permet d'évacuer l'excédent d'oxygène lorsque le ballon réservoir d'oxygène est plein.

Le MédiPort permet d'accéder au débit des gaz respiratoire et inspiratoire et de raccorder une seringue pour l'administration des médicaments 1d ou pour raccorder une ligne de prélèvement de gaz afin de mesurer le flux latéral d' EtCO_2 1e.

1.1 Libération de l'excédent d'oxygène, 1.2 Entrée d'air, 1.3 Entrée d'oxygène, 1.4 Raccord patient, 1.5 Expiration, 1.6 Port du manomètre, 1.7 Valve de limitation de pression, 1.8 MédiPort.

REMARQUE : la fixation à 1.5 peut être un pare-éclaboussure ou une valve PEEP.

4.2. Inspection et préparation

L'insufflateur doit être déballé et préparé (un test de fonctionnement doit être réalisé) pour une utilisation immédiate avant sa mise en place pour une utilisation en cas d'urgence.

4.2.1. Préparation

- Si l'insufflateur est emballé à l'état comprimé, le déplier en tirant sur la valve patient et la valve d'admission.
- Préparer l'insufflateur et placer tous les éléments dans le sac de transport fourni avec l'insufflateur.
- Si le masque facial fourni avec l'insufflateur est emballé dans un sachet de protection, enlever ce sachet avant l'utilisation.

Voir section 4.2.2. (Tuyau d'oxygène) pour la préparation du dispositif avant utilisation à une température inférieure à 0 °C.

4.2.2. Test de fonctionnement ②

Insufflateur

Fermer la valve de surpression avec le clip de dérivation et fermer le raccord patient avec le pouce ②.1. Comprimer légèrement le ballon compressible. L'insufflateur doit résister à la compression.

Ouvrir la valve de surpression en faisant glisser le clip de dérivation et répéter la procédure. La valve de surpression doit maintenant être activée et il doit être possible d'entendre le débit de la valve pendant la compression rapide du ballon compressible.

Comprimer et relâcher l'insufflateur à plusieurs reprises pour s'assurer que l'air circule à travers le système de valve et s'échappe de la valve patient. ②.2

REMARQUE : les disques des valves se déplaçant durant le test de fonctionnement ou la ventilation, un léger son peut être émis. Cela n'a aucune répercussion sur le fonctionnement de l'insufflateur.

Tuyau d'oxygène

Le montage du tuyau d'oxygène et le test de fonctionnement du ballon du réservoir d'oxygène et du tuyau du réservoir d'oxygène doivent être effectués à des températures supérieures à 0 °C. Pour l'utilisation de l'insufflateur à des températures inférieures à 0 °C, laisser le tuyau d'oxygène raccordé à l'alimentation en oxygène après le test de fonctionnement.

Ballon réservoir d'oxygène

Fournir un débit de gaz de 10 l/min au raccord d'entrée d'oxygène. Enfin, déplier le ballon manuellement. Vérifier que le ballon du réservoir d'oxygène se remplit. Si ce n'est pas le cas, vérifier que les deux clapets de valve sont intacts ou que le réservoir d'oxygène n'est pas déchiré.

Régler ensuite le débit de gaz fourni selon les indications médicales.

Tuyau du réservoir d'oxygène

Fournir un débit de gaz de 10 l/min au raccord d'entrée d'oxygène. Vérifier que l'oxygène s'échappe de l'extrémité du tuyau du réservoir d'oxygène. Dans le cas contraire, s'assurer que le tuyau d'oxygène n'est pas bloqué. Régler ensuite le débit de gaz fourni selon les indications médicales.

MédiPort

Retirer le capuchon du MédiPort et bloquer le raccord patient. Comprimer le ballon et écouter le son de l'air s'échappant à travers le MédiPort. ②.3

4.3. Utilisation de l'insufflateur

- Appliquer les techniques recommandées positionner le patient correctement de manière à dégager la bouche et les voies aériennes.
- Maintenir fermement le masque facial contre le visage du patient. ③.1

- Glisser la main (version Adulte) ou l'annulaire et le majeur (version Enfant) sous la poignée. La version nourrisson ne possède pas de poignée de support. La ventilation sans poignée de support peut être obtenue en tournant le ballon. **3.2** Ventilation du patient : Pendant l'insufflation, observer la poitrine se soulever. Relâcher brusquement la main maintenant le ballon et écouter le débit expiratoire sortant de la valve patient et contrôler visuellement l'abaissement de la poitrine.
- En cas de résistance continue à l'insufflation, vérifier que les voies aériennes ne sont pas obstruées et repositionner le patient pour s'assurer que les voies aériennes sont ouvertes.
- Si le patient vomit pendant la ventilation, dégager immédiatement les voies aériennes du patient et expulser le vomi de l'insufflateur en le secouant et en le comprimant énergiquement et rapidement plusieurs fois avant de reprendre la ventilation. Si nécessaire, essuyer le produit avec un chiffon imbibé d'alcool et nettoyer le pare-éclaboussure à l'eau.

Port du manomètre

Le manomètre de pression jetable Ambu ainsi qu'un manomètre tiers peuvent être raccordés au port du manomètre, situé au-dessus de la valve patient. Retirer le capuchon et fixer le manomètre.

Système de limitation de la pression **4**

La valve de surpression est réglée pour s'ouvrir à 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Si une évaluation médicale et professionnelle indique qu'une pression supérieure à 40 cm H₂O est nécessaire, il est possible de bypasser la valve de surpression en plaçant le capuchon de dérivation sur la valve. **4.2**

Pour bypasser la valve de surpression, l'autre technique consiste à placer un doigt sur le bouton rouge et à comprimer le ballon.

MédiPort

L'insufflateur Ambu SPUR II est fourni avec ou sans MédiPort. Le MédiPort permet d'accéder au débit de gaz inspiratoire et expiratoire et peut être utilisé pour l'administration de médicaments, lorsqu'il est connecté à une seringue, ainsi que pour mesurer le CO₂ du flux latéral (EtCO₂). Lorsqu'il n'est pas utilisé, ne pas oublier de fermer le MédiPort avec son capuchon rouge.

Mesure de l'EtCO₂

Pour mesurer le flux latéral d'EtCO₂, raccorder la ligne d'échantillonnage de gaz du dispositif de mesure de l'EtCO₂ au MédiPort de l'insufflateur Ambu SPUR II. Connecter le raccord de la ligne de prélèvement des gaz en le montant et en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Administration de médicaments

Observer attentivement la réaction du patient à l'administration du médicament. L'administration de volumes de 1 ml de liquide ou plus par le biais du MédiPort est comparable à l'administration directe dans la sonde endotrachéale. Le MédiPort a été testé à l'épinéphrine, la lidocaïne et l'atropine.

Version de la valve à la demande de l'insufflateur Ambu SPUR II **5**

La valve à la demande de l'insufflateur Ambu SPUR II est disponible en tailles adulte et enfant et peut être utilisée avec ou sans valve à la demande. Elle est fournie avec un ballon réservoir d'oxygène raccordable.

La valve d'admission de l'insufflateur Ambu SPUR II se raccorde à la valve à la demande via un adaptateur.

Fixation de la valve à la demande :

- Retirer le réservoir d'oxygène de la valve d'admission de l'insufflateur Ambu SPUR II, le cas échéant.
- Fixer l'adaptateur au système de valve à la demande.

- Insérer l'adaptateur de valve à la demande dans la valve d'admission de l'insufflateur Ambu SPUR II.

REMARQUE : utiliser uniquement la pièce étiquetée « unité de compression » avec l'adaptateur et la valve à la demande. La pièce étiquetée « Ballon réservoir d'oxygène » est considérée comme un élément de secours en cas de défaillance de la valve à la demande.

Administration d'oxygène

Administrer l'oxygène selon l'indication médicale.

L'illustration **6** montre les pourcentages d'oxygène délivré calculés qui peuvent être obtenus avec différents volumes et fréquences de ventilation à différents débits de gaz. Les pourcentages d'oxygène sont visibles sur les versions **6** Adulte **6.1**, Enfant **6.2** et Nourrisson **6.3**.

Ballon réservoir d'oxygène **7**

Le film plastique fin du ballon réservoir d'oxygène ne doit en aucun cas être détaché de son point de fixation à l'insufflateur.

Accessoires **8**

Les connecteurs de l'insufflateur Ambu SPUR II respectent les normes ISO 5356-1 et EN 13544-2, ce qui le rend conforme aux autres équipements hospitaliers. Lors de l'utilisation de dispositifs externes, tester leur fonctionnement et consulter le mode d'emploi joint à ces dispositifs.

Les produits Ambu compatibles avec l'insufflateur Ambu SPUR II sont indiqués ci-dessous :

Masque facial à usage unique Ambu®

Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du masque facial à usage unique Ambu.

Valve Ambu® PEEP 20 à usage unique **8.1 **8.2****

Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi de la valve Ambu PEEP 20 à usage unique ou à l'illustration **8.1** de ce mode d'emploi. Pour installer la valve Ambu PEEP 20 à usage unique (si nécessaire) sur l'insufflateur, retirer le pare-éclaboussure. **8.2**

Manomètre de pression jetable Ambu® **8.3**

Pour plus d'informations, se reporter au mode d'emploi du manomètre de pression jetable Ambu.

4.4. Après utilisation

Les produits usagés doivent être mis au rebut conformément aux procédures locales.

5. Caractéristiques techniques

5.1. Normes appliquées

L'insufflateur Ambu SPUR II est conforme à la norme EN ISO 10651-4 relative à ces produits.

5.2. Caractéristiques

	Nourrisson	Enfant	Adulte
Volume d'insufflation	environ 220 ml	environ 670 ml	environ 1 510 ml
Volume administré à une main*	150 ml	450 ml	600 ml
Volume administré à deux mains*	-	-	1 000 ml
Dimensions (longueur x diamètre), sans réservoir ni accessoire	environ 190 x 71 mm	environ 223 x 99 mm	environ 284 x 127 mm
Poids, sans réservoir ni accessoire	environ 70 g	environ 145 g	environ 220 g
Valve de surpression**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)

	Nourrisson	Enfant	Adulte		
Volume mort	$\leq 5 \text{ ml} + 10\% \text{ du volume administré}$	$\leq 5 \text{ ml} + 10\% \text{ du volume administré}$	$\leq 5 \text{ ml} + 10\% \text{ du volume administré}$		
Résistance inspiratoire***	0,1 kPa max. (1,0 cm H ₂ O) à 5 l/min	0,5 kPa max. (5,0 cm H ₂ O) à 50 l/min	0,5 kPa max. (5,0 cm H ₂ O) à 50 l/min		
Résistance expiratoire***	0,2 kPa max. (2,0 cm H ₂ O) à 5 l/min	0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) à 50 l/min	0,27 kPa max. (2,7 cm H ₂ O) à 50 l/min		
Volume du réservoir	environ 300 ml (ballon) environ 100 ml (tuyau)	environ 2 600 ml (ballon)	environ 2 600 ml (ballon)		
Raccord patient	Externe 22 mm, mâle (ISO 5356-1) Interne 15 mm, femelle (ISO 5356-1)				
Raccord d'expiration (pour la fixation de la valve PEEP)	30 mm mâle (ISO 5356-1)				
Raccord du port du manomètre	Ø 4,2 +/- 0,1 mm				
Raccord de valve à la demande	-	Interne 32 mm, femelle (EN ISO 10651-4)			
Fuite avant et arrière	Non mesurable				
MédiPort	Connecteur compatible avec la norme EN ISO 80369-7				
Raccord d'admission d'O ₂	Conformément à la directive EN 13544-2				
Limites de température d'utilisation	-18 °C à +50 °C (-0,4 °F à +122 °F) conformément à la norme EN ISO 10651-4				
Limites de température de stockage	-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) conformément à la norme EN ISO 10651-4				
Stockage recommandé à long terme dans un emballage fermé à température ambiante, à l'abri de la lumière du soleil.					

* Testé conformément à la norme EN ISO 10651-4.

** Une pression plus élevée peut être obtenue en bypassant la valve de surpression.

*** Dans des conditions de test générales selon la norme EN ISO 10651-4.

5.3. Informations de sécurité relatives à l'IRM



L'insufflateur Ambu SPUR II¹ et l'insufflateur Ambu SPUR II avec valve Ambu PEEP 20 à usage unique² fixée et l'insufflateur Ambu SPUR II avec valve Ambu PEEP 20 à usage unique fixée et manomètre de pression Ambu jetable² sont compatibles avec l'IRM sous certaines conditions et peuvent donc être utilisés en toute sécurité dans un environnement d'IRM (pas à l'intérieur du tunnel d'IRM) dans les conditions suivantes.

Champ magnétique statique de 7 teslas ou moins, avec

- Gradient de champ spatial maximal de
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Force maximale du produit de
 - 450 000 000 G₂/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G₂/cm (721 T²/m)²

L'utilisation à l'intérieur du tunnel d'IRM peut influer sur la qualité de l'image IRM.

L'échauffement induit par RF et les artefacts d'image IRM n'ont pas été testés. Toutes les pièces métalliques sont entièrement encapsulées et n'ont aucun contact avec le corps humain.

1. Važne informacije – Pročitati prije upotrebe

Prije upotrebe maske za reanimaciju Ambu® SPUR® II pažljivo pročitajte ove sigurnosne upute. Upute za upotrebu mogu se ažurirati bez prethodne obavijesti. Primjeri trenutačne verzije dostupni su na zahtjev. Imajte na umu da se u ovim uputama ne objašnjavaju niti razlažu klinički postupci. U njima se opisuju samo osnovni postupci i mjere opreza vezane uz rad maske za reanimaciju. Bitno je da prije prve upotrebe maske za reanimaciju rukovatelji dobiju dostatnu obuku u tehnikama reanimacije te da budu upoznati s namjenom, upozorenjima, mjerama opreza i indikacijama navedenima u ovim uputama. Za masku za reanimaciju Ambu SPUR II ne izdaje se jamstvo.

1.1. Namjena

Ambu SPUR II maska je za plućnu reanimaciju namijenjena jednokratnoj upotrebi na pacijentu.

1.2. Indikacije za upotrebu

Maska za reanimaciju Ambu SPUR II namijenjena je za upotrebu u slučajevima kada je za potpomognutu ventilaciju potrebna ručna maska za kardiopulmonalnu reanimaciju.

Maska za reanimaciju Ambu SPUR II indicirana je za ventilaciju i oksigenaciju pacijenata dok se ne uspostavi prohodniji dišni put ili dok se pacijent ne oporavi.

1.3. Predviđena populacija pacijenata

Raspon veličina za svaku verziju je sljedeći:

- Za odrasle:** odrasli i djeca tjelesne težine veće od 30 kg (66 lb).
- Za pedijatrijsku primjenu:** dojenčad i djeca tjelesne težine od 6 kg do 30 kg (13 – 66 lb).
- Za dojenčad:** novorođenčad i dojenčad tjelesne težine do 10 kg (22 lb).

Imajte na umu da nisu sve konfiguracije maske za reanimaciju Ambu SPUR II dostupne za sve tri kategorije pacijenata.

1.4. Korisnici kojima je namijenjena

Zdravstveni djelatnici koji su obučeni za zbrinjavanje dišnog puta, kao što su anesteziolozi, medicinske sestre, osoblje spasilačkih i hitnih službi.

1.5. Kontraindikacije

Nisu poznate.

1.6. Kliničke prednosti

Osnovna tehnika zbrinjavanja dišnog puta s pomoću ručne maske za reanimaciju omogućuje ventilaciju i oksigenaciju pacijenata sve dok se ne uspostavi prohodniji dišni put ili dok se pacijent ne oporavi.

1.7. Upozorenja i mjere opreza

Nepridržavanje ovih mjeri opreza može uzrokovati neučinkovitu ventilaciju i oksigenaciju pacijenta ili oštećenje opreme.

UPOZORENJA

1. Nemojte upotrebljavati masku za reanimaciju duže od ukupno 4 sata tijekom razdoblja od najviše tjedan dana da biste izbjegli opasnost od infekcije.
2. Nemojte ponovno upotrebljavati masku za reanimaciju ako je u uređaju ostalo vidljive vlage ili ostataka da biste izbjegli opasnost od infekcije i kvara.
3. Provjerite je li zaštićena od prskanja ili Ambu PEEP ventil priključen na ekspiracijski priključak. Otvoreni ekspiracijski priključak može se slučajno začepiti, što može uzrokovati prekomjernu količinu zraka u plućima, što može dovesti do ozljede tkiva.
4. Izbjegavajte upotrebu maske za reanimaciju u toksičnim ili opasnim okruženjima da biste izbjegli opasnost od oštećenja tkiva.

5. Uvijek provjerite je li cijev spremnika kisika začepljena jer začepljene u cijevi može onemogućiti ponovno napuhivanje balona, što može dovesti do prekida ventilacije.
6. Nemojte upotrebljavati proizvod ako je kontaminiran vanjskim izvorima jer to može uzrokovati infekciju.
7. Nakon raspakiravanja, sastavljanja i prije upotrebe uvijek vizualno pregledajte proizvod i provedite ispitivanje funkcionalnosti jer nepravilnosti i strane tvari mogu dovesti do prekida ili smanjene ventilacije pacijenta.
8. Nemojte upotrebljavati proizvod u slučaju neuspješnog ispitivanja funkcionalnosti jer to može dovesti do prekida ili smanjene ventilacije.
9. Nikada nemojte premoščivati ventil za ograničenje tlaka, osim ako je medicinskom procjenom utvrđeno da je to potrebno. Visoki ventilacijski tlak može uzrokovati barotraumu.
10. Samo za jednokratnu upotrebu. Upotreba na više pacijenata može uzrokovati prenošenje infekcije.
11. Lijekovi se ne mogu primijeniti kroz priključak M ako je između maske za reanimaciju i maske za lice priključena dodatna oprema (npr. filter, detektor za CO₂).
12. Nemojte ostavljati priključak M otvorenim nakon upotrebe kako biste izbjegli curenje koje može dovesti do smanjene isporuke O₂ pacijentu.
13. Priključak M ne smije se upotrebljavati za nadzor sekundarnog toka EtCO₂ kod pacijenata koji se ventiliraju s tidalnim volumenom manjim od 400 ml da bi se izbjeglo netočno mjerjenje EtCO₂.
14. Prilikom davanja lijeka volumena manjeg od 1 ml potrebno je isprati priključak M da bi se osigurala točna doza lijeka.
15. Nemojte pričvršćivati cijevi za dovod kisika na priključak M jer pacijent neće dobiti predviđenu koncentraciju O₂.
16. Priključivanje dodatne opreme može povećati inspiracijski i/ili ekspiracijski otpor. Ne priključujte dodatnu opremu ako bi povećani otpor disanja bio štetan za pacijenta.
17. Uređaj smiju upotrebljavati samo korisnici kojima je namijenjen i koji su upoznati sa sadržajem ovog priručnika jer nepravilnom upotrebot može doći do ozljede pacijenta.
18. Kad upotrebljavate dodatni kisik, nemojte dopustiti pušenje ili upotrebu uređaja u blizini otvorenog plamena, ulja, masti, drugih zapaljivih kemikalija ili opreme i alata koji mogu uzrokovati iskrenje jer postoji opasnost od požara i/ili eksplozije.
19. Na verziju za dojenčad nemojte pokušavati priključiti samoregulirajući ventil jer to može uzrokovati visoke koncentracije kisika koje mogu biti štetne za novorođenčad.
20. Pripazite na znakove potpunog/djelomičnog začepljenja gornjih dišnih putova pri upotrebi maske za reanimaciju pričvršćene na masku za lice jer to može dovesti do prekida ili ograničene isporuke kisika. Uvijek se prebacite na zamjensko rješenje upotrebi maske za lice za dovod zraka pacijentu, ako je dostupno.
21. Nemojte upotrebljavati proizvod s pričvršćenom maskom za lice prilikom ventilacije dojenčadi s urođenom diafragmalnom hernijom zbog opasnosti od insuflacije. Prebacite se na zamjensko rješenje upotrebi maske za lice za dovod zraka pacijentu, ako je dostupno.
22. Stručnjaci koji izvode postupak trebali bi procijeniti veličinu maske za reanimaciju i dodatne opreme (npr. maska za lice, PEEP ventil itd.) u skladu sa stanjem pacijenta jer neispravna upotreba može dovesti do ozljede pacijenta.
23. Nemojte upotrebljavati Ambu SPUR II ako je potreban slobodan protok kisika zbog jer može doći do nedovoljnog dovoda kisika, što može dovesti do hipoksije.
24. Poklopac manometra uvijek se mora postaviti na priključak manometra kada se ne nadzire tlak kako bi se izbjeglo curenje, što može dovesti do smanjene isporuke O₂ pacijentu.
25. Uvijek pričvrstite cijev za kisik na dovod kisika pri temperaturi iznad 0 °C jer postavljanje može postati teško na temperaturama ispod 0 °C, što može dovesti do smanjene isporuke kisika pacijentu.
26. Pri upotrebi maske za reanimaciju s pričvršćenom maskom za lice provjerite je li maska za lice ispravno postavljena i zabrtvljena jer nepravilno brtvljenje može uzrokovati širenje zarazne bolesti koja se prenosi zrakom na korisnika.

MJERE OPREZA

1. Nikada ne pohranjujte masku za reanimaciju u deformiranom stanju, odnosno pohranjujte je isključivo s balonom presavinutim kao i kada je proizvođač isporučio uređaj inače može doći do trajne deformacije balona koja može smanjiti učinkovitost ventilacije. Zona presavijanja jasno je vidljiva na balonu (samo se verzije za odrasle i za pedijatrijsku primjenu mogu presavinuti).
2. Uvijek promatrajte kretanje prsa i slušajte ekspiracijski protok iz pacijentovog ventila kako biste provjerili učinkovitost ventilacije. Odmah prijedite na ventilaciju usta na usta ako nije moguće postići ventilaciju s pomoću maske za reanimaciju.
3. Nemojte namakati, ispirati niti sterilizirati ovaj uređaj jer ti postupci mogu dovesti do stvaranja štetnih nakupina ili neispravnog rada uređaja. Dizajn i upotrijebljeni materijali nisu kompatibilni s klasičnim postupcima čišćenja i sterilizacije.
4. Upotrijebite priključak M za samo jedno od sljedećeg: mjerjenje EtCO₂ ili davanje lijekova jer se time mogu promijeniti izmjerene vrijednosti.
5. Ako je primjenjivo, na pakiranju dodatne opreme potražite dodatne informacije o dodatnoj opremi jer nepravilno rukovanje može dovesti do kvara cijelog proizvoda.
6. Upotreba proizvoda drugih proizvođača i uređaja za isporuku kisika (npr. filtara i samoregulirajućih ventila) s maskom za reanimaciju Ambu SPUR II mogu utjecati na rad proizvoda. Obratite se proizvođaču uređaja treće strane da biste provjerili kompatibilnost s maskom za reanimaciju Ambu SPUR II i saznali više o mogućim izmjenama karakteristika.
7. Balon spremnika kisika trajno je pričvršćen na ulazni ventil na maskama za reanimaciju za odrasle i za pedijatrijsku primjenu, osim na verzijama sa samoregulirajućim ventilom. Ne pokušavajte rastavljati. Nemojte povlačiti balon spremnika kisika jer to može dovesti do neispravnog rada uređaja.

1.8. Moguće neželjene posljedice

Moguće neželjene posljedice povezane s reanimacijom (između ostalog): barotrauma, volutrauma, hipoksija, hiperkarbija i aspiracijska upala pluća.

1.9. Opće napomene

Ako se prilikom upotrebe ovog uređaja ili uslijed njegove upotrebe dogodi ozbiljan incident, privajte ga proizvođaču i nadležnom državnom tijelu.

2. Opis uređaja

Maska za reanimaciju Ambu SPUR II može se priključiti na Ambu® manometar za jednokratnu upotrebu, Ambu® PEEP ventile i maske za lice Ambu® kao što je opisano u odjeljku 4.3. Rukovanje maskom za reanimaciju.

3. Objasnjenje upotrijebljenih simbola

Simbol	Opis
	Za odrasle Predviđena idealna tjelesna masa veća od 30 kg
	Za pedijatrijsku primjenu Predviđena idealna tjelesna masa od 6 do 30 kg
	Za dojenčad Predviđena idealna tjelesna masa do 10 kg
	Pogodno za magnetsku rezonancu.

Simbol	Opis
	Zemlja proizvođača
	Medicinski uređaj
	Za višekratnu upotrebu na jednom pacijentu
	Nemojte na silu povlačiti balon spremnika kisika

Popis objašnjenja svih simbola možete pronaći na web-adresi <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Upotreba proizvoda

4.1. Načelo rada

Slika 1 prikazuje protok mješavine plinova za ventilaciju u balon te do pacijenta i od njega tijekom ručne upotrebe maske za reanimaciju. 1a Maska za reanimaciju za odrasle i za pedijatrijsku primjenu, 1b Maska za reanimaciju za dojenčad sa zatvorenim balonom spremnika kisika (spremnik s balonom), 1c Maska za reanimaciju za dojenčad s otvorenom cijevi spremnika kisika (spremnik s cijevi).

Protok plina sličan je spontanom disanju pacijenta kroz uređaj.

Spremnik kisika opremljen je dvama ventilima, jednim koji omogućuje uvlačenje okолнog zraka kada je spremnik prazan i jednim koji izbacuje višak kisika kada je balon spremnika kisika pun.

Priklučak M pruža pristup protoku inspiracijskog i ekspiracijskog zraka omogućavajući spajanje štrcaljke za primjenu lijekova 1d ili priključenje cjevčice za uzimanje uzorka zraka radi mjerjenja sekundarnog EtCO₂ 1e.

- 1.1 Otpuštanje viška kisika, 1.2 Uzal za zrak, 1.3 Uzal za kisik, 1.4 Pacijentov priključak, 1.5 Ekspiracija, 1.6 Priključnica za manometar, 1.7 Ventil za ograničenje tlaka, 1.8 Priključak M.

NAPOMENA: prilog za 1.5. može biti zaštita od prskanja ili PEEP ventil.

4.2. Provjera i priprema

Masku sa reanimaciju treba raspakirati i pripremiti (te provesti ispitivanje funkcionalnosti) za upotrebu neposredno prije upotrebe u hitnim situacijama.

4.2.1. Priprema

- Ako je maska za reanimaciju pohranjena u komprimiranom stanju, razmotajte je povlačenjem pacijentovog ventila i ulaznog ventila.
- Pripremite masku za reanimaciju i stavite sve dijelove u vrećicu za nošenje isporučenu s uređajem.
- Ako je maska isporučena s uređajem zamotana u zaštitni omot, omot je potrebno ukloniti prije upotrebe.

Pogledajte odjeljak 4.2.2. (Cijev za kisik) za pripremu uređaja prije uporabe na temperaturi ispod 0 °C.

4.2.2. Ispitivanje funkcionalnosti 2

Maska za reanimaciju

Zatvorite ventil za ograničenje tlaka kvačicom za premoščivanje i palcem zatvorite pacijentov priključak 2.1. Žustro pritišćite balon. Maska za reanimaciju pružat će otpor pritisku.

Otvorite ventil za ograničenje tlaka tako da pomaknete kvačicu za premošćivanje i ponovite postupak. Ventil za ograničenje tlaka sada bi trebao biti aktiviran te bi se trebao čuti protok iz ventila tijekom žustre kompresije balona.

Nekoliko puta pritisnite i otpustite balon za reanimaciju kako biste osigurali da zrak prolazi kroz sustav ventila i iz pacijentovog ventila. **2.2**

NAPOMENA:Dok se diskovi ventila kreću tijekom ispitivanja funkcionalnosti ili tijekom ventilacije, moguća je pojava tihog zvuka. To ne dovodi u pitanje funkcionalnost maske za reanimaciju.

Cijev za kisik

Postavljanje cijevi za kisik i ispitivanje funkcionalnosti balona spremnika kisika i cijevi spremnika kisika treba provoditi pri temperaturi iznad 0 °C. Za upotrebu maske za reanimaciju na temperaturama ispod 0 °C ostavite cijev za kisik priključenu na dovod kisika nakon ispitivanja funkcionalnosti.

Balon spremnika kisika

Osigurajte protok plina od 10 l/min na ulaznom priključku za kisik. Možete i rukom pridržavati balon dok se otvara. Provjerite puni li se balon spremnika kisika. Ako se ne puni, provjerite cjelovitost dvaju zatvarača ventila te je li spremnik kisika poderan.

Nakon toga prilagodite dotok plina u skladu s medicinskom indikacijom.

Cijev spremnika kisika

Osigurajte protok plina od 10 l/min na ulaznom priključku za kisik. Provjerite izlazi li kisik iz kraja cijevi spremnika za kisik. Ako ne izlazi, provjerite je li cijev za kisik blokirana. Nakon toga prilagodite dotok plina u skladu s medicinskom indikacijom.

Priklučak M

Uklonite poklopac priključka M te blokirajte pacijentov priključak. Pritisnite balon i slušajte zvuk zraka koji se istiskuje kroz priključak M. **2.3**

4.3. Rukovanje maskom za reanimaciju

- Primijenite preporučene tehnike za čišćenje pacijentovih usta i dišnog puta te ispravno namještanje pacijenta da bi se otvorio dišni put.
- Držite masku za lice čvrsto uz pacijentovo lice. **3.1**
- Postavite svoju ruku (verzija za odrasle) ili prsten i srednji prst (verzija za pedijatrijsku primjenu) ispod ručke. Verzija za dojenčad nema potpornu ručku. Ventilacija bez upotrebe potporne ručke može se postići okretanjem balona. **3.2** Ventilirajte pacijenta: promatrajte podizanje prsa tijekom insuflacije. Brzo otpustite balon držeći ga rukom i slušajte ekspiracijski protok iz pacijentovog ventila, kao i dok se prsa spuštaju.
- Ako najdete na kontinuirani otpor insuflaciji, provjerite postoji li prepreka u dišnom putu i namjestite pacijenta da bi se otvorio dišni put.
- Ako pacijent povrati tijekom ventilacije; odmah očistite pacijentov dišni put i istisnite povraćeni sadržaj s maske za reanimaciju tako da je snažno i brzo protresete i stisnute nekoliko puta prije nastavka ventilacije.
Ako je potrebno, obrišite proizvod kromp koja sadrži alkohol i očistite zaštitu od prskanja vodom.

Priklučnica za manometar

Na priključnicu za manometar na vrhu pacijentova ventila može se pričvrstiti Ambu manometar za jednokratnu upotrebu, kao i manometar treće strane. Skinite poklopac i pričvrstite manometar

Sustav za ograničenje tlaka **4**

Ventil za ograničenje tlaka otvara se pri 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Ako se medicinskom i stručnom procjenom utvrdi da je potreban tlak veći od 40 cm H₂O, moguće je premostiti ventil za ograničenje tlaka postavljanjem kvačice za premošćivanje na ventil. **4.2**

Isto tako, ventil za ograničenje tlaka može se premostiti postavljanjem prsta na crveni gumb tijekom pritiskanja balona.

Priklučak M

Maska za reanimaciju Ambu SPUR II dolazi sa ili bez priključka M. Priklučak M omogućuje pristup protoku inspiracijskog i ekspiratornog plina te može poslužiti za primjenu lijekova ako se spoji na štrcaljku, kao i za mjerjenje sekundarnog toka CO₂ (EtCO₂). Kada se ne koristi, nemojte zaboraviti zatvoriti priključak M crvenim poklopcom za priključak M.

Mjerjenje EtCO₂

Za mjerjenje sekundarnog toka EtCO₂; priključite cjevčicu za uzimanje uzorka plina za uređaj za mjerjenje EtCO₂ na priključak M maske za reanimaciju Ambu SPUR II. Priključite cjevčicu za uzimanje uzorka plina tako da je postavite i okrenete za 1/4 okretaja u smjeru kazaljke na satu.

Davanje lijekova

Pažljivo promatrazte pacijentovu reakciju na primijenjene lijekove. Davanje tekućine volumena 1 ml ili više putem priključka M usporedivo je s primjenom izravno u endotrahealnu cijev. Priključak M ispitani je s epinefrinom, lidokainom i atropinom.

Verzija samoregulirajućeg ventila maske za reanimaciju Ambu SPUR II 5

Verzija samoregulirajućeg ventila maske za reanimaciju Ambu SPUR II dostupna je u veličinama za odrasle i pedijatrijsku primjenu, može se upotrebljavati sa samoregulirajućim ventilom ili bez njega, a isporučuje se s balonom spremnika kisika koji se može pričvrstiti.

Ulagani ventil maske za reanimaciju Ambu SPUR II priključuje se na samoregulirajući ventil putem adaptera.

Pričvršćivanje samoregulirajućeg ventila:

- Skinite jedinicu spremnika kisika s ulaznog ventila maske za reanimaciju Ambu SPUR II ako je pričvršćena.
- Pričvrstite adapter na sustav samoregulirajućeg ventila.
- Umetnute adapter samoregulirajućeg ventila u ulagani ventil maske za reanimaciju Ambu SPUR II.

NAPOMENA: Upotrebljavajte samo dio s oznakom „kompresijska jedinica“ s adapterom i samoregulirajućim ventilom. Dio s oznakom „Balon spremnika kisika“ smatra se rezervnim dijelom u slučaju kvara na samoregulirajućem ventili.

Davanje kisika

Kisik se daje u skladu s medicinskom indikacijom.

Na slici 6 prikazani su izračunati isporučeni postotci kisika koji se mogu postići različitim volumenima i frekvencijama ventilacije pri različitim brzinama protoka plina. Postotke kisika možete provjeriti za 6 odrasle, 6.1 pedijatrijsku primjenu i 6.2 dojenčad 6.3.

Balon spremnika kisika 7

Tanka plastična folija balona spremnika kisika ne može se bilo kad odvojiti od pričvršne točke maske za reanimaciju.

Dodatna oprema 8

Priklučni maske za reanimaciju Ambu SPUR II u skladu su s normom ISO 5356-1 i EN 13544-2, pa su prikladni za drugu bolničku opremu. Ako primjenjujete vanjske uređaje, provjerite rade li ispravno i proučite upute za upotrebu odgovarajućeg vanjskog uređaja.

Proizvodi tvrtke Ambu kompatibilni s maskom za reanimaciju Ambu SPUR II navedeni su u nastavku:

Maska za lice Ambu® za jednokratnu upotrebu

Dodatne informacije potražite u uputama za upotrebu maske za lice Ambu za jednokratnu upotrebu.

Ambu® PEEP 20 ventil za jednokratnu upotrebu 8.1 8.2

Dodatne informacije potražite u uputama za upotrebu Ambu PEEP 20 ventila za jednokratnu upotrebu ili pogledajte sliku 8.1 u ovim uputama za upotrebu. Da biste postavili Ambu PEEP 20 ventil za jednokratnu upotrebu (ako je potreban) na masku za reanimaciju, uklonite zaštitu od prskanja. 8.2

Ambu® manometar za jednokratnu upotrebu 8.3

Dodatne informacije potražite u uputama za upotrebu Ambu manometra za jednokratnu upotrebu.

4.4. Nakon upotrebe

Rabljeni proizvodi moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim postupcima.

5. Tehničke specifikacije proizvoda

5.1. Primjenjene norme

Maska za reanimaciju Ambu SPUR II usklađena je s normom EN ISO 10651-4 koja se odnosi na proizvod.

5.2. Specifikacije

	Za dojenčad	Za pedijatrijsku primjenu	Za odrasle
Volumen maske za reanimaciju	pribl. 220 ml	pribl. 670 ml	pribl. 1510 ml
Isporučeni volumen jednom rukom*	150 ml	450 ml	600 ml
Isporučeni volumen dvjema rukama*	-	-	1000 ml
Dimenzije (duljina x promjer) bez spremnika i dodatne opreme	pribl. 190 x 71 mm	pribl. 223 x 99 mm	pribl. 284 x 127 mm
Težina bez spremnika i dodatne opreme	pribl. 70 g	pribl. 145 g	pribl. 220 g
Ventil za ograničenje tlaka**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)

	Za dojenčad	Za pedijatrijsku primjenu	Za odrasle
Mrtvi prostor	≤ 5 ml + 10 % isporučenog volumena	≤ 5 ml + 10 % isporučenog volumena	≤ 5 ml + 10 % isporučenog volumena
Inspiracijski otpor***	maks. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) pri 5 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pri 50 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pri 50 l/min
Ekspiracijski otpor***	maks. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) pri 5 l/min	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pri 50 l/min	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pri 50 l/min
Volumen spremnika	pribl. 300 ml (balon) pribl. 100 ml (cijev)	pribl. 2600 ml (balon)	pribl. 2600 ml (balon)
Pacijentov priključak		Vanjski muški od 22 mm (ISO 5356-1) Unutarnji ženski od 15 mm (ISO 5356-1)	
Ekspiracijski priključak (za priključenje PEEP ventila)			Muški od 30 mm (ISO 5356-1)
Priključnica za manometar			Ø 4,2 +/- 0,1 mm
Priključak samoregulirajućeg ventila		-	Unutarnji ženski od 32 mm (EN ISO 10651-4)
Propuštanje prema naprijed i prema natrag			Nije mjerljivo
Priključak M			Priključak je kompatibilan prema normi ISO 80369-7
Ulazni priključak za O ₂			Prema standardu EN 13544-2
Ograničenja radne temperature			Od -18 °C do +50 °C (od -4 °F do +122 °F), ispitano u skladu s normom EN ISO 10651-4
Ograničenja temperature skladištenja:			Od -40 °C do +60 °C (od -40 °F do +140 °F), ispitano u skladu s normom EN ISO 10651-4
Preporučuje se dugotrajno skladištenje u zatvorenom pakiranju pri sobnoj temperaturi, dalje od sunčeva svjetla.			

* Ispitano u skladu s normom EN ISO 10651-4.

** Veći izlazni tlak može se postići premošćivanjem ventila za ograničenje tlaka.

*** U općim uvjetima ispitivanja prema normi EN ISO 10651-4.

5.3. Sigurnosne informacije o MR-u



Maska za reanimaciju Ambu SPUR II¹, maska za reanimaciju Ambu SPUR II s Ambu PEEP 20 ventilom za jednokratnu upotrebu² i maska za reanimaciju Ambu SPUR II s Ambu PEEP 20 ventilom za jednokratnu upotrebu i Ambu manometrom² pogodne za magnetsku rezonanciju, što znači da su sigurne za upotrebu u MR okruženju magnetske rezonancije (ne u tunelu za MR) u sljedećim uvjetima.

Statičko magnetsko polje od 7 tesla i manje, uz

- Maksimalni prostorni gradijent od
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²
- Maksimalnu silu od
 - 450.000.000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G²/cm (721 T²/m)²

Upotreba u tunelu za MR može utjecati na kvalitetu MR slike.

Zagrijavanje inducirano radiofrekvencijskim zračenjem i tvorevine na MR slici nisu ispitani.

Metalni dijelovi potpuno su zatvoreni i ne dolaze u dodir s ljudskim tijelom.

1. Fontos információk – Használat előtt elolvasandó

Az Ambu® SPUR® II lélegeztetőballon használata előtt gondosan ismerkedjen meg ezekkel a biztonsági utasításokkal. A használati útmutató további értesítés nélkül frissülhet. Az aktuális változatot kérésre rendelkezésre bocsátjuk. Fehívjük figyelmét, hogy a jelen útmutató nem magyarázza el és nem ismerteti a klinikai eljárásokat. Csak a lélegeztetőballon alapvető működtetéséhez szükséges információkat és a kapcsolódó óvintézkedéseket tartalmazza. A lélegeztetőballon első használata előtt engedélyeztetlen, hogy a kezelő megfelelő képzésben részesüljön az újraélesztési technikák területén, és megismerkedjen a jelen útmutatóban foglalt rendeltetéssel, figyelmeztetésekkel, óvintézkedésekkel és javallatokkal. Az Ambu SPUR II lélegeztetőballon nem garanciális.

1.1. Rendeltetés

Az Ambu SPUR II légeztetőballon újraélesztésre szolgáló, egyetlen beteghez használható eszköz.

1.2. Felhasználási javallatok

Az Ambu SPUR II légeztetőballon olyan esetekben alkalmazható, amikor a lélegeztetéshez kézi kardiopulmonális újraélesztő eszköz szükséges.

Az Ambu SPUR II légeztetőballon a betegek légeztetésére és oxigenizálására szolgál, amíg nem biztosítható stabilabb légút, vagy amíg újra nem sikerül éleszteni a beteget.

1.3. Javallott betegpopuláció

Az egyes változatok alkalmazásának mérettartományai:

- **Felnőtt:** Felnőttek és több mint 30 kg-os (66 font) gyermek esetében használható.
- **Gyermekek:** 6 és 30 kg (13 és 66 font) közötti testsúlyú csecsemők és gyermekek esetében használható.
- **Csecsemő:** Üjszülöttek és csecsemők esetében használható, legfeljebb 10 kg-ig (22 font). Fehívjük figyelmét, hogy nem áll rendelkezésre az Ambu SPUR II légeztetőballon összes konfigurációja a betegek mindenkorban körében.

1.4. Célfelhasználó

A légútbiztosításban képzett egészségügyi szakemberek, például aneszteziológusok, nővérek, mentők és sürgősségi személyzet.

1.5. Ellenjavallatok

Nem ismeretesek.

1.6. Klinikai előnyök

A kézi légeztetőballonnal végzett alapvető légútbiztosítási technika lehetővé teszi a légeztetést és az oxigenizálást, amíg nem biztosítható stabilabb légút, vagy amíg újra nem sikerül éleszteni a beteget.

1.7. Figyelmeztetések és óvintézkedések

Az ezen óvintézkedések figyelmen kívül hagyása miatt előfordulhat, hogy a beteget nem sikerül megfelelően légeztetni és oxigenizálni, vagy a berendezés megsérül.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A fertőzésveszély megelőzése érdekében a légeztetőballont összesen legfeljebb 4 órán át szabad használni, legfeljebb 1 hetes időkeretben.
2. A fertőzésveszély és a helytelen működés megelőzése érdekében ne használja újra a légeztetőballont, ha látható nedvesség vagy maradványok vannak az eszközben.
3. Gondoskodjon róla, hogy vagy a fröccsenésgátló, vagy az Ambu PEEP-szelep csatlakoztatva legyen a kilégzőszárra. A nyitott kilégzőszár véletlen elzáródása esetén túl nagy térfogatú levegő kerülhet a tüdőbe, ami szövetsérülést okozhat.
4. A szövetkárosodás kockázatának megelőzése érdekében ne használja a légeztetőballont mérgező vagy veszélyes környezetben.

5. Mindig győződjön meg róla, hogy az oxigénrezervoár-cső nincs elzáródva, mivel a cső elzáródása megakadályozhatja a kompressziós tasak újbóli felfújását, lehetetlenné téve a lélegeztést.
6. Ha a termék külső forrásból szennyeződött, akkor ne használja fel, mert fertőzést okozhat.
7. Kicsomagolás és összeállítás után, valamint használat előtt minden vizsgálja meg a terméket szemrevételezéssel, és végezzen működési tesztet, mert hiba vagy idegen anyag jelenléte beteg lélegeztetésének elmaradását vagy gyengülését okozhatja.
8. Ne használja fel a terméket, ha a működési teszt sikertelen, mert ez a lélegeztetés elmaradását vagy gyengülését okozhatja.
9. Csak abban az esetben iktassa ki a nyomáskorlátozó szelepet, ha orvosi értékelés jelzi ennek szükségességét. A nagy lélegeztetési nyomás barotraumát okozhat.
10. Kizárálag egyetlen betegnél használható eszköz. Ha más betegeknél is használja, az keresztfertőzéshez vezethet.
11. Ha tartozék (pl. szűrő, CO₂-detektor) van csatlakoztatva a lélegeztetőballon és az arcmaszk közé, akkor az M-Porton keresztül nem adható be gyógyszer.
12. Használat után ne hagyja nyitva az M-portot, mert ez szívárgáshoz vezethet, ami miatt csökkenhet a beteg O₂-ellátása.
13. Az M-Port nem használható 400 ml-nál kisebb légzési térfogattal lélegeztetett betegeknél az oldaláramú EtCO₂ monitorozására, mert pontatlan lehet az EtCO₂ mérése.
14. 1 ml-nél kisebb térfogatú gyógyszer beadásához az adagolás pontossága érdekében át kell öblíteni az M-Portot.
15. Ne csatlakoztasson oxigéncsövet az M-Porthoz, mert a beteg nem kapja meg a szükséges O₂-koncentrációt.
16. Tartozékok hozzáadása esetén megnöhet a belégzési és/vagy kilégzési ellenállás. Ne csatlakoztasson tartozékokat, ha a megnövekedett légzési ellenállás hátrányos lenne a betegre nézve.
17. A terméket csak a rendeltetésének megfelelő, a jelen útmutató tartalmát ismerő felhasználó használhatja, mert helytelen használata esetén megsérülhet a beteg.
18. Kiegészítő oxigén használata esetén a tűz és/vagy robbanás kockázata miatt tilos a dohányzás vagy az eszköz nyílt láng, olaj, zsír, egyéb gyúlékony vegyi anyagok, illetve szikrát okozó berendezések vagy eszközök közelében történő használata.
19. A csecsemők számára készült változathoz ne próbáljon meg szabályozószelepet csatlakoztatni, mert ez nagy oxigénkoncentrációt okozhat, ami káros lehet az újszülöttkre nézve.
20. Arcmaszkhoz csatlakoztatott lélegeztetőballon használata esetén figyelje a felső légtutak teljes vagy részleges elzáródásának jeleit, mert ez korlátozhatja vagy leállíthatja az oxigénellátást. Lehetőség szerint minden alkalmazzon más megoldást az arcmaszk helyett a levegő beteghez történő vezetésére.
21. Veleszületett rekeszsérvben szerevő csecsemő lélegeztetésekor az inszuffláció kockázata miatt soha ne használja a terméket csatlakoztatott arcmaszkkal. Lehetőség szerint alkalmazzon más megoldást az arcmaszk helyett a levegő beteghez történő vezetésére.
22. Az eljárást végző szakembereknek a beteg konkrét állapota alapján kell kiválasztaniuk a lélegeztetőballon méretét és a tartozékokat (pl. arcmaszk, PEEP-szelep stb.), mert helytelen használat esetén megsérülhet a beteg.
23. Ha szabad áramlású oxigént kell biztosítani, akkor ne használja az Ambu SPUR II terméket, mert ez az esetleges elégűleg oxigénellátás miatt hypoxiához vezethet.
24. Amikor nem monitorozza a nyomást, a manometré sapkája mindenkor legyen a manometré-csatlakozón; ellenkező esetben szívárgás következhet be, és csökkenhet a beteg O₂-ellátása.
25. Mindig csatlakoztassa előre az oxigéncsövet az oxigénellátáshoz 0 °C feletti hőmérsékleten, ugyanis 0 °C alatti hőmérsékleten nehézséget okozhat a csatlakoztatás, és ez a beteg oxigénellátásának csökkenéséhez vezethet.
26. Ha csatlakoztatott arcmaszkkal használja a lélegeztetőballont, gondoskodjon az arcmaszk megfelelő elhelyezéséről és tömítéséről, mivel helytelen tömítés esetén a felhasználó légi úton terjedő fertőző betegséget kaphat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Mindig a gyári állapot szerint összehajtva tárolja a lélegeztetőballont, máskülönben a ballon alakja tartósan eldeformálódhat, ami csökkentheti a lélegeztetés hatóosságát. A behajtás helye jól látható a balloonon (csak a felnőtt- és gyermekváltozat hajtható össze).
2. Mindig ellenőrizze a mellkas emelkedését és süllyedését, és figyelje meg a kiáramlás hangját a betegszelepből annak megállapítására, hogy működik-e a lélegeztetés. Ha a lélegeztetőballonnal nem sikerül lélegeztetni, azonnal váltson át szájon át történő lélegeztetésre.
3. Ne áztassa, öblítse vagy sterilizálja az eszközt, mert így káros anyagok maradhatnak vissza, vagy meghibásodhat az eszköz. Kialakítása és a felhasznált anyagok miatt az eszköz nem tisztítható és sterilizálható hagyományos eljárásokkal.
4. Az M-Portot kizárolag az EtCO₂ mérésére vagy gyógyszer beadására használja, mivel a használata módosíthatja a mért értékeket.
5. Adott esetben ismerkedjen meg az egyes tartozékokkal kapcsolatos pontos információkkal a tartozék csomagolásán, mert a helytelen kezelés az egész termék hibás működéséhez vezethet.
6. Harmadik fél termékeinek és oxigénellátó eszközeinek (pl. szűrők és szabályozószelepek) használata az Ambu SPUR II lélegeztetőballonnal befolyásolhatja a termék teljesítményét. Az Ambu SPUR II légeztetőballonnal való kompatibilitást és a teljesítmény esetleges változásait illetően forduljon a harmadik félől származó eszköz gyártójához.
7. Az oxigénrezervoár-tasak tartósan rögzítve van a légeztetőballon felnőtt- és gyermekváltozatának bemeneti szelepéhez, kivéve a szabályozószeleppel rendelkező változatokat. Ne kísérleje meg leszerelni. Ne húzza meg az oxigénrezervoár-tasakot, mert ez az eszköz helytelen működését okozhatja.

1.8. Lehetséges nemkívánatos események

Az újraélesztéssel kapcsolatos lehetséges nemkívánatos események (a felsorolás nem teljes): barotrauma, volutrauma, hypoxia, hypercarbia és aspiratiós pneumonia.

1.9. Általános megjegyzések

Amennyiben az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos incidens történik, jelentse azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak.

2. Az eszköz leírása

Az Ambu SPUR II légeztetőballon a 4.3. A légeztetőballon működtetése című fejezetben foglaltak alapján csatlakoztatható az Ambu® egyszer használatos nyomásmanométerhez, az Ambu® PEEP-szelepekhöz és az Ambu® arcmaszkokhoz.

3. A használt szimbólumok

Szimbólumok jelentése	Leírás
 ADULT > 30 kg	Felnőtt 30 kg feletti javallott ideális testsúly
 PEDIATRIC 6 - 30 kg	Gyermekek 6 és 30 kg közötti javallott ideális testsúly
 INFANT < 10 kg	Csecsemő Legfeljebb 10 kg-os javallott ideális testsúly

Szimbólumok jelentése	Leírás
	MR-környezetben feltételesen biztonságos
	A gyártó országa
	Orvostechnikai eszköz
	Egyetlen betegnél, több alkalommal használható eszköz
	Ne húzza meg erősen az oxigénrezervoár-tasakot.

A szimbólumok magyarázatának teljes lista megtalálható a <https://www.ambu.com/symbol-explanation> címen.

4. A termék használata

4.1. Működési elv

Az 1 ábrán látható, hogy a lélegeztetőballon manuális használata közben a gázkeverék hogyan áramlik bele a tasakba, majd onnan a beteg tüdejébe. 1a Felnőtt- és gyermek-lélegeztetőballon, 1b csecsemő-lélegeztetőballon zárt oxigénrezervoár-tasakkal (tasakos rezervóár), 1c csecsemő-légeztetőballon nyitott oxigénrezervoár-csővel (csöves rezervóár).

A gázáramlás nagyon hasonló ahhoz, mint amikor a beteg spontán lélegzik az eszközön keresztül.

Az oxigénrezervoár két szeleppel van felszerelve: az egyiken keresztül a környezeti levegő áramlik be, amikor a rezervóár üres, a másikon a feleslegben lévő oxigén távozik, amikor a rezervóártasak tele van.

Az M-Port biztosítja a belégzési és kilégzési gáz áramlását, miközben lehetővé teszi gyógyszerbeadásra szolgáló fecskendő csatlakoztatását 1d, illetve oldaláramú EtCO₂-mérésre szolgáló gázmintavező vezetékhez történő csatlakoztatást 1e.

1.1 feleslegben lévő oxigén kimenete, 1.2 levegőbemenet, 1.3 oxigénbemenet, 1.4 beteg felőli csatlakozó, 1.5 kilégzés, 1.6 manometré-csatlakozó, 1.7 nyomáskorlátozó szelep, 1.8 M-Port.

MEGJEGYZÉS: az 1.5-őshöz vagy fröccsenésgátló, vagy PEEP-szelep csatlakoztatható.

4.2. Ellenőrzés és előkészítés

A lélegeztetőballont még azelőtt ki kell csomagolni és elő kell készíteni (a működési tesztet is beleértve) azonnali felhasználásra, mielőtt vész helyzetben használni.

4.2.1. Előkészítés

- Ha a lélegeztetőballon összenyomott állapotban van becsomagolva, a betegszelep és a bemeneti szelep meghúzával nyissa ki.
- Készítse elő a légeztetőballont, és helyezze fel a mellékelt hordtokban található valamennyi elemet.
- Ha a légeztetőballonhoz mellékelt arcmaszk külön védőcsomagolásban van, a csomagolást használat előtt el kell távolítani.

Lásd a 4.2.2. fejezetet (Oxigéncső) az eszköz előkészítéséhez a 0 °C alatti hőmérsékleten történő használat előtt.

4.2.2. Működési teszt 1d

Lélegeztető ballon

Zárja el a nyomáskorlátozó szelepet a blokkolóval, és hüvelykujjával fogja be a beteg felőli csatlakozót **2.1**. Gyorsan nyomja össze az összenyomható tasakot. A lélegeztetőballonnak ellen kell állnia az összenyomásnak.

Nyissa ki a nyomáskorlátozó szelepet a blokkoló elhúzásával és az eljárás megismétlésével. A nyomáskorlátozó szelepnek ezzel aktiválódnia kell, és az összenyomható tasak gyors összenyomásakor hallhatóan kell áramlania a levegőnek a szelepen keresztül.

Néhányszor nyomja össze és engedje el a lélegeztetőballont, ezzel ellenőrizve, hogy a levegő áthalad-e a szeleprendszeren és kiáramlik-e a betegszelepen. **2.2**

MEGJEGYZÉS: A működési teszt során vagy lélegeztetés közben a szeleptányérok mozgása halk zajjal járhat. Ez nem rontja a légeztetőballon működési hatékonyságát.

Oxigéncső

Az oxigéncső felszerelését, valamint az oxigénrezervoár-tasak és az oxigénrezervoár-cső működési tesztjét 0 °C feletti hőmérsékleten kell elvégezni. A légeztetőballon 0 °C alatti használatához a működési teszt után hagyja az oxigéncsövet az oxigénellátásra csatlakoztatva.

Oxigénrezervoár-tasak

Biztosítson percentként 10 literes áramlást az oxigénbemeneti csatlakozón keresztül. Adott esetben kezzel segítse a tasak kibontását. Ellenőrizze, hogy megtelik-e az oxigénrezervoár-tasak. Ha nem, akkor ellenőrizze a két szelep zárócsapját, illetve azt hogy nincs-e kiszakadva az oxigénrezervoár.

Ezután állítsa be a szállított gáz áramlását az orvosi javallatnak megfelelően.

Oxigénrezervoár-cső

Biztosítson percentként 10 literes áramlást az oxigénbemeneti csatlakozón keresztül. Ellenőrizze, hogy az oxigén átáramlik-e az oxigénrezervoár-csövön. Ha nem, ellenőrizze, hogy az oxigéncső nincs-e elzáródva. Ezután állítsa be a szállított gáz áramlását az orvosi javallatnak megfelelően.

M-Port

Távolítsa el az M-Port zároelemét, és zárja le a beteg felőli csatlakozót. Nyomja össze a tasakot, és figyeljen, hogy hallja-e az M-Porton keresztül kiáramló levegő hangját. **2.3**

4.3. A légeztetőballon működtetése

- A javasolt technikák alkalmazásával tegye szabaddá a beteg száját és légutait, és pozicionálja úgy a beteget, hogy a légitai átjárhatók legyenek.
- Helyezze az arcmaszkot a beteg arcára, és tartsa erősen. **3.1**
- Csúsztassa kezét (felnőtt változat), illetve gyűrűs- és középső ujját (gyermek változat) a pánt alá. A csecsemők számára készült változatnak nincs tartópántja. Tartópánt használata nélkül a tasak elforgatásával biztosítható a légeztetés. **3.2** A beteg légeztetése: Az inszuffláció során figyelje a mellkas emelkedését. Hirtelen eressze el a tasakot, és figyelje a kiáramlás hangját a betegszelepen, valamint vizuálisan a beteg mellkasának ereszkedését.
- Ha folyamatos ellenállást észlel az inszufflációval szemben, akkor ellenőrizze, hogy nem záródtak-e el a légutak, és módosítsa a beteg pozícióját úgy, hogy a légitak átjárhatók legyenek.
- Ha a légeztetés közben a beteg hány, akkor azonnal tisztítsa meg a légutait, és a légeztetés folytatása előtt távolítsa el a hányást a légeztetőballonból úgy, hogy megrázza és erősen, gyorsan összenyomja azt, többször egymás után. Szükség esetén törölje meg a terméket alkoholos törlővel, és tisztítsa meg vízzel a fröccsenésgátlót.

Manométer-csatlakozó

Az Ambu egyszer használatos nyomásmanométer vagy harmadik fél nyomásmérője a betegszelep tetején található manométer-csatlakozóhoz csatlakoztatható. Vegye le a sapkát, és csatlakoztassa a manométert/nyomásmérőt.

Nyomáskorlátozó rendszer 4

A nyomáskorlátozó szelep 40 H₂Ocm (4,0 kPa) értéken aktiválódik. 4.1

Ha az orvosi és szakmai értékelés alapján 40 H₂Ocm-nél nagyobb nyomást kell alkalmazni, a nyomáskorlátozó szelepet kiiktathatja úgy, hogy ráhúzza a blokkolót. 4.2

A másik lehetőség a nyomáskorlátozó szelep kiiktatására, hogy a tasak összenyomásakor a piros gombon tartja a mutatóujját.

M-Port

Az Ambu SPUR II lélegeztetőballon M-Porttal és a nélkül is rendelkezésre áll. A be- és kilégzési gázáramhoz hozzáférést biztosító M-Port lehetővé teszi a gyógyszerbeadást feckendő csatlakoztatásával, valamint az oldaláramú CO₂ (EtCO₂) mérésére is alkalmas. Amikor az M-Port nincs használatban, ne felejtse el lezárnai az M-Port piros zárósapkájával.

EtCO₂ mérése

Oldaláramú EtCO₂ méréséhez csatlakoztassa az EtCO₂-mérő eszköz gázmintavező vezetékét az Ambu SPUR II lélegeztetőballon M-Portjához. A csatlakoztatáshoz illessze a helyére a gázmintavező vezeték csatlakozóját, majd ¼ fordulattal jobbra elforgatva rögzítse.

Gyógyszer beadása

Mindig gondosan ellenőrizze, hogy a beteg hogyan reagál a beadott gyógyszerre. 1 ml-nyi vagy nagyobb mennyiségű folyékony gyógyszer M-Porton keresztül történő beadása olyan, mintha közvetlenül endotracheális csövön keresztül adná be. Az M-Portot tesztelték epinefrin, lidokain és atropin adagolására.

Az Ambu SPUR II lélegeztetőballon szabályozószelepes változata 5

Az Ambu SPUR II légeztetőballon szabályozószelepes változata felnőtt- és gyermekméretben áll rendelkezésre. Ez a csatlakoztatható oxigénrezervoár-tasakkal rendelkező változat szabályozószeleppel és a nélkül is használható.

Az Ambu SPUR II légeztetőballon bemeneti szelepe adapteren keresztül csatlakozik a szabályozószelephez.

A szabályozószelep felszerelése:

- Távolítsa el az oxigénrezervoár-egységet az Ambu SPUR II légeztetőballon bemeneti szelepéről, ha fel van helyezve.
- Csatlakoztassa az adaptert a szabályozószelep-rendszerhez.
- Helyezze be a szabályozószelep adapterét az Ambu SPUR II légeztetőballon bemeneti szelepébe.

MEGJEGYZÉS: Az adaptert és a szabályozószelepet csak „compression unit” (kompressziós egység) megjelölésű részen használja. Az „Oxygen Reservoir Bag” (oxigénrezervoár-tasak) megjelölésű rész tartalékként szolgál a szabályozószelep meghibásodásának esetére.

Az oxigén adagolása

Az oxigént az orvosi javallatoknak megfelelően adagolja.

A 6 ábrán a számított leadott oxigén száraléka látható különféle légeztetési térfogatok és frekvenciák esetén, különféle gázáramlási sebességeknél. Az oxigén száraléka a 6 ábrán külön táblázatban szerepel a felnőtt 6.1, a gyermek 6.2 és a csecsemő 6.3 változat esetén.

Oxigénrezervoár-tasak 7

Az oxigénrezervoár-tasak vékony műanyag fóliája nem választható le bármikor a légeztetőballonról.

Tartozékok 8

Az Ambu SPUR II lélegeztetőballon csatlakozói teljesítik az ISO 5356-1 és az EN 13544-2 követelményeit, így megfelelnek az egyéb kórházi berendezéseknek. Külső eszköz alkalmazása esetén teszelje annak működését, és olvassa el a használati útmutatóját.

Az Ambu alábbi termékei kompatibilisek az Ambu SPUR II lélegeztetőballonnal:

Ambu® egyszer használatos arcmaszk

További információkkal az Ambu egyszer használatos arcmaszk használati útmutatója szolgál.

Ambu® egyszer használatos PEEP 20 szelep 8.1 8.2

További információkkal az Ambu egyszer használatos PEEP 20 szelep használati útmutatója, illetve a jelen használati útmutató 8.1 ábrája szolgál. Ha az Ambu egyszer használatos PEEP 20 szelepet fel kell helyezni a lélegeztetőballonra, akkor távolítsa el a fröccsenésgátlót. 8.2

Ambu® egyszer használatos nyomásmanométer 8.3

További információkkal az Ambu egyszer használatos nyomásmanométer használati útmutatója szolgál.

4.4. Használat után

A használt termékeket a helyi eljárásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5. A termék műszaki jellemzői

5.1. Alkalmazott szabványok

Az Ambu SPUR II lélegeztetőballon megfelel az EN ISO 10651-4 termékspecifikus szabványnak.

5.2. Műszaki jellemzők

	Csecsemő	Gyermekek	Felnőtt
Lélegeztetési térfogat	kb. 220 ml	kb. 670 ml	kb. 1510 ml
Szállított térfogat egy kézzel*	150 ml	450 ml	600 ml
Szállított térfogat két kézzel*	-	-	1000 ml
Méret (hosszúság x átmérő) rezervoár és tartozékok nélkül	kb. 190 x 71 mm	kb. 223 x 99 mm	kb. 284 x 127 mm
Tömeg rezervoár és tartozékok nélkül	kb. 70 g	kb. 145 g	kb. 220 g
Nyomáskorlátozó szelep**	4,0 kPa (40 H ₂ Ocm)	4,0 kPa (40 H ₂ Ocm)	4,0 kPa (40 H ₂ Ocm)
Holttérfogat	≤5 ml + a szállított térfogat 10 %-a	≤5 ml + a szállított térfogat 10 %-a	≤5 ml + a szállított térfogat 10 %-a
Belégzési ellenállás***	legfeljebb 0,1 kPa (1,0 H ₂ Ocm) 5 l/min mellett	legfeljebb 0,5 kPa (5,0 H ₂ Ocm) 50 l/min mellett	legfeljebb 0,5 kPa (5,0 H ₂ Ocm) 50 l/min mellett
Kilégzési ellenállás***	legfeljebb 0,2 kPa (2,0 H ₂ Ocm) 5 l/min mellett	legfeljebb 0,27 kPa (2,7 H ₂ Ocm) 50 l/min mellett	legfeljebb 0,27 kPa (2,7 H ₂ Ocm) 50 l/min mellett
Rezervoártérfogat	kb. 300 ml (tasak) kb. 100 ml (cső)	kb. 2600 ml (tasak)	kb. 2600 ml (tasak)
Beteg felőli csatlakozó		22 mm-es, külső menetes (ISO 5356-1) 15 mm-es, belső menetes (ISO 5356-1)	
Kilégzési csatlakozó (PEEP-szelep-szerelékhez)		30 mm-es apacsatlakozó (ISO 5356-1)	
Manométer-csatlakozó		Ø 4,2 +/-0,1 mm	
Szabályozószelep-csatlakozó	-	32 mm-es, belső menetes (EN ISO 10651-4)	
Előre- és visszaáramlás		Nem mérhető	

	Csecsemő	Gyermekek	Felnőtt
M-Port	Az EN ISO 80369-7 szabvánnyal kompatibilis csatlakozó		
O ₂ -bemeneti csatlakozó	Az EN 13544-2 szabványnak megfelelő		
Üzemelő hőmérséklet korlátai	-18 – +50 °C (-0,4 – +122 °F), az EN ISO 10651-4 szerint tesztelve		
Tárolási hőmérséklet korlátai	-40 – +60 °C (-40 – +140 °F), az EN ISO 10651-4 szerint tesztelve		
Hosszú távú tárolás esetén javasolt zárt csomagolásban, szobahőmérsékleten, napfénytől védve tartani.			

* Az EN ISO 10651-4 szabvány szerint tesztelve.

** A nyomáskorlátozó szelep kiiktatásával az eszköz nagyobb nyomáson működtethető.

*** Általános tesztelési feltételek mellett az EN ISO 10651-4 szabványnak megfelelően.

5.3. MRI-vel kapcsolatos biztonsági információk

Az Ambu SPUR II lélegeztetőballon¹, az Ambu SPUR II lélegeztetőballon csatlakoztatott Ambu egyszer használatos PEEP 20 szeleppel², valamint az Ambu SPUR II légeztetőballon csatlakoztatott Ambu egyszer használatos PEEP 20 szeleppel és Ambu egyszer használatos nyomásmanométerrel² MR-környezetben feltételesen biztonságos, ezért a következő feltételek mellett biztonságosan használható MR-környezetben (az MRI-berendezés alagútjában nem).

A statikus mágneses mező legfeljebb 7 tesla lehet, továbbá:

- A maximális térradienciák
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- A maximális erőszorozat
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Az MRI-berendezés alagútjában történő használat befolyásolhatja az MR-kép minőségét.

Az RF-indkált melegedést és az MR-kép hibáit nem vizsgálták. Valamennyi fém alkatrész teljesen tokozott, egyáltalán nem érintkeznek az emberi testtel.

1. Informazioni importanti da leggere prima dell'uso

Leggere attentamente le presenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il pallone rianimatore Ambu® SPUR® II. Le istruzioni per l'uso sono soggette ad aggiornamento senza preavviso. Copie della versione aggiornata sono disponibili su richiesta. Si sottolinea che queste istruzioni non spiegano né trattano le procedure cliniche. Descrivono esclusivamente il funzionamento di base e le precauzioni relative al funzionamento del pallone rianimatore. Per il primo utilizzo del pallone rianimatore, è essenziale che l'operatore abbia già ricevuto una formazione sufficiente nelle tecniche di rianimazione e abbia familiarità con uso previsto, avvertenze, avvisi e indicazioni contenuti nelle presenti istruzioni per l'uso. Il pallone rianimatore Ambu SPUR II non è coperto da garanzia.

1.1. Uso previsto

Ambu SPUR II è un pallone rianimatore monouso destinato alla rianimazione polmonare.

1.2. Indicazioni per l'uso

Il pallone rianimatore Ambu SPUR II è destinato all'uso in situazioni in cui è necessario un pallone rianimatore cardio-polmonare manuale per la ventilazione assistita.

Il pallone rianimatore Ambu SPUR II è indicato per la ventilazione e l'ossigenazione dei pazienti fino a quando non sia possibile stabilire una via aerea più definitiva o il paziente non si sia ripreso.

1.3. Popolazione di pazienti di destinazione

Il campo di applicazione per ciascuna versione è:

- **Adulti:** Adulti e bambini con peso superiore a 30 kg (66 lb).

- **Pediatrico:** Neonati e bambini con peso corporeo da 6 kg a 30 kg (13 – 66 lb).

- **Neonati:** Neonati e bambini molto piccoli con peso corporeo fino a 10 kg (22 lb).

Non tutte le configurazioni del pallone rianimatore Ambu SPUR II sono disponibili per tutte e tre le gamme di pazienti.

1.4. Utilizzatori previsti

Professionisti medici formati nella gestione delle vie aeree come anestesisti, infermieri, personale di soccorso e personale di emergenza.

1.5. Controindicazioni

Nessuna nota.

1.6. Vantaggi clinici

La tecnica di base di gestione delle vie aeree con pallone rianimatore manuale consente la ventilazione e l'ossigenazione dei pazienti fino a quando non è possibile stabilire una via aerea più definitiva o il paziente non si è ripreso.

1.7. Avvertenze e avvisi

Il mancato rispetto delle precauzioni può causare ventilazione e ossigenazione insufficienti del paziente o danni all'attrezzatura.

AVVERTENZE !

1. Per evitare il rischio di infezione non utilizzare il pallone rianimatore per più di 4 ore totali nell'arco di tempo massimo di 1 settimana.
2. Per evitare il rischio di infezione e malfunzionamento non riutilizzare il pallone rianimatore se all'interno del dispositivo sono presenti umidità o residui visibili.
3. Assicurarsi che la protezione antispruzzo o la valvola Ambu PEEP siano collegate alla porta respiratoria. Una porta respiratoria aperta può essere bloccata accidentalmente e causare un volume d'aria eccessivo nei polmoni che può causare traumi ai tessuti.
4. Evitare l'uso del pallone rianimatore in ambienti tossici o pericolosi per evitare il rischio di danni ai tessuti.

5. Assicurarsi sempre che il tubo del reservoir di ossigeno non sia ostruito, poiché il blocco del tubo può impedire il rigonfiaggio del pallone di compressione, con conseguente impossibilità di ventilazione.
6. Non utilizzare il prodotto se contaminato da fonti esterne poiché questo può causare infezioni.
7. Ispezionare sempre visivamente il prodotto ed eseguire un test di funzionalità dopo disimballaggio e montaggio e prima dell'uso, in quanto i difetti e i corpi estranei possono causare ventilazione assente o ridotta del paziente.
8. Non utilizzare il prodotto se non ha superato il test di funzionalità, poiché questo potrebbe causare ventilazione ridotta o assente del paziente.
9. Non escludere la valvola limitatrice di pressione se la valutazione medica non ne indica la necessità. Pressioni di ventilazione elevate possono causare barotrauma.
10. Dispositivo monouso. L'uso su altri pazienti può causare infezioni crociate.
11. Il farmaco non può essere somministrato attraverso MediPort se sono collegati accessori tra il pallone rianimatore e la maschera facciale (per es. filtro, rilevatore di CO₂).
12. Dopo l'uso non lasciare il MediPort aperto per evitare perdite che potrebbero ridurre l'erogazione di O₂ al paziente.
13. Non utilizzare il MediPort per il monitoraggio dell'EtCO₂ collaterale in pazienti ventilati con volume corrente inferiore a 400 ml per evitare misurazioni EtCO₂ non precise.
14. Quando si somministra un farmaco con un volume inferiore a 1 ml, è necessario lavare il MediPort per garantire un dosaggio preciso del farmaco.
15. Non collegare il tubo di alimentazione dell'ossigeno al Medi-port poiché la concentrazione di O₂ prevista non verrà erogata al paziente.
16. L'aggiunta di accessori può aumentare la resistenza inspiratoria e/o espiratoria. Non collegare accessori se l'incremento della resistenza respiratoria potrebbe essere dannoso per il paziente.
17. Destinato esclusivamente all'uso da parte di operatori che abbiano familiarità con il contenuto del presente manuale poiché un uso non corretto potrebbe danneggiare il paziente.
18. Quando si utilizza ossigeno supplementare, non fumare o utilizzare il dispositivo in prossimità di fiamme libere, olio, grasso, altre sostanze chimiche infiammabili o attrezzi e strumenti che possono causare scintille a causa del rischio di incendio e/o esplosione.
19. Non tentare di collegare una valvola a domanda alla versione per neonato, poiché questo può causare elevate concentrazioni di ossigeno che potrebbero essere dannose per il neonato.
20. Prestare attenzione ai segnali di ostruzione completa/parziale delle vie aeree superiori quando si utilizza il pallone rianimatore collegato a una maschera facciale poiché questo comporterà un'erogazione di ossigeno assente o limitata. Passare sempre a un'alternativa all'uso di una mascherina facciale per dirigere l'aria verso il paziente, se disponibile.
21. Non utilizzare il prodotto con la maschera facciale applicata durante la ventilazione di neonati con ernia diaframmatica congenita per evitare il rischio di insufflazione. Passare a un'alternativa all'uso della maschera facciale per dirigere l'aria verso il paziente, se disponibile.
22. I professionisti che eseguono la procedura devono valutare la scelta della misura del pallone rianimatore e degli accessori (per es. maschera facciale, valvola PEEP, etc.) in base alle condizioni specifiche del paziente poiché un uso non corretto può danneggiare il paziente.
23. Non utilizzare Ambu SPUR II quando è necessaria l'erogazione di ossigeno a flusso libero a causa di una possibile somministrazione insufficiente di ossigeno che può portare a ipossia.
24. Il tappo del manometro deve essere sempre posizionato sulla porta del manometro quando la pressione non viene monitorata per evitare perdite che possono portare a una riduzione dell'erogazione di O₂ al paziente.
25. Pre collegare sempre il tubo all'alimentazione di ossigeno a temperature superiori a 0 °C, poiché il montaggio può diventare difficile a temperature inferiori a 0 °C con conseguente riduzione dell'erogazione di ossigeno al paziente.
26. Quando si utilizza il pallone rianimatore con la maschera facciale attaccata, verificare il corretto posizionamento e la tenuta della maschera facciale poiché una tenuta non corretta può portare alla diffusione di malattie infettive aerodisperse all'utente.

AVVISI

1. Non riporre mai il rianimatore deformato o piegato in modo diverso da quello fornito dal produttore poiché potrebbe verificarsi una deformazione permanente che potrebbe ridurre la capacità di ventilazione. I punti di piegatura sono chiaramente visibili sul pallone (si possono ripiegare solo le versioni per adulto e pediatrica).
2. Verificare l'efficienza della ventilazione osservando il movimento del torace e ascoltando il flusso espiratorio che fuoriesce dalla valvola. Se non è possibile ottenere la ventilazione con il pallone rianimatore, passare immediatamente alla ventilazione bocca a bocca.
3. Non sterilizzare né detergere il dispositivo immersendolo nel liquido per evitare il rilascio di eventuali residui dannosi o malfunzionamenti dell'apparecchio. Il design e i materiali usati non sono compatibili con le procedure di detersione e sterilizzazione convenzionali.
4. Usare MediPort solo per misurazione con EtCO₂ o somministrazione di farmaci poiché i valori misurati potrebbero essere modificati.
5. Se applicabile, consultare la confezione degli accessori per informazioni più specifiche sui singoli accessori poiché una manipolazione errata può causare il malfunzionamento dell'intero prodotto.
6. L'uso di prodotti di terze parti e dispositivi di erogazione dell'ossigeno (per es. filtri e valvole a domanda) con il pallone rianimatore Ambu SPUR II può influire sulle prestazioni del prodotto. Consultare il produttore del dispositivo di terzi per verificare la compatibilità con il pallone rianimatore Ambu SPUR II e ottenere informazioni sulle possibili modifiche delle prestazioni.
7. Il reservoir di ossigeno è fissato in modo permanente alla valvola di ingresso sui palloni rianimatori per adulti e pediatrici, a eccezione delle versioni con valvola a richiesta. Non tentare di smontarlo. Non tirare il reservoir di ossigeno poiché questo potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo.

1.8. Potenziali eventi avversi

Potenziali eventi avversi correlati alla rianimazione (elenco non esaustivo): barotrauma, volutrauma, ipossia, ipercarbia e polmonite da aspirazione.

1.9. Note generali

Se durante o dopo l'utilizzo del dispositivo si verifica un incidente grave, comunicarlo al produttore e alle autorità nazionali.

2. Descrizione dispositivo

Il pallone rianimatore Ambu SPUR II può essere collegato al manometro di pressione monouso Ambu®, alle valvole Ambu® PEEP e alle maschere facciali Ambu® come descritto nella sezione 4.3 Funzionamento del pallone rianimatore.

3. Spiegazione dei simboli usati

Indicazione simbolo	Descrizione
	Adulto Massa corporea ideale prevista superiore a 30 kg
	Pediatrico Massa corporea ideale prevista da 6 a 30 kg
	Neonato Massa corporea ideale prevista fino a 10 kg

Indicazione simbolo	Descrizione
	Compatibilità RM condizionata
	Paese di produzione
	Dispositivo medico
	Monopaziente, multiuso
	Non tirare con forza il reservoir di ossigeno

L'elenco completo delle spiegazioni dei simboli è disponibile su
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Utilizzo del prodotto

4.1. Principio operativo

L'illustrazione ① mostra le miscele del flusso di gas di ventilazione nel pallone e da e verso il paziente durante il funzionamento manuale del pallone rianimatore. ①a Pallone rianimatore adulto e pediatrico, pallone rianimatore per ①b neonato con reservoir di ossigeno chiuso (sacca reservoir), pallone rianimatore per ①c neonato con tubo reservoir di ossigeno aperto (serbatoio tubo).

Il flusso di gas è simile a quello generato dalla respirazione spontanea del paziente attraverso il dispositivo.

Il reservoir di ossigeno è dotato di due valvole, una che consente all'aria ambiente di entrare quando il reservoir è vuoto e una che fa defluire l'ossigeno in eccesso quando il reservoir è pieno.

Il MediPort fornisce accesso al flusso di gas inspiratorio ed espiratorio permettendo di collegare una siringa per erogare farmaci ①d o una linea di campionamento gas per misurare EtCO₂ ①e collaterale.

①.1 Rilascio di ossigeno in eccesso, ①.2 ingresso aria, ①.3 ingresso ossigeno, ①.4 connettore paziente, ①.5 respirazione, ①.6 porta manometro, ①.7 valvola limitatrice di pressione, ①.8 MediPort.

NOTA: il collegamento a 1,5 può essere una protezione antispruzzo o una valvola PEEP.

4.2. Ispezione e preparazione

Il pallone rianimatore va disimballato e preparato (eseguendo anche un test della funzionalità) per l'uso immediato prima di essere utilizzato in situazioni di emergenza.

4.2.1. Preparazione

- Se il pallone rianimatore è stato confezionato nello stato compresso, dispiegarlo esercitando una trazione sulla valvola paziente e sulla valvola di ingresso.
- Preparare il pallone rianimatore e riporre tutti gli elementi nella borsa per il trasporto fornita con il pallone rianimatore.
- Se la maschera facciale fornita con il pallone rianimatore è avvolta in un sacchetto di protezione, rimuoverlo prima dell'uso.

Consultare la sezione 4.2.2. (Tubo dell'ossigeno) per la preparazione del dispositivo prima dell'uso a temperature inferiori a 0 °C.

4.2.2. Test funzionale 2

Pallone rianimatore

Chiudere la valvola limitatrice di pressione con la clip di esclusione e chiudere il connettore paziente con il pollice 2.1. Comprimere rapidamente il pallone. Il pallone rianimatore deve resistere alla compressione.

Aprire la valvola limitatrice di pressione sfilando la clip di esclusione e ripetendo la procedura. A questo punto la valvola limitatrice di pressione deve essere attivata e deve essere possibile udire il flusso dalla valvola durante la compressione rapida del pallone.

Comprimere e rilasciare il pallone rianimatore alcune volte per assicurarsi che l'aria circoli attraverso il sistema di valvole e fuoriesca dalla valvola paziente. 2.2

NOTA: Siccome le piastre delle valvole si muovono durante il test funzionale o durante la ventilazione, è normale sentire un lieve rumore. Che tuttavia non compromette la funzionalità del rianimatore.

Tubo ossigeno

Il montaggio del tubo dell'ossigeno e il test di funzionalità del reservoir di ossigeno e del tubo del reservoir di ossigeno devono essere eseguiti a temperature superiori a 0 °C. Per l'uso del pallone rianimatore a temperature inferiori a 0 °C, lasciare il tubo dell'ossigeno collegato all'alimentazione di ossigeno dopo il test di funzionalità.

Reservoir di ossigeno

Fornire un flusso di gas di 10 l/min al connettore di ingresso dell'ossigeno. Sostenere infine l'apertura manuale del pallone. Controllare che il reservoir di ossigeno si riempia. In caso contrario, controllare l'integrità degli otturatori delle due valvole o verificare che il reservoir di ossigeno non sia lacerato.

Regolare poi il flusso di gas fornito in base alle indicazioni mediche.

Tubo reservoir di ossigeno

Fornire un flusso di gas di 10 l/min al connettore di ingresso dell'ossigeno. Verificare che l'ossigeno fuoriesca dall'estremità del tubo del reservoir di ossigeno. In caso contrario, controllare che il tubo dell'ossigeno non sia ostruito. Regolare poi il flusso di gas fornito in base alle indicazioni mediche.

MediPort

Togliere il tappo del MediPort e bloccare il connettore lato paziente. Comprimere il pallone e verificare che si senta il rumore dell'aria che viene spinta fuori dal MediPort. 2.3

4.3. Funzionamento del pallone rianimatore

- Seguire le tecniche consigliate per liberare bocca e vie aeree del paziente e posizionare il paziente correttamente per aprire le vie aeree.
- Tenere saldamente la mascherina contro il viso del paziente. 3.1
- Infilare la mano (versione adulto) o l'anulare e il medio (versione pediatrica) sotto l'impugnatura. La versione per neonato non è dotata di impugnatura di supporto. La ventilazione senza l'uso dell'impugnatura di supporto può essere ottenuta ruotando il pallone. 3.2 Ventilazione del paziente: Osservare il sollevamento del torace durante l'insufflazione. Rilasciare il pallone improvvisamente, ascoltare il flusso di respirazione dalla valvola paziente e osservare l'abbassamento del torace.
- Se si incontra una resistenza continua all'insufflazione, controllare che le vie aeree non siano ostruite e riposizionare il paziente per assicurarsi che le vie aeree siano aperte.
- Se il paziente vomita durante la ventilazione, liberare immediatamente le vie aeree del paziente ed espellere il vomito dal pallone rianimatore scuotendolo e comprimendolo con forza e rapidità diverse volte prima di riprendere la ventilazione.
Se necessario, pulire il prodotto con un panno imbevuto di alcol e pulire la protezione antispruzzo con acqua.

Attacco per manometro

Il manometro di pressione monouso Ambu e il manometro di terze parti possono essere collegati alla porta del manometro situata sulla parte superiore della valvola paziente. Rimuovere il tappo e applicare il/i manometro/i

Sistema di limitazione della pressione 4

La valvola limitatrice di pressione è impostata per aprirsi a 40 cm H₂O (4,0 kPa). 4.1

Se la valutazione medica e professionale indica che è necessaria una pressione superiore a 40 cm H₂O, la valvola limitatrice di pressione può essere esclusa spostando la clip di esclusione sulla valvola. 4.2

In alternativa, è possibile escludere la valvola limitatrice di pressione posizionando un dito sul pulsante rosso mentre si comprime il pallone.

MediPort

Il pallone rianimatore Ambu SPUR II viene fornito con o senza MediPort. MediPort consente l'accesso al flusso di gas inspiratorio ed espiratorio e può essere utilizzato per l'applicazione di farmaci se collegato a una siringa, nonché per misurare il flusso laterale di CO₂ (EtCO₂). Quando non è in uso, chiudere MediPort con il tappo rosso.

Misurazione dell'EtCO₂

Per la misurazione del flusso laterale EtCO₂, collegare la linea di campionamento del gas per il dispositivo di misurazione EtCO₂ al MediPort del pallone rianimatore Ambu SPUR II. Collegare il connettore della linea di campionamento del gas montandolo e ruotandolo di 1/4 di giro in senso orario.

Somministrazione del farmaco

Monitorare attentamente la risposta del paziente al farmaco somministrato. La somministrazione di volumi di 1 ml di liquido o superiori tramite MediPort

equivale alla somministrazione diretta tramite tubo endotracheale. MediPort è stato testato con epinefrina, lidocaina e atropina.

Versione della valvola a domanda del pallone rianimatore Ambu SPUR II 5

La versione con valvola a domanda del pallone rianimatore Ambu SPUR II è disponibile nelle misure adulto e pediatrico, può essere utilizzata con o senza valvola a domanda ed è dotata di un reservoir di ossigeno collegabile.

La valvola di ingresso del pallone rianimatore Ambu SPUR II si collega alla valvola a domanda tramite un adattatore.

Montaggio della valvola a domanda:

- Rimuovere l'unità reservoir di ossigeno dalla valvola di ingresso del pallone rianimatore Ambu SPUR II, se collegata.
- Collegare l'adattatore al sistema con valvola a domanda.
- Inserire l'adattatore della valvola a domanda nella valvola di ingresso del pallone rianimatore Ambu SPUR II.

NOTA: Utilizzare solo componenti etichettati come "unità di compressione" con adattatore e valvola a domanda. La parte etichettata "Reservoir di ossigeno" è la riserva se la valvola a domanda non funziona.

Somministrazione d'ossigeno

Somministrare l'ossigeno secondo le indicazioni mediche.

La figura 6 mostra le percentuali calcolate di ossigeno erogato che possono essere ottenute con diversi volumi e frequenze di ventilazione a diverse portate di gas. Le percentuali di ossigeno possono essere visualizzate in 6 Adulto 6.1, Pediatrico 6.2, Neonato 6.3.

Reservoir di ossigeno 7

La pellicola sottile di plastica del reservoir di ossigeno non può mai essere staccata dal punto di fissaggio al pallone rianimatore.

Accessori 8

I connettori del pallone rianimatore Ambu SPUR II sono conformi alle norme ISO 5356-1 e EN 13544-2, pertanto sono conformi ad altre apparecchiature ospedaliere. In caso di collegamento di dispositivi esterni, assicurarsi di verificare le funzionalità e consultare le istruzioni per l'uso relative al dispositivo esterno.

I prodotti Ambu compatibili con il pallone rianimatore Ambu SPUR II sono i seguenti:

Maschera facciale monouso Ambu®

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l'uso della maschera facciale monouso Ambu.

Valvola monouso PEEP 20 Ambu® 8.1 8.2

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle istruzioni per l'uso della valvola monouso PEEP 20 Ambu o fare riferimento all'illustrazione 8.1 nelle presenti Istruzioni per l'uso. Per montare la valvola PEEP 20 monouso Ambu (se necessario) sul pallone rianimatore, rimuovere la protezione antispruzzo. 8.2

Manometro di pressione monouso Ambu® 8.3

Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l'uso del manometro di pressione monouso Ambu.

4.4. Dopo l'uso

I prodotti usati vanno smaltiti secondo le procedure locali.

5. Specifiche tecniche del prodotto

5.1. Norme applicabili

Il pallone rianimatore Ambu SPUR II è conforme allo standard specifico di prodotto EN ISO 10651-4.

5.2. Specifiche

	Neonato	Pediatrico	Adulto
Volume pallone rianimatore	circa 220 ml	circa 670 ml	circa 1510 ml
Volume fornito a una mano*	150 ml	450 ml	600 ml
Volume fornito a due mani*	-	-	1000 ml
Dimensioni (lunghezza x diametro) senza reservoir e accessori	circa 190 x 71 mm	circa 223 x 99 mm	circa 284 x 127 mm
Peso senza reservoir e accessori	circa 70 g	circa 145 g	circa 220 g
Valvola limitatrice di pressione**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Spazio morto	≤5 ml + 10% del volume fornito	≤5 ml + 10% del volume fornito	≤5 ml + 10% del volume fornito
Resistenza all'inspirazione***	max 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) at 5 l/min	max 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) a 50 l/min	max 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) a 50 l/min
Resistenza all'espirazione***	max 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) a 5 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) a 50 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) a 50 l/min
Volume reservoir	circa 300 ml (sacca) circa 100 ml (tubo)	circa 2600 ml (sacca)	circa 2600 ml (sacca)
Connettore paziente	Esterno 22 mm maschio (ISO 5356-1) Interno 15 mm femmina (ISO 5356-1)		
Connettore di espirazione (per attacco valvola PEEP)	Maschio 30 mm (ISO 5356-1)		
Connettore attacco per manometro	Ø 4,2 +/- 0,1 mm		

	Neonato	Pediatrico	Adulto
Connettore valvola a domanda	-	Interno femmina 32 mm (ISO 10651-4)	
Perdita lato anteriore e posteriore		Non misurabili	
MediPort		Connettore compatibile con EN ISO 80369-7	
Connettore di ingresso O ₂		Conformemente a EN 13544-2	
Limiti temperature di funzionamento	da -18 °C a +50 °C (da -0,4 °F a +122 °F), testati secondo EN ISO 10651-4		
Limiti temperatura di conservazione	da -40 °C a +60 °C (da -40 °F a +140 °F), testati secondo EN ISO 10651-4		
Conservazione a lungo termine consigliata in confezione chiusa a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare.			

* Testato in conformità alla norma EN ISO 10651-4.

** Per ottenere una pressione più elevata escludere la valvola limitatrice di pressione.

*** In condizioni generali di test secondo EN ISO 10651-4.



5.3. Informazioni sulla sicurezza in ambiente RM

Il pallone rianimatore Ambu SPUR II¹ e il pallone rianimatore Ambu SPUR II con valvola monouso Ambu PEEP 20 collegata², il pallone rianimatore Ambu SPUR II con valvola Ambu monouso PEEP 20 collegata e il manometro di pressione monouso Ambu² sono a compatibilità RM condizionata e pertanto possono essere utilizzati in sicurezza in ambiente RM (non all'interno del tunnel RM) nelle seguenti condizioni.

Campo magnetico statico pari o inferiore a 7 Tesla, con

- Gradiente di campo spaziale massimo di
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²

- Forza massima prodotto di
 - 450.000.000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G2/cm (721 T²/m)²

L'uso all'interno del tunnel RM può influire sulla qualità dell'immagine RM.

Il riscaldamento indotto da RF e gli artefatti delle immagini RM non sono stati testati. Tutte le parti metalliche sono completamente incapsulate e non entrano in contatto con il corpo umano.

1. 重要事項 – ご使用前に必ずお読みください

Ambu® 蘇生バッグSPUR® IIをご使用になる前に、以下の安全に関する注意事項を必ずお読みください。取扱説明書は予告なく修正されることがあります。最新版は製造販売業者から入手可能です。本書の記載事項は臨床的手技について説明、議論するものではありません。蘇生バッグのご使用に際しての基本的な操作方法と注意事項について記載しています。蘇生バッグを使用される方は、事前に十分な蘇生法のトレーニングを受け、本書に記載されている使用目的、警告、注意事項および適用症例について熟知していることが必要とされます。Ambu 蘇生バッグSPUR II には、保証は適用されません。

1.1. 使用目的

Ambu蘇生バッグSPUR II は、換気を目的とした一人の患者用の手動式肺人工蘇生器です。

1.2. 用途

Ambu蘇生バッグSPUR II は、心肺蘇生中の補助換気のために使用することを想定しています。

Ambu蘇生バッグSPUR II は、より確実な換気方法が確保できるまで、または患者が回復するまでの間、患者の換気と酸素化に使用します。

1.3. 対象となる症例

各サイズの適用範囲：

- 成人用：体重30 kg (66 lb)以上の成人および小児。
- 小児用：体重6 kg–30 kg (13 – 66 lb)の乳幼児および小児。
- 新生児用：体重10 kg (22 lb)未満の新生児および乳児。

各サイズのAmbu蘇生バッグSPUR IIが、3つの適用範囲のすべてに対して使用できることを保証するものではありません。

1.4. 想定される使用者

医師、看護師、救助隊員、救急隊員など、気道管理の訓練を受けた医療従事者。

1.5. 禁忌

既知の禁忌はありません。

1.6. 臨床的有益性

手動式蘇生バッグを用いた基本的な気道管理により、より確実な換気方法が確保できるまで、または患者が回復するまでの間、患者の換気と酸素化を行うことができます。

1.7. 警告および使用上の注意

以下の注意事項が守られない場合、患者の換気や酸素化が不十分になったり、機器が破損したりする可能性があります。

警告

1. 感染のリスクを避けるため、1週間に累積4時間以上蘇生バッグを使用しないでください。
2. 蘇生バッグの内部に目に見える水分や残留物が残っている場合は、感染や故障の恐れがあるため、再使用しないでください。
3. 呼気側コネクタにスプラッシュガードまたはAmbu PEEPバルブのいずれかが装着されている状態で使用してください。呼気側コネクタに何も接続されていない状態で使用した場合、誤って塞いでしまうことで、肺胞中のガス量が過剰となり、組織の損傷を起こす可能性があります。
4. 組織の損傷を防ぐため、有毒環境下または危険な環境下での蘇生バッグの使用は避けてください。

5. 酸素リザーバチューブの開放端が塞がれていないことを常に確認してください。開放端が塞がれた場合、バッグの再膨張が妨げられ、換気ができなくなる可能性があります。
6. 外的要因によって汚染されている場合は、使用しないでください。感染の原因となる可能性があります。
7. 開梱時・組立時および使用前には、必ず目視で点検し機能テストを行ってください。異常や異物により、換気ができない、あるいは換気量が低下することがあります。
8. 機能テストに合格しない場合は使用しないでください。換気ができない、あるいは換気量が低下することがあります。
9. 医学的に必要な場合を除き、圧制限弁バルブの作動を制限しないでください。過換気圧により圧損傷を引き起こす可能性があります。
10. 本品は単回使用品です。他の患者に使用した場合、交叉感染を引き起こす可能性があります。
11. 蘇生バッグとフェースマスクの間にアクセサリ（フィルタ、CO₂検出器など）が接続されている場合、Mポートから薬剤を投与することはできません。
12. 使用後は、Mポートを開いたままにしないでください。エアリークにより患者への酸素供給量が減少することがあります。
13. Mポートは、1回換気量が400 ml未満の場合にはサイドストリームEtCO₂モニタリングに使用しないでください。EtCO₂測定値が不正確になることがあります。
14. 薬剤投与量が1ml未満の場合は、適切な薬剤投与量を確保するために、Mポートからフラッシュしてください。
15. Mポートに酸素供給用チューブを接続しないでください。意図した患者への酸素濃度が得られなくなります。
16. アクセサリの追加により、吸気抵抗・呼気抵抗のいずれかまたは両方が増加する場合があります。呼吸抵抗の増大が患者に有害となる場合は、アクセサリを取り付けないでください。
17. この取扱説明書の内容を熟知した対象ユーザーのみが使用してください。誤った使い方をすると、患者に危害を及ぼすおそれがあります。
18. 酸素供給を行うときは、喫煙、裸火のそばでの使用、火花が生じる油、グリース、その他可燃性の化学物質・機器・工具の近くで使用しないでください。火災や爆発の危険があります。
19. 新生児用にはデマンドバルブを併用しないでください。高酸素濃度となり、新生児に有害となる可能性があります。
20. フェースマスクを併用する場合、完全／部分的上気道閉塞の徵候に注意してください。酸素供給ができない、あるいは制限される可能性があります。患者に直接空気を送るためにフェースマスクを使用する場合、可能な場合は常に代用法に切り替えてください。
21. 先天性横隔膜ヘルニアの乳児に換気する場合は、フェースマスクを併用して換気しないでください。気腹の危険があります。患者に直接空気を送るためにフェースマスクを使用する場合、可能な場合は常に代用法に切り替えてください。
22. 処置を行う医療従事者は、蘇生バッグのサイズおよびアクセサリ（フェースマスク、PEEPバルブなど）の選択を、患者の容態に従って評価する必要があります。誤った使用をすると、患者に有害である可能性があります。
23. フリーフロー療法に、Ambu蘇生バッグSPUR IIを使用しないでください。酸素供給が不十分となり、低酸素症を引き起こす可能性があります。
24. 気道内圧をモニターしないときは、必ずマノメータキャップをマノメータポートに装着してリークを防いでください。リークが発生すると酸素供給量が減少する可能性があります。
25. 酸素供給用チューブを酸素供給減に接続する際は、必ず0 °C以上の環境で接続してください。0 °C未満の環境では接続が困難となり、その結果患者への酸素供給量が減少する可能性があります。
26. フェースマスクを併用して蘇生バッグを使用する場合、マスクのポジショニングと密閉を正確にしてください。密閉が不十分である場合、換気施行者に空気感染症のおそれが生じます。

注意

- メーカー出荷時の折りたたまれた状態を除き、変形した状態で蘇生バッグを保管しないでください。バッグの恒久的な変形により換気効率が低下することがあります。折りたたみ可能な位置はバッグ上にはっきり確認することができます(成人用および小児用のみ)。
- 常に胸部の動きを目視にて観察し、患者バルブから呼気が流出する音を聞いて、換気状態を確認してください。蘇生バッグによる換気ができない場合は、ただちに口対口人工呼吸など他の方法に切り替えてください。
- 本品を浸したり、濯いだり、滅菌したりしないでください。有害物質が残留する、故障を引き起こすことがあります。本品の設計・材質は、従来の洗浄方法や滅菌には対応していません。
- Mポートは、EtCO₂測定または薬剤投与にのみ使用してください。測定値が変化する可能性があります。
- アクセサリ品を併用する場合は、各々の使用方法を確認してください。誤った取り扱いをした場合、本品自体の機能を損なう可能性があります。
- フィルタ、デマンドバルブなど他社製品を併用した場合、本品の機能に影響を与えることがあります。併用する他社製品については、本品との互換性・本品の機能への影響について各製造者に確認してください。
- デマンドバルブ接続可能モデル以外の成人用および小児用の酸素リザーババッグは取り外できません。本品を分解しないでください。酸素リザーババッグを引っ張らないでください。本品が正常に機能しなくなる場合があります。

1.8. 潜在的な有害事象

人工呼吸に関連する潜在的な有害事象(網羅的ではありません):圧損傷、量損傷、低酸素症、高炭酸ガス血症、誤嚥性肺炎。

1.9. 一般的な注意事項

本器の使用中、または使用の結果、重篤な事象が発生した場合は、製造販売元および政府当局に報告してください。

2. 本器について

Ambu 蘇生バッグ SPUR II は、「4.3 蘇生バッグの操作」に記載されているように、Ambu® マノメータ、Ambu® PEEPバルブ、Ambu® フェースマスクを接続して使用することができます。

3. 記号の説明

記号	説明
	成人用 対象患者体重は30 kg以上であることを示す
	小児用 対象患者体重は6 - 30 kgであることを示す
	新生児用 対象患者体重は10 kg未満であることを示す
	MRIには制限付きで対応

記号	説明
	製造国
	医療機器
	単回使用 (同一患者に対しては複数回の使用が可能)
	酸素リザーバーバッグを無理に引っ張らないでください。

記号を説明したリストは、<https://www.ambu.com/symbol-explanation>から入手できます。

4. 使用

4.1. 作動原理

図 1 は、蘇生バッグを操作した時の、バッグ内への混合換気ガスの流れ、および患者へのおよび患者からの混合換気ガスの流れを示しています。1a は成人用および小児用、1b は新生児用 (酸素リザーバーバッグ付)、1c は新生児用 (酸素リザーバチューブ付) を示しています。

ガスの流れは、患者が蘇生バッグを介して自発呼吸を行っている時も同様です。

酸素リザーバには2つのバルブがあり、1つはリザーバが空の時に外気を取り込み、もう1つは酸素リザーバーバッグが満杯の時に余剰酸素を排出するようになっています。

1d Mポートにシリンジを接続することにより、気管内に薬剤を投与できます。また、Mポートにサンプリングチューブを接続することにより、EtCO₂ 1e の測定が可能です。

1.1 余剰酸素を排出、1.2 大気の流入、1.3 酸素供給口、1.4 患者側コネクタ、1.5 呼気側コネクタ、1.6 マノメータポート、1.7 圧制限バルブ、1.8 Mポート

注意: 図中1.5の呼気側コネクタにはスプラッシュガードまたはPEEPバルブを接続します。

4.2. 点検と準備

蘇生バッグは、緊急時の使用に備えて、設置する前に予め開梱し、すぐに使えるように準備 (機能テストの実施を含む) しておく必要があります。

4.2.1. 使用準備

- 蘇生バッグが折りたたんだ状態で梱包されている場合、患者バルブとインレットバルブを引っ張って拡げてください。
- 蘇生バッグと使用時に必要となる物品をキャリングバッグに収納します。
- 付属のフェースマスクに保護用袋が被せられている場合は、使用前に取り外してください。

0 °C以下で使用する場合は、セクション4.2.2の酸素供給用チューブを参照してください。
(酸素チューブ) 0 °C以下で使用する前に、準備に使用します。

4.2.2. 機能テスト 2

蘇生バッグ

オーバーライドクリップで圧制限バルブを閉じ、親指で患者側コネクタを塞ぎます。2.1 バッグ部を勢いよく圧迫します。圧迫時に抵抗を感じるはずです。

オーバーライドクリップを解除して圧制限バルブが作動するようにして、上の手順を繰り返してください。圧制限バルブが作動し、バッグを勢いよく圧迫している間、圧制限バルブからガスがリークする音が聞こえるはずです。

バッグを数回圧迫したり圧迫を解除して、ガスが患者バルブのバルブシステムを通って、患者バルブから排出されることを確認します。 2.2

注意：機能テスト中や換気中にバルブディスクが動くと、わずかな音が聞こえることがあります。これによる蘇生バッグの機能への影響はありません。

酸素供給用チューブ

酸素供給用チューブの接続、酸素リザーババッグと酸素リザーバチューブの機能テストは、0°C以上の環境で行ってください。0°Cを以下の環境で蘇生バッグを使用する場合は、機能テスト後も酸素チューブを酸素供給源に接続したままにしてください。

酸素リザーババッグ

10 l/分で酸素を供給します。必要に応じ、手でバッグを広げてください。酸素リザーババッグが膨らむことを確認します。膨らまない場合は、2つのバルブディスクに異常がないか、または酸素リザーババッグが破れていないかを確認します。

その後、臨床的必要に応じて酸素の流量を設定してください。

酸素リザーバチューブ

10 l/分で酸素を供給します。酸素リザーバチューブの開放端から酸素が流出していることを確認します。もし流出していない場合、酸素リザーバチューブに閉塞がないかチェックします。その後、臨床的必要に応じて酸素の流量を設定してください。

Mポート

Mポートのキャップを外して、患者側コネクタを塞ぎます。バッグを圧迫し、Mポートからガスが流出する音が聞こえることを確認します。 2.3

4.3. 蘇生バッグの操作

- 推奨される方法で、気道を確保します。
- フェースマスクを患者の顔にしっかりと当てます。 3.1

- 手（成人用）または薬指と中指（小児用）をセフティストラップの下に滑り込ませます。新生児用にはセフティストラップはありません。バッグを回転させてセフティストラップを使用せずに換気操作を行うことができます。 3.2 換気：吸気時、胸部が上がる 것을觀察します。バッグを圧迫する手を素早く離し、患者バルブから呼気が流出する音を聞き、胸が下がることを目視で確認します。

- 吸気時に強い抵抗が続く場合は、気道が閉塞していないか確認し、気道を確保するために患者の体位を変換します。

- 患者が嘔吐した場合は、ただちに気道から嘔吐物を取り除き、換気を再開する前に、蘇生バッグを数回、強く、速く振ったり圧迫したりして、嘔吐物を取り除いてください。必要に応じて、アルコールを含ませた布で製品を拭き取り、スプラッシュガードを水で洗浄してください。

マノメータポート

Ambu社製マノメータあるいは他社製の気道内圧計を患者バルブ上部のマノメータポートに接続できます。キャップを外して、マノメータ／気道内圧計を取り付けます。

圧制限システム 4

圧制限バルブは、40 cm H₂O (4.0kPa)で開くように設定されています。 4.1

医師の判断により、40 cm H₂Oを超える圧が必要な場合、オーバーライドクリップを圧制限バルブ上にスライドさせることで、圧制限バルブの作動を制限することができます。 4.2

もう一つの方法として、バッグを圧迫する際に圧制限バルブの赤いボタン部分に指をかけることによって、圧制限バルブの作動を制限することができます。

Mポート

Ambu蘇生バッグSPUR IIには、Mポート付きとMポートなしが用意されています。Mポートにシリンジを接続することにより、気管内に薬剤を投与できます。また、Mポートにサンプリングチューブを接続することにより、EtCO₂の測定が可能です。使用しないときは、赤いキャップをしてMポートを閉じておきます。

EtCO₂の測定

EtCO₂モニタのガスサンプリングラインをMポートに接続して、サイドストリーム方式でEtCO₂の測定を行うことが可能です。ガスサンプリングラインのコネクタを接続し、時計回りに1/4回転させて固定します。

薬剤投与

投与した薬剤に対する患者の反応を注意深く観察してください。Mポートを介した1 ml以上の薬剤投与量は、気管内チューブに直接投与したに投与量に匹敵します。Mポートは、エビネフリン、リドカイン、アトロピンでテストを行っています。

デマンドバルブバージョン 5

デマンドバルブバージョンには、成人用と小児用があり、デマンドバルブの接続に関わらず使用可能で、接続可能な酸素リザーババッグが付属しています。

デマンドバルブは、アダプタを介してインレットバルブに接続します。

デマンドバルブの取り付け：

- 酸素リザーバが接続されている場合は、インレットバルブから取り外してください。
- デマンドバルブシステムにアダプタを取り付けます。
- アダプタを接続したデマンドバルブをインレットバルブに挿入します。

注意：「compression unit」のラベルが貼付されているパーツのみ使用してください。「Oxygen Reservoir Bag」のラベルが貼付されたパーツは、デマンドバルブが故障した場合のバックアップ用です。

酸素投与

医師の指示に従って、酸素流量を設定してください。

図 6 は、様々な酸素流量・換気量・換気回数の関係により得られる供給酸素濃度の計算値を示しています。図に示す酸素濃度は、成人用 6.1、小児用 6.1、新生児用 6.2のも

のです。**6.3**

酸素リザーババッグ 7

酸素リザーババッグは、蘇生バッグから取り外すことはできません。

アクセサリ 8

Ambu蘇生バッグSPUR II は、ISO 5356-1およびEN 13544-2に準拠したコネクタを装備しており、他の医療機器との互換性を確保しています。他の機器を併用する場合は、必ず動作確認を行い、使用される機器の取扱説明書を参照してください。

Ambu蘇生バッグSPUR IIで使用可能なAmbu製品は以下のとおりです。

Ambu® ディスピフェースマスク

詳細は、Ambu ディスピフェースマスクの取扱説明書を参照してください。

Ambu® ディスピPEEPバルブ 8.1 8.2

詳細は、Ambu ディスピPEEPバルブの取扱説明書を参照するか、または本書の図を参照してください。**8.1** Ambu ディスピPEEPバルブを使用する際は、スプラッシュガードを取り外して取り付けてください。**8.2**

Ambu® マノメータ 8.3

詳細は、Ambuマノメータの取扱説明書を参照してください。

4.4. 使用後

使用後は、お住いの地域における指定手順に従って廃棄してください。

5. 製品の技術仕様

5.1. 適用規格

Ambu蘇生バッグSPUR II は、EN ISO 10651-4規格に適合しています。

5.2. 仕様

	新生児用	小児用	成人用
蘇生バッグ容量	約 220 ml	約 670 ml	約 1510 ml
最大換気量*(片手操作時)	150 ml	450 ml	600 ml
最大換気量*(両手操作時)	-	-	1000 ml
寸法(長さ x 直径)酸素リザーバとアクセサリを除く	約 190 x 71 mm	約 223 x 99 mm	約 284 x 127 mm
重量酸素リザーバとアクセサリを除く	約70 g	約145 g	約220 g
圧制限バルブ**	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)
死腔	5ml+換気量の10%以下	5ml+換気量の10%以下	5ml+換気量の10%以下
吸気抵抗***	最大0.1 kPa (1.0 cm H ₂ O) (5 l/分時)	最大0.5 kPa (5.0 cm H ₂ O) (50 l/分時)	最大0.5 kPa (5.0 cm H ₂ O) (50 l/分時)
呼気抵抗***	最大0.2 kPa (2.0 cm H ₂ O) (5 l/分時)	最大0.27 kPa (2.7 cm H ₂ O) (50 l/分時)	最大0.27 kPa (2.7 cm H ₂ O) (50 l/分時)
リザーバ容量	約 300 ml(バッグ) 約100 ml (チューブ)	約 2600 ml(バッグ)	約 2600 ml(バッグ)
患者コネクタ	外径 22 mm オス (ISO 5356-1) 内径 15 mm メス (ISO 5356-1)		
呼吸側コネクタ (PEEP バルブを接続)	30 mm オス (ISO 5356-1)		
マノメータポート用コネクタ	Ø 4.2 +/- 0.1 mm		
デマンドバルブコネクタ	-	内径 32 mm メス (EN ISO 10651-4)	
前方および後方リーク	測定不可能		

	新生児用	小児用	成人用
Mポート	コネクタはEN ISO 80369-7に準拠		
O ₂ インレットコネクタ	EN 13544-2に準拠		
動作環境温度	-18 °C – +50 °C (-0.4 °F – +122 °F)、 EN ISO 10651-4に従ってテスト済み		
保管環境温度	-40 °C – +60 °C (-40 °F – +140 °F)、 EN ISO 10651-4に従ってテスト済み		
密封包装による長期保存時は、直射日光を避け室温での保存を推奨			

* EN ISO 10651-4に従って試験済み。

** 圧制限バルブの作動を制限ことで、より高い供給圧を得ることができます。

*** EN ISO 10651-4 による一般的な試験条件において。



5.3. MRI安全性情報

Ambu 蘇生バッグSPUR II単独¹、Ambu ディスピ²PEEPバルブを接続時²Ambu ディスピ²PEEPバルブと Ambuマノメータを接続時²は、条件付きでMRIに対応しています。以下の条件下のMRI環境 (MRI検査装置のボア内を除く) で安全に使用することができます。

7テスラ以下の静磁場

- 以下の最大空間磁場勾配
 - 10,000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16,000 G/cm (160 T/m)²
- 以下の最大磁力線
 - 450,000,000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721,000,000 G2/cm (721 T²/m)²

MRI検査装置のボア内の使用は、MRI画質に影響を与える可能性があります。

高周波誘導加熱とMRI画像のアーチファクトは検証されていません。金属部品はすべて完全に密閉されており、人体との接触はありません。

1. Svarbi informacija – Perskaitykite prieš naudodami

Prieš pradėdami naudoti „Ambu® SPUR® II“ gaivinimo aparatą, atidžiai perskaitykite šias saugos instrukcijas. Ši naudojimo instrukcija gali būti atnaujinama be papildomo įspėjimo. Pageidaujant galima gauti dabartinės versijos kopijas. Atkreipkite dėmesį, kad šioje instrukcijoje neaiškinamos ir neaptariamos klinikinės procedūros. Jose aprašyti tik pagrindinės operacijos ir atsargumo priemonės, susijusios su gaivinimo aparato veikimu. Prieš pirmą kartą naudojant gaivinimo aparatą, operatoriai turi būti tinkamai apmokyti atlikti atgaivinimo procedūras ir susipažinti su šiose instrukcijose pateiktą prietaiso paskirtimi, įspėjimais, atsargumo priemonėmis ir indikacijomis. „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato garantija neteikiama.

1.1. Numatytoji paskirtis

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatas yra vienam pacientui naudojamas prietaisas, skirtas plaučiams gaivinti.

1.2. Indikacijos

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatas skirtas naudoti tais atvejais, kai pagalbiniam ventiliavimui reikalingas rankinis kardiopulmoninis gaivinimo aparatas.

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatas skirtas pacientams ventiliuoti ir deguonimi aprūpinti, kol bus galima užtikrinti geresnį kvėpavimo takų valdymą arba kol pacientas atsigaus.

1.3. Numatytoji pacientų grupė

Kiekvienos versijos taikymo dydžių diapazonas:

– **Suaugusieji:** suaugusieji ir vaikai, kurių kūno svoris yra didesnis nei 30 kg (66 sv.).

– **Vaikai:** kūdikiai ir vaikai, kurių kūno svoris yra nuo 6 kg iki 30 kg (13 – 66 sv.).

– **Kūdikiai:** naujagimiai ir kūdikiai, kurių kūno svoris yra iki 10 kg (22 sv.).
Atkreipkite dėmesį, kad ne visų konfigūracijų „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatai tinkamai visoms trimis pacientų grupėms.

1.4. Numatytais naudotojas

Medicinos specialistams, apmokytiems atlikti procedūras kvėpavimo takuose, pvz., anesteziologams, slaugėms, gelbėtojams ir skubiosios pagalbos darbuotojams.

1.5. Kontraindikacijos

Nėra žinomos.

1.6. Klinikinė nauda

Pagrindinis kvėpavimo takų valdymo metodas naudojant gaivinimo aparatą leidžia ventiliuoti ir aprūpinti deguonimi pacientus, kol bus galima užtikrinti geresnį kvėpavimo takų valdymą arba kol pacientas atsigaus.

1.7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Nesilaikant šių atsargumo priemonių, pacientas gali būti nepakankamai ventiliuojamas ar aprūpinamas deguonimi arba galima sugadinti įrangą.

ISPĖJIMAI

1. Nenaudokite gaivinimo aparato ilgiau nei iš viso 4 valandas per 1 savaitę, kad išvengtumėte infekcijos rizikos.
2. Nenaudokite gaivinimo aparato pakartotinai, jeigu prietaiso viduje matosi drėgmė arba nuosėdos, kad išvengtumėte infekcijos rizikos ir veikimo trikių.
3. Įsitikinkite, kad prie iškvėpimo jungties prijungta apsauga nuo tiškalų arba „Ambu“ PEEP vožtuvas. Atvira iškvėpimo jungtis gali būti netycia užblokuota ir plaučiuose gali susikaupti perteklinis oro tūris, kuris gali traumuoti audinių.
4. Venkite naudoti gaivinimo aparatą toksikoje ar pavojingoje aplinkoje, kad išvengtumėte audinio pažeidimo pavojus.

5. Visuomet įsitikinkite, kad neužblokuotas deguonies talpyklos vamzdelis, nes dėl užblokuoto vamzdelio suspaudimo maišelis gali neišspūsti ir ventiliavimas nevyks.
6. Nenaudokite gaminio, jei jis užterštas išoriniaiš šaltiniai, nes tai gali sukelti infekciją.
7. Gaminj išpakavę, surinkę ir prieš naudodami visuomet jį apžiūrėkite, ar néra defektų ir pašalinių medžiagų, kurios gali blokuoti arba silpninti paciento ventiliavimą.
8. Nenaudokite gaminio, jeigu jis neišlaiko funkcionalumo bandymo, nes tuomet paciento plaučių ventiliavimas gali nevykti ar susilpnėti.
9. Niekada neišjunkite slėgį ribojančio vožtuvo, nebent medicininio ir profesinio įvertinimo metu nurodoma, kai tai yra būtina. Aukštas ventiliavimo slėgis gali sukelti barotraumą.
10. Skirta naudoti vieną kartą. Naudojimas kitiems pacientams gali sukelti kryžminę infekciją.
11. Vaistų negalima leisti per M jungtį, jeigu tarp gaivinimo aparato ir veido kaukės yra prijungti priedai (pvz., filtras, CO₂ detektorius).
12. Panaudojė nepalikite M jungties atviros, kad išvengtumėte protékio, dėl kurio gali susilpnėti O₂ tiekimas pacientui.
13. Siekiant išvengti EtCO₂ matavimų netikslumų, M jungties negalima naudoti pacientų šalutinio srauto EtCO₂ matuoti, jeigu jie ventiliuoja mažesniu negu 400 ml oro srautu.
14. Leidžiant mažiau nei 1 ml vaistų, M jungtį reikia praplauti, kad būtų suleista tiksliai vaistų dozė.
15. Prie M jungties nejunkite deguonies tiekimo vamzdelių, nes paciento nepasiekius numatytoji O₂ koncentracija.
16. Prijungus priedus gali padidėti įkvėpimo ir (ar) iškvėpimo pasipriešinimas. Priedų nejunkite, jeigu padidėjęs kvėpavimo pasipriešinimas gali kenkti pacientui.
17. Skirta naudoti tik tiems naudotojams, kurie susipažinę su šio vadovo turiniu, nes naudojant netinkamai galima pakenkti pacientui.
18. Jei naudojate pagalbinį deguonį, neleiskite rūkyti ar naudoti įrenginio šalia atviro ugnies, alyvos, tepalo, kitų degių cheminių medžiagų arba įrankių, kurie sukelia kibirkštis, dėl gaisro ir (arba) sprogimo pavojaus.
19. Nebandykite prijungti jokio vartojimo vožtuvo prie versijos kūdikiams, nes tai gali lemti didelę deguonies koncentraciją, kuri gali būti kenksminga naujagimiams.
20. Kai naudojate gaivinimo aparatą pritvirtintą prie veido kaukės, žinokite visiškos / dalinės viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijos požymius, dėl kurių deguonis gali būti netiekiamas arba tiekimas gali būti labai apribotas. Jei įmanoma, visuomet naudokite alternatyvias veido kaukei oro tiekimo pacientui priemones.
21. Dėl insufiliacijos pavojaus, nenaudokite gaminio su pritvirtinta veido kauke, kai ventiliuojate kūdikius su įgimta diafragmos išvarža. Jei įmanoma, naudokite alternatyvias veido kaukei oro tiekimo pacientui priemones.
22. Procedūrą atliekantys specialistai privalo įvertinti gaivinimo aparato ir priedų (pvz., veido kaukės, PEEP vožtuvo ir kt.) dydžio pasirinkimą, atsižvelgdami į konkretaus paciento būklę, nes netinkamas naudojimas gali pakenkti pacientui.
23. Nenaudokite „Ambu SPUR II“, kai dėl galimo nepakankamo deguonies tiekimo reikalingas laisvas deguonies srautas, kad nesukeltumėte hipoksijos.
24. Kai slėgis nestebimas, manometro dangtelis visuomet turi būti uždėtas ant manometro jungties, kad būtų išvengta protékij, dėl kurių sumažėtų O₂ tiekimas pacientui.
25. Visuomet iš ankosto prijunkite deguonies vamzdelį prie deguonies tiekimo šaltinio, kai temperatūra viršija 0 °C, nes žemesnėje nei 0 °C temperatūroje prijungti bus sudėtinga, todėl deguonies tiekimas pacientui gali susilpnėti.
26. Naudodami gaivinimo aparatą su prijunga veido kauke, užtirkinkite tinkamą veido kaukės padėtį ir sandarumą, nes dėl netinkamo sandarumo naudotojas gali užsikrėsti oru plintančiomis infekcinėmis ligomis.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

1. Gaivinimo aparato niekuomet nelaikykite sulankstyto kitaip, nei kad buvo pristatytas gamintojo, nes priešingu atveju jis deformuosis ir gali sumažėti ventiliavimo veiksmingumas. Maišelio sulenkimo sritis yra aiškiai matoma (sulankstyti galima tik suaugusiujų ir vaikų gaivinimo aparatu modelius).
2. Norédami patikrinti ventiliavimo veikimą, visada stebékite krūtinės ląstos judėjimą ir klausykitės iškvėpimo srauto iš paciento vožtuvo. Jei gaivinimo aparatu neįmanoma pasiekti veiksmingo ventiliavimo, nedelsiant pereikite prie gaivinimo burna į burną.
3. Prietaiso nemirkykite, neskalauskite ir nesterilizuokite, kadangi dėl šių procedūrų gali likti kenksmingų nuosėdų arba prietaisas gali sugesti. Prietaiso konstrukcija ir medžiagos nepritaikytos įprastoms valymo ir sterilizavimo procedūroms.
4. M jungtį naudokite tik vienai iš dviejų procedūrų: EtCO₂ matuoti arba vaistams leisti, nes tai gali pakeisti išmatuotas reikšmes.
5. Jeigu taikytina, prašome patikrinti priedų pakuotes dėl konkrečios informacijos apie atskirus priedus, nes naudojant netinkamai, gali netinkamai veikti visas gaminys.
6. Trečiosios šalies gaminų ir deguonies tiekimo įrenginių (pvz., filtrų ir vartojimo vožtuvų) naudojimas su „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatu gali turėti įtakos gaminio našumui. Norédami išsitikinti suderinamumu su „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatu ir gauti informacijos apie galimus našumo pokyčius, kreipkitės į trečiosios šalies įrenginio gamintoją.
7. Deguonies talpyklos maišelis nuolatine jungtimi prijungtas prie suaugusiujų ir vaikų gaivinimo aparatu įleidimo vožtuvo. Nebandykite nuimti. Netraukite deguonies talpyklos maišelio, nes galite sugadinti prietaisą.

1.8. Galimi nepageidaujami reiškiniai

Galimi nepageidaujami reiškiniai, susiję su atgaivinimu (sąrašas nėra baigtinis): barotrauma, volutrauma, hipoksija, hiperkarbija ir aspiracinė pneumonija.

1.9. Bendrosios pastabos

Jeigu šios priemonės naudojimo metu ar dėl šios priemonės naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir savo šalies atsakingajai institucijai.

2. Priemonės aprašymas

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatą galima prijungti prie „Ambu®“ vienkartinis slėgio manometro, Ambu® PEEP vožtuvų ir „Ambu®“ veido kaukių, kaip aprašyta 4.3 skyriuje „Gaivinimo aparato naudojimas“.

3. Naudojamų simbolių paaškinimas

Simboliai	Apaščias
	Suaugusiujų Numatytais idealus kūno svoris didesnis nei 30 kg
	Vaikų Numatytais idealus kūno svoris nuo 6 iki 30 kg
	Kūdikių Numatytais idealus kūno svoris iki 10 kg
	MR sąlyginai saugus

Simboliai	Aprašas
	Gamintojo šalis
	Medicinos priemonė
	Naudoti vienam pacientui keliis kartus
	Netraukite deguonies talpyklos maišelio naudodami jégą

Išsamų simbolių paaiškinimų sąrašą galite rasti adresu
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>.

4. Gaminio naudojimas

4.1. Veikimo principas

1 pav. parodyta, kaip ventilavimo duju mišinys įteka į maišelį, į pacientą ir iš jo plaučių rankinio gaivinimo aparato valdymo metu. **1a** Suaugusiuųjų ir vaikų gaivinimo aparatas, **1b** kūdikių gaivinimo aparatas su uždara deguonies talpykla (pūslė), **1c** kūdikių gaivinimo aparatas su atvira deguonies talpykla (vamzdeliu).

Dujų srautas panašus į tą, kai pacientas savaime kvépuoja per aparatą.

Deguonies talpykloje yra du vožtuva: per vieną įtraukiamas aplinkos oras, kai talpykla tuščia, o per kitą išeina perteklinis deguonis, kai deguonies talpykla yra pilna.

Per M jungtį galima pasiekti įkvėpimo ir iškvėpimo duju srautus, pvz., galima prijungti švirkštą ir išvirkšti vaistų **1d** arba prijungti duju mėginių įleidimo liniją ir išmatuoti šalutinio srauto EtCO₂ **1e**.

1.1 Deguonies pertekliaus išleidimas, **1.2** įleidimas, **1.3** deguonies įleidimas, **1.4** paciento jungtis, **1.5** iškvėimas, **1.6** manometro jungtis, **1.7** slėgio ribojimo vožtuvas, **1.8** M jungtis.

PASTABA: priedas prie 1.5 gali būti apsauga nuo tiškalų arba PEEP vožtuvas.

4.2. Patikrinimas ir paruošimas

Gaivinimo aparatą reikia išpakuoti ir paruošti (išskaitant funkcinio testo atlikimą), kad būtų galima iš karto naudoti kritiniais atvejais.

4.2.1. Paruošimas

- Jeigu gaivinimo aparatas supakuotas suspaustas, ištraukite suėmę už paciento ir įleidimo vožtvų.
- Paruoškite gaivinimo aparatą ir visas dalis įdékite į nešimo maišelį iš gaivinimo aparato komplekto.
- Jei kartu su gaivinimo aparatu pateikta veido kaukė yra suvyniota į apsauginį maišelį, prieš naudojant ją reikia nuimti.

Žr. 4.2.2 skyrių. (Deguonies vamzdelis) skirtas paruošti įrenginį prieš naudojant žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.

4.2.2. Veikimo tikrinimas **2**

Gaivinimo aparatas

Uždarykite slėgį ribojantį vožtvą reguliavimo gnybtu ir užspauskite paciento jungtį nykštū **2.1**. Stipriai spustelėkite pūslę. Turite jausti gaivinimo aparato pasipriešinimą suspaudimui.

Atverkite slėgi ribojantį vožtuvą nutraukdami reguliavimo gnybtą ir pakartodami šią procedūrą. Dabar slėgio ribojimo vožtuvas turi įsi Jungti ir, staigiai suspaudžiant pūslę, iš jo gali pasigirsti srauto iš vožtovo garsas.

Kelis kartus suspauskite ir atleiskite gaivinimo aparato pūslę, kad patikrintumėte, ar oras juda pro vožtuvu sistemą ir išeina pro paciento vožtuvą. **2.2**

PASTABA. Veikimo tikrinimo arba ventiliavimo metu vožtuvų diskai juda, todėl gali būti girdimas silpnas šio judėjimo garsas. Tai nereiškia, kad gaivinimo aparatas blogai veikia.

Deguonies vamzdelis

Montuoti deguonies vamzdelį ir tikrinti deguonies talpyklos ir deguonies talpyklos vamzdelio veikimą reikia aukštesnėje nei 0 °C temperatūroje. Jei norite naudoti gaivinimo aparatą žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, patikrinę veikimą, palikite deguonies vamzdelį prijungtą prie deguonies tiekimo.

Deguonies talpyklos maišelis

I deguonies tiekimo jungtį dujas tiekite 10 l/min. greičiu. Galiausiai padékite maišeliui išsiskleisti ranka. Patirkinkite, ar užsipildo deguonies talpyklos maišelis. Jei taip nėra, patirkinkite, ar nepažeisti du vožtovo uždoriai ir ar nejplyšusi pati deguonies talpykla.

Paskui sureguliukite tiekiamų duju srautą pagal medicinines indikacijas.

Deguonies talpyklos vamzdelis

I deguonies tiekimo jungtį dujas tiekite 10 l/min. greičiu. Patirkinkite, ar deguonis išeina pro deguonies talpyklos vamzdelio galą. Jei taip nėra, patirkinkite, ar deguonies vamzdelis neužsikimšęs. Paskui sureguliukite tiekiamų duju srautą pagal medicinines indikacijas.

M jungtis

Nuimkite M jungties dangtelį ir užkimškite paciento jungtį. Suspauskite pūslę ir klausykites, kaip iš M jungties išeina suspaustas oras. **2.3**

4.3. Gaivinimo aparato naudojimas

- Taikydami rekomenduojamus būdus išvalykite paciento burną ir oro takus, nustatykite tinkamą paciento padėtį, kad atvertumėte oro taką.
- Tvirtai laikykite veido kaukę prie paciento veido. **3.1**
- Pakiškite ranką (suaugusiuoju gaivinimo aparato versijoje) arba bevardį ir didžiųjų pirštą (vaikų gaivinimo aparato versijoje) po rankena. Kūdikių gaivinimo aparato versijoje rankenos nėra. Ventiliuoti nenaudojant rankenos galima sukant pūslę. **3.2** Paciento ventiliavimas I pūsdami stebékite krūtinės pakilimą. Staigiai atleiskite pūslę laikančią ranką ir klausykite, ar išteka srautas per paciento vožtuvą ir vizualiai nusileidžia krūtinės ląsta.
- Jei juntamas nuolatinis pasipriešinimas įpūtimui, patirkinkite, ar neužblokuoti kvėpavimo takai ir pakeiskite paciento padėtį, kad būtų kvėpavimo takai būtų atviri.
- Jeigu ventiliuojant pacientas vemiai; nedelsdami išvalykite paciento kvėpavimo takus ir, prieš tēsdami ventiliavimą, išvalykite vemalus iš gaivinimo aparato kelis kartus stipriai ir staigiai jį pakratydamai ir suspaudsdami.
Jeigu reikia gaminį nuvalykite audiniu su alkoholiu ir nuplaukite apsaugą nuo tiškalų vandeniu.

Manometro jungtis

Prie manometro jungties ant paciento vožtovo viršaus galima prijungti „Ambu“ vienkartinių slėgio matuoklį bei trečiosios šalies slėgio matuoklį. Nuimkite dangtelį ir prijunkite manometrą / slėgio matuoklį

Slėgi ribojanti sistema **4**

Slėgi ribojantis vožtuvas nustatytas taip, kad atsidarytų esant 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Jeigu, ivertinus medicininiu ir specialisto požiūriu nusprendžiama, kad reikia aukštesnio nei 40 cm H₂O slėgio, slėgio ribojimo vožtuvą galima atjungti ant vožtovo užspaudžiant atjungimo spaustuką. **4.2**

Be to, slėgio ribojimo vožtuva galima atjungti pirštą ant raudono mygtuko pūslės spaudimo metu.

M jungtis

„Ambu SPUR II“ gaivinimo apartas gaminamas su M jungtimi arba be jos. M jungtis užtikrina prieigą prie įkvėpimo ir iškvėpimo dujų srauto ir gali būti naudojama leidžiant vaistus, prijungus švirkštą, ir matuojant šalutinio srauto CO₂ (EtCO₂). Kai nenaudojama, nepamirškite uždaryti M jungties raudonu M jungties dangteliu.

EtCO₂ matavimas

Matuodami šalutinį srautą EtCO₂, EtCO₂ matavimo prietaiso dujų mēginių ēmimo liniją prijunkite prie „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato M jungties. Prijunkite dujų mēginių ēmimo linijos jungtį, sumontuodami ir pasukdami ją 1/4 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę.

Vaistų įšvirkštimas

Afidžiai stebékite paciento reakciją į įleidžiamą vaistą. 1 ml arba didesnio tūrio skysčio įleidimas per M jungtį yra tolygus įšvirkštimui tiesiai į endotrachējinį vamzdelį. M jungtis yra išbandyta leidžiant epinefriną, lidokainą ir atropiną.

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato vartojojimo vožtuvo versija 5

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato vartojojimo vožtuvo versija siūloma suaugusioje ir pediatrinio dydžio ir gali būti naudojama su vartojojimo vožtuvu arba be jo bei pateikiama su prijungiamu deguonies talpyklos maišeliu.

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato įleidimo vožtuvas jungiamas prie vartojojimo vožtuvo per adapterį.

Vartojojimo vožtuvo prijungimas:

- Jeigu prijungtas, atjunkite deguonies talpyklos bloką nuo „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato įleidimo vožtuvo.
- Prijunkite adapterį prie vartojojimo vožtuvo sistemos.
- Istatykite vartojojimo vožtuvo adapterį į „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato įleidimo vožtuvą.

PASTABA. Naudokite tik „compression unit“ (suspaudimo dalis) pažymėtą dalį su adapteriu ir vartojojimo vožtuvu. Si dalis pažymėta „Oxygen Reservoir Bag“ (deguonies talpyklos maišelis) laikoma atsargine vartojojimo vožtuvas gedimo atveju.

Deguonies padavimas

Deguonies kiekį nustatykite pagal medicinines indikacijas.

6 pav. parodytos apskaičiuotos deguonies procentinio kieko vertės, kurias galima gauti naudojant skirtingus ventiliavimo tūrius ir dažnius su skirtingais dujų srauto greičiais. Galima peržiūrėti 6 suaugusiuju 6.1, vaikų 6.2 ir kūdikių 6.3 deguonies procentinius kiekius.

Deguonies talpyklos maišelis 7

Plonus deguonies talpyklos maišelio plastikinės plėvelės negalima bet kada nuimti nuo jos tvirtinimo prie gaivinimo aparato vietas.

Priedai 8

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparato jungtys atitinka ISO 5356-1 ir EN 13544-2, todėl atitinka kitos ligoninės įrangos reikalavimus. Jei naudojate išorinius prietaisus, patikrinkite veikimą ir žr. išorinio įrenginio naudojimo instrukcijas.

Su „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatu suderinami „Ambu“ gaminiai išvardyti toliau:

„Ambu®“ vienkartinė veido kaukė

Išsamesnę informaciją rasite vienkartinio „Ambu“ vienkartinės veido kaukės naudojimo instrukcijose.

„Ambu®“ vienkartinis PEEP 20 vožtuvas 8.1 8.2

Išsamesnę informaciją rasite vienkartinio „Ambu“ vienkartinio PEEP 20 vožtuvo naudojimo instrukcijose arba žr. iliustraciją 8.1 šioje naudojimo instrukcijoje. Norint pritvirtinti „Ambu“ vienkartinį PEEP 20 vožtuvą (jei būtina) prie gaivinimo aparato, nuimkite apsaugą nuo tiškalų. 8.2

„Ambu®“ vienkartinis slėgio manometras 8.3

Išsamesnę informaciją rasite vienkartinio „Ambu“ slėgio manometro naudojimo instrukcijose.

4.4. Panaudojus

Panaudoti gaminiai turi būti šalinami pagal vietines procedūras.

5. Techninės gaminio specifikacijos

5.1. Taikomi standartai

„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatas atitinka tokiems gaminiams skirto standarto EN ISO 10651-4 reikalavimus.

5.2. Specifikacijos

	Kūdikių	Vaikų	Suaugusiųjų
Gaivinimo aparato tūris:	apie 220 ml	apie 670 ml	apie 1510 ml
Suspaidimo viena ranka takto tūris*:	150 ml	450 ml	600 ml
Suspaidimo dviem rankomis takto tūris*:	-	-	1000 ml
Matmenys (ilgis x skersmuo) be talpyklos ir priedo	apie 190 x 71 mm	apie 223 x 99 mm	apie 284 x 127 mm
Svoris be talpyklos ir priedo	apie 70 g	apie 145 g	apie 220 g
Slėgi ribojantis vožtuvas**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Perteklinis tūris	≤ 5 ml + 10 % tiekiamo tūrio	≤ 5 ml + 10 % tiekamo tūrio	≤ 5 ml + 10 % tiekamo tūrio

	Kūdikių	Vaikų	Suaugusiųjų
Ikvėpimo pasipriešinimas***	daugiausia 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) esant 5 l/min	iki 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) esant 50 l/min	daugiausia 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) esant 50 l/min
Iškvėpimo pasipriešinimas***	daugiausia 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) esant 5 l/min	iki 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) esant 50 l/min	daugiausia 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) esant 50 l/min
Pūslės tūris	apie 300 ml (maišelis) apie 100 ml (vamzdelis)	apie 2600 ml (maišelis)	apie 2600 ml (maišelis)
Paciento jungtis		22 mm išorinis sriegis (ISO 5356-1) 15 mm vidinis sriegis (ISO 5356-1)	
Iškvėpimo jungtis (PEEP vožtuvui prijungti)		30 mm išorinis sriegis (ISO 5356-1)	
Manometro jungtis		Ø 4,2 +/- 0,1 mm	
Vartojimo vožtuvo jungtis	-	32 mm vidinis sriegis (EN ISO 10651-4)	
Nuotekis į priekį ir atgal		neišmatuojamas	
M jungtis		Jungtis suderinama su EN ISO 80369-7	
O ₂ ijeidimo jungtis		Pagal EN 13544-2	
Darbinės temperatūros ribos		nuo -18 °C iki +50 °C (nuo -0,4 °F iki +122 °F), išbandyta pagal EN ISO 10651-4	
Laikymo temperatūros ribos		nuo -40 °C iki +60 °C (nuo -40 °F iki +140 °F), išbandyta pagal EN ISO 10651-4	
Ilgalaikiam laikymui rekomenduojama laikyti uždarote pakuočėje kambario temperatūroje, apsaugotoje nuo saulės spindulių.			

* Išbandyta pagal EN ISO 10651-4.

** Didesnį tiekimo slėgį galima pasiekti rankiniu būdu atjungiant slėgį ribojantį vožtuvą.

*** Bendrojo bandymo sąlygos pagal EN ISO 10651-4.

5.3. MRT saugos informacija



„Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatas¹, „Ambu SPUR II“ gaivinimo aparatas su prijungtu „Ambu“ vienkartiniu PEEP 20 vožtuvu² ir „Ambu SPUR II“gaivinimo aparatas su prijungtu „Ambu“ vienkartiniu PEEP 20 vožtuvu ir „Ambu“ vienkartiniu slėgio manometru² yra MR sąlyginai saugūs, todėl gali būti saugiau naudojami MR aplinkoje (ne MR angoje) toliau nurodytomis sąlygomis.

7 ir mažiau tesla vienetų statinis magnetinis laukas su

- Didžiausias magnetinio lauko erdvinis gradientas
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Maksimali gaminio galia
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Naudojant MR angoje gali turėti įtakos MR vaizdo kokybei.

RD indukcinės šilumos ir MR vaizdo artefaktai nebuvo tikrinti. Visos metalinės dalys visiškai supaketuotos ir neturi jokio sąlyčio su žmogaus kūnu.

1. Svarīga informācija – Izlasīt pirms lietošanas

Pirms Ambu® SPUR® II Resuscitator lietošanas rūpigi izlasiet šīs drošības instrukcijas. Lietošanas instrukcijas var tikt atjauninātas bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs redakcijas kopijas ir pieejamas pēc pieprasījuma. Nemiet vērā, ka šajās instrukcijās netiek paskaidrotas vai apspriestas kliniskās procedūras. Tās apraksta tikai pamata izmantošanu un piesardzības pasākumus, kas attiecas uz elpināšanas maisa izmantošanu. Pirms elpināšanas maisa izmantošanas ir svarīgi, lai operatori būtu pilnībā apguvuši kliniskās elpināšanas metodes un pārzinātu šajā lietošanas instrukcijā aprakstīto paredzēto izmantojumu, brīdinājumus, piesardzības pasākumus un kontrindikācijas. Izstrādājumam Ambu SPUR II Resuscitator netiek sniegtā garantija.

1.1. Paredzētā lietošana

Ambu SPUR II Resuscitator ir vienam pacientam lietojams elpināšanas maisis, kas paredzēts plaušu ventilācijai.

1.2. Lietošanas indikācijas

Izstrādājumu Ambu SPUR II Resuscitator paredzēts lietot situācijās, kad mākslīgajai elpināšanai ir nepieciešams manuāls sirds-plaušu elpināšanas maisis.

Ambu SPUR II Resuscitator ir paredzēts pacientu elpināšanai un oksigenācijai, līdz tiek noteikts precīzāks elpcēļš vai pacients atvesejojas.

1.3. Paredzētā pacientu populācija

Katras versijas lietojuma iespējas:

– **Pieaugušajiem:** Pieaugušajiem un bērniem ar ķermeņa masu virs 30 kg (66 lbs).

– **Bērniem:** Zīdaiņiem un bērniem ar ķermeņa masu no 6 kg līdz 30 kg (13–66 lb).

– **Zīdaiņiem:** Jaundzimušajiem un zīdaiņiem ar ķermeņa masu līdz 10 kg (22 lb).

Nemiet vērā, ka Ambu SPUR II Resuscitator konfigurācijas ir pieejamas visiem trim pacientu diapazoniem.

1.4. Paredzētais lietotājs

Elpcēļu kontrolei apmācīti speciālisti, piemēram, anesteziologi, medmāsas, glābšanas personāls un ārkārtas gadījumu personāls.

1.5. Kontrindikācijas

Nav zināmas.

1.6. Kliniskie ieguvumi

Pamata elpcēļu pārvaldības tehnika, izmantojot manuālu elpināšanas maisu, ir paredzēta pacientu elpināšanai un oksigenācijai, līdz tiek noteikts precīzāks elpcēļš vai pacients atvesejojas.

1.7. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ja netiek ievēroti šie piesardzības pasākumi, iespējama neefektīva pacienta elpināšana un oksigenācija vai aprikojuma bojājums.

BRĪDINĀJUMI

1. Nelietojiet elpināšanas maisu ilgāk par 4 stundām maksimāli 1 nedēļas laikā, lai izvairītos no inficēšanās riska.
2. Nelietojiet atkārtoti elpināšanas maisu, ja ierīcē ir redzams mitrums vai nogulsnes, lai izvairītos no inficēšanās un nepareizas darbibas riska.
3. Gādājiet, lai pie izelpas pieslēgvietas būtu piestiprināts izšķakstišanās aizsargs vai Ambu PEEP Valve. Atvērtu izelpas pieslēgvietu var nejauši nosprostot, kā rezultātā plaušās var rasties pārmērīgs gaisa tilpums, kas var novest pie audu bojājumiem.
4. Izvairieties no elpināšanas toksiskā vai bīstamā vidē, lai izvairītos no audu bojājumu riska.

5. Vienmēr pārliecinieties, vai skābekļa rezervuāra caurulīte nav aizsprostota, jo aizsprostota caurulīte var neļaut saspiešanas maisam no jauna piepūsties, kā rezultātā elpināšana var nenotikt.
6. Nelietojet izstrādājumu, ja tas ir piesārņots ārējo avotu dēļ, jo tā var rasties infekcija.
7. Pēc izņemšanas no iepakojuma, sakomplektēšanas un pirms lietošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet izstrādājumu, jo defekti un svešķermeņi var apturēt elpināšanu vai to samazināt.
8. Nelietojet izstrādājumu, ja funkcionalitātes pārbaude nav izdevusies, jo tas var apturēt elpināšanu vai to samazināt.
9. Neizolējiet spiedienu ierobežojošo vārstu, izņemot gadījumus, kad medicīniskais vērtējums liecina, ka tas ir nepieciešams. Augsts elpināšanas spiediens var izraisīt barotraumu.
10. Tikai vienreizējai lietošanai. Lietošana citiem pacientiem var izraisīt krustenisku inficēšanos.
11. Zāles nevar ievadīt, izmantojot M pieslēgvietu, ja paligrīki (piem., filtrs, CO₂ detektors) ir pievienoti starp elpināšanas masku un sejas masku.
12. Pēc lietošanas neatstājiet M pieslēgvietu atvērtu, lai izvairītos no noplūdes, kas var izraisīt samazinātu O₂ piegādi pacientam.
13. M pieslēgvietu nedrīkst izmantot EtCO₂ uzraudzībai sānu atzarā pacientiem, kam elpināšana tiek veikta ar elpināšanas tilpumu, kas ir mazāks par 400 ml, lai izvairītos no nepareiziem EtCO₂ mērijumiem.
14. Ievadot zāles ar tilpumu zem 1 ml, ir jāizskalo M pieslēgvjeta, lai nodrošinātu pareizu piegādāto zālu devu.
15. Nepievienojet skābekļa padeves cauruli M pieslēgvietai, jo citādi pacientam netiks piegādāta paredzētā O₂ koncentrācija.
16. Paligrīku pievienošana var palielināt pretestību ieelpai un/vai izelpai. Nepievienojet paligrīkus, ja palielinātā pretestība elpošanai varētu kaitēt pacientam.
17. Drikst izmantot tikai lietotāji, kas ir iepazinušies ar šīs rokasgrāmatas saturu, jo neatbilstoša lietošana var kaitēt pacientam.
18. Izmantojot papildu skābekli, neļaujiet smēķēt vai izmantot ierīci atklātas liesmas, eļļas, tauku, citu uzliesmojošu ķīmisko vielu vai dzirksteles izraisoša aprīkojuma un instrumentu tuvumā, jo pastāv aizdegšanās un/vai sprādziena risks.
19. Nemēģiniet pievienot gaisa padeves regulēšanas vārstu pie zidaiņiem paredzētās versijas, jo var rasties augsta skābekļa koncentrācija, kas var būt kaitīga jaundzimušajiem.
20. Izmantojot sejas maskai piestiprinātu elpināšanas maisu, vērojet, vai nav pilnīgu/daļēju augšējo elpcelu nosprostošanās pazīmju, jo citādi var tikt pārtraukta vai ierobežota skābekļa padeve. Ja pieejams, vienmēr pārejiet uz alternatīvu tā vietā, lai izmantotu sejas masku gaisa novirzišanai pacientam.
21. Nelietojet izstrādājumu ar piestiprinātu sejas masku, elpinot zīdaiņus ar iedzimtu diafragmas trūci, jo var rasties insuflācijas risks. Ja pieejams, pārejiet uz alternatīvu tā vietā, lai izmantotu sejas masku gaisa novirzišanai pacientam.
22. Profesionāliem, kas veic procedūru, jānovērtē elpināšanas maisa izmēra un paligrīku (piem., sejas maskas, PEEP vārsta u.c.) izvēle saskaņā ar pacienta konkrēto stāvokli, jo nepareiza lietošana var kaitēt pacientam.
23. Neizmantojiet Ambu SPUR II, ja ir nepieciešama brīvplūsmas skābekļa padeve iespējamas nepietiekamas skābekļa padeves dēļ, kas var izraisīt hipoksiju.
24. Ja spiediens netiek uzraudzīts, manometra vāciņam vienmēr jābūt uzliktam uz manometra pieslēgvietas, lai izvairītos no noplūdes, kas var izraisīt samazinātu O₂ piegādi pacientam.
25. Vienmēr iepriekš piestipriniet skābekļa caurulīti pie skābekļa padeves, ja temperatūra ir virs 0 °C, jo uzstādišana var būt apgrūtināta pie temperatūras zem 0 °C un var izraisīt samazinātu skābekļa piegādi pacientam.
26. Izmantojot elpināšanas maisu ar piestiprinātu sejas masku, nodrošiniet pareizu sejas maskas novietojumu un necaurlaidīgumu, jo nepareizs necaurlaidīgums var inficēt lietotāju ar gaisa nestu infekcijas slimību.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Nekad neglabājiet elpināšanas maisu deformētā veidā. To drīkst glabāt tikai salocītā veidā, kā to piegādājis ražotājs, citādi var rasties nenovēršams maisa plūsums, kas var mazināt elpināšanas efektivitāti. Locījuma vieta uz maisa ir skaidri redzama (drīkst ločīt tikai pieaugušajiem un bērniem paredzētās versijas).
2. Lai pārliecinātos par elpināšanu, vienmēr vērojet krūškurvja kustības un klausieties izelpas plūsmu no pacienta vārsta. Ja elpināšanu ar elpināšanas maisu nav iespējams nodrošināt, nekavējoties pārejiet uz elpināšanu no mutes mutē.
3. Šo ierīci nedrīkst skalot, iegremdējot šķidrumā, vai sterilizēt, jo šis procedūras var atstāt kaitīgas paliekas vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Ierīces konstrukcija un materiāls nav saderīgi ar tradicionālajām tīrišanas un sterilizēšanas procedūrām.
4. Izmantojet M pieslēgvietu tikai vienam no šiem nolūkiem: EtCO₂ mērišanai vai zāļu ievadei, jo tas var modificēt izmērītās vērtības.
5. Ja piemērojams, lūdzu, skatiet specifisku informāciju par atsevišķu palīgierīci uz palīgierices iepakojuma, jo nepareiza ekspluatācija var izraisīt visa izstrādājuma darbības traucējumus.
6. Trešās putas izstrādājumu un skābekļa padeves ierīču (piem., filtru un gaisa padeves regulēšanas vārstu) izmantošana ar Ambu SPUR II Resuscitator var ietekmēt izstrādājuma veikspēju. Sazinieties ar trešās putas ierīces ražotāju, lai pārbaudītu saderību ar Ambu SPUR II Resuscitator un iegūtu informāciju par iespējamām veikspējas izmaiņām.
7. Skābekļa rezervuāra maiss pieaugušajiem un bērniem paredzētajiem elpināšanas maisiem ir pastāvīgi pievienots pie ieplūdes vārsta, izņemot versijām ar gaisa padeves regulēšanas vārstu. Nemēģiniet to atdalīt. Nevelciet skābekļa rezervuāra maisu, jo var rasties ierīces darbības traucējumi.

1.8. Iespējamie nevēlamie notikumi

Iespējamie nevēlamie notikumi, kas ir saistīti ar elpināšanu (nepilnīgs uzskaitījums): barotrauma, volutrauma, hipoksija, hiperkarbija un aspirācijas pneimonija.

1.9. Vispārējas piezīmes

Ja šīs ierīces lietošanas laikā vai tās dēļ rodas kāds nopietns incidents, lūdzam par to ziņot ražotājam un savas valsts kompetentajai iestādei.

2. Ierīces apraksts

Ambu SPUR II Resuscitator var apvienot ar Ambu® Disposable Pressure Manometer, Ambu® PEEP Valve un Ambu® Face mask, kā aprakstīts 4.3. sadaļā Elpināšanas maisa ekspluatācija.

3. Lietoto simbolu skaidrojums

Simbola nozīme	Apraksts
	Pieaugušajiem Paredzētā ideālā ķermeņa masa ir lielāka par 30 kg
	Bērniem Paredzētā ideālā ķermeņa masa ir diapazonā no 6 līdz 30 kg
	Zīdaiņiem Paredzētā ideālā ķermeņa masa ir līdz 10 kg
	Saderīgs ar MR
	Ražotājvalsts

Simbola nozīme	Apraksts
	Medicīniskā ierice
	Atkārtotai lietošanai vienam pacientam
	Nevelciet skābekļa rezervuāra maisu ar spēku

Pilns simbolu skaidrojumu saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Izstrādājuma lietošana

4.1. Darbības princips

Attēlā 1 redzams, kā elpināšanas gāzu maisijums ieplūst maisā un pacienta ķermenī un izplūst no tā manuālas elpināšanas maisa izmantošanas laikā. 1a Pieaugušo un bērnu elpināšanas maisa, 1b zidaiņu elpināšanas maisa ar slēgtu skābekļa rezervuāra maisu (maisa rezervuārs), 1c zidaiņu elpināšanas maisa ar atvērtu skābekļa rezervuāra caurulīti (caurulītes rezervuārs).

Kad pacients spontāni elpo caur ierīci, gāzu plūsma ir līdzīga.

Skābekļa rezervuārs ir aprīkots ar diviem vārstiem: viens no tiem ļauj ieplūst apkārtējam gaisam, kad rezervuārs ir tukšs, un viens ļauj izplūst papildu skābeklim, ja skābekļa rezervuāra maisa ir pilns.

M pieslēgvjeta nodrošina pieķuvi ieelpas un izelpas gāzu plūsmai, ļaujot pievienot šījirci zāju ievadei 1d vai gāzes paraugu nēmšanas sistēmu EtCO₂ 1e sānu atzara mērišanai.

1.1 Liekā skābekļa izlaišana, 1.2 Gaisa ieplūdes atvere, 1.3 Skābekļa ieplūdes atvere, 1.4 Pacienta savienotājs, 1.5 Izelpa, 1.6 Manometra pieslēgvjeta, 1.7 Spiedienu ierobežojošais vārsts, 1.8 M pieslēgvjeta.

PIEZĪME: pierice pie 1.5 var būt izšķakstišanās aizsargs vai PEEP vārsts.

4.2. Pārbaude un sagatavošana

Elpināšanas maisa jāizpako un jāsagatavo tūlitējai lietošanai (ieskaitot funkcionālāties pārbaudes veikšanu), pirms tas tiek novietots lietošanai sagatavotā veidā izmantošanai neatliekamās situācijās.

4.2.1. Sagatavošana

- Ja elpināšanas maisa ir iepakots saspieštā veidā, atlokiet to, pavelkot aiz pacienta un ieplūdes vārsta.
- Sagatavojet elpināšanas maisu un ielieci visus kopā ar elpināšanas maisu piegādātos priekšmetus pārnēsāšanas maisā.
- Ja kopā ar elpināšanas maisu piegādātā sejas maska ir ietīta aizsargmaisīnā, tas pirms lietošanas ir jānoņem.

Skatiet 4.2.2. sadaļu. (Skābekļa caurulīte) ierīces sagatavošanai pirms lietošanas temperatūrā zem 0 °C.

4.2.2. Darbības pārbaude 2

Elpināšanas maisa

Noslēdziet spiedienu ierobežojošo vārstu ar izolējošo spaili un aizveriet pacienta savienotāju ar īkšķi 2.1. Strauji saspiediet saspiežamo maisu. Jābūt jūtamai elpināšanas maisa pretestībai pret saspiešanu.

Atveriet spiedienu ierobežojošo vārstu, atverot izolējošo spaili un atkārtojot procedūru. Spiedienu ierobežojošam vārstam tagad vajadzētu būt aktivizētam un būtu jābūt dzirdamai izelpas plūsmai caur vārstu, strauji saspiežot saspiežamo maisu.

Saspiediet un atlaidiet elpināšanas maisu dažas reizes, lai pārliecinātos, vai gaiss pārvietojas caur vārstu sistēmu un izplūst no pacienta vārsta. **2.2**

PIEZĪME.Darbības pārbaudes vai elpināšanas laikā vārsta diskiem pārvietojoties, var būt dzirdama kļusa skaņa. Tā neietekmē elpināšanas maisa darbību.

Skābekļa caurulīte

Skābekļa caurulītes uzstādišana un skābekļa rezervuāra maisa un skābekļa rezervuāra caurulītes darbības pārbaude ir jāveic temperatūrā virs 0°C . Elpināšanas maisa lietošanai temperatūrā zem 0°C astājiet skābekļa caurulīti pievienotu pie skābekļa padeves pēc darbības pārbaudes.

Skābekļa rezervuāra maiss

Nodrošiniet gāzes plūsmu 10 l/min uz skābekļa ieplūdes savienotāju. Visbeidzot atbalstiet maisa atločīanos ar roku. Pārbaudiet, vai skābekļa rezervuāra maišs piepildās. Ja tas nepiepildās, pārbaudiet abu vārstu aizdares viru veselumu, kā arī to, vai skābekļa rezervuārs nav sagriezies.

Pielāgojiet piegādāto gāzes plūsmu atbilstoši medicīniskām indikācijām.

Skābekļa rezervuāra caurulīte

Nodrošiniet gāzes plūsmu 10 l/min uz skābekļa ieplūdes savienotāju. Pārbaudiet, vai skābeklis izplūst no skābekļa rezervuāra caurulītes gala. Ja tas nenotiek, pārbaudiet, vai skābekļa caurulīte nav nosprostota. Pielāgojiet piegādāto gāzes plūsmu atbilstoši medicīniskām indikācijām.

M pieslēgvjeta

Noņemiet M pieslēgvjetas vāciņu un noslēdziet pacienta savienotāju. Saspiediet maisu un klausieties, kā gaiss tiek izspiests caur M pieslēgvjetu. **2.3**

4.3. Elpināšanas maisa ekspluatācija

- Lai pareizi pozicionētu pacientu elpcēļu atvēršanai un lai atbrīvotu pacienta muti un elpcēļus, izmantojiet ieteicamās metodes.
- Cieši turiet piespiestu sejas masku pie pacienta sejas. **3.1**
- Pabāziet plaukstu (izmantojot pieaugušiem paredzēto versiju) vai zeltnesi un trešo pirkstu (izmantojot bērniem paredzēto versiju) zem roktura. Bērniem paredzētajai versijai nav atbalsta roktura. Elpināšanu bez atbalsta roktura var nodrošināt, pagriežot maisu. **3.2**
- Pacienta elpināšana: insuflācijas laikā vērojiet, kā paceļas krūškurvis. Strauji atlaidiet roku, kas tur maisu, un klausieties, kā notiek izelpas plūsma no pacienta vārsta, un vērojiet, kā noplök krūškurvis.
- Ja insuflācijas laikā nepārtraukti jūtama pretestība, pārbaudiet, vai elpcēļi nav nosprostojušies, un atkārtoti pozicionējiet pacientu, lai nodrošinātu atvērtus elpcēļus.
- Ja elpināšanas laikā pacents vemj, nekavējoties atbrīvojiet pacienta elpcēļus un pirms elpināšanas atsākšanas izgrūdiet vēmekļus no elpināšanas maisa, to spēcīgi un ātri vairākas reizes kratot un saspiežot.Ja nepieciešams, noslaukiet izstrādājumu ar spiritu saturošu drānu un notiriet izšķakstišanās aizsargu ar ūdeni.

Manometra pieslēgvjeta

Ambu vienreizlietojamo spiediena manometru, kā arī trešās puses manometru var pievienot manometru pieslēgvietai, kas atrodas pacienta vārsta augšpusē. Noņemiet vāciņu un pievienojiet manometru.

Spiedienu ierobežojošā sistēma **4**

Spiedienu ierobežojošais vārsts ir iestatīts tā, lai atvērtos pie $40\text{ cm H}_2\text{O}$ ($4,0\text{ kPa}$). **4.1**

Ja medicīniska un profesionāla novērtēšana liecina, ka nepieciešams par $40\text{ cm H}_2\text{O}$ augstāks spiediens, spiedienu ierobežojošo vārstu var neizmantot, uzspiežot vārstam izolējošo spaili. **4.2**

Spiedienu ierobežojošo vārstu var noslēgt, arī maisa saspiešanas laikā novietojot rādītājpirkstu uz sarkanās pogas.

M pieslēgveta

Izstrādājums Ambu SPUR II Resuscitator ir pieejams ar M pieslēgvietu vai bez tās.

M pieslēgveta nodrošina piekļuvi ieelpas un izelpas gāzes plūsmai, un to var izmantot zāļu ievadišanai vietā, kur ir pievienota šķirce, kā arī izmantot, lai izmērītu CO₂ (EtCO₂) sānu atzaru. Kad M pieslēgveta netiek izmantota, neaizmirstiet to aizvērt ar sarkano M pieslēgvetas vāciņu.

EtCO₂ mērišana

EtCO₂ sānu atzara mērišanai; pievienojet EtCO₂ mērierīces gāzu parauguņemšanas sistēmu Ambu SPUR II Resuscitator M pieslēgvietai. Pievienojet gāzu parauguņemšanas sistēmas savienotāju, uzstādot un pagriezot to par 1/4 pulksteņa rādītāja kustības virzienā.

Zāļu ievadišana

Rūpīgi vērojiet pacienta atbildes reakciju pret ievadītajām zālēm. 1 ml vai lielāka šķidruma tilpuma ievadišana caur M pieslēgvietu ir pielidzināma ievadišanai tieši endotraheālājā caurulītē. M pieslēgveta ir pārbaudīta ar epinefrīnu, lidokainu un atropīnu.

Ambu SPUR II Resuscitator gaisa padeves regulēšanas vārsta versija 5

Ambu SPUR II Resuscitator gaisa padeves regulēšanas vārsta versija ir pieejama pieaugušajiem un bērniem paredzētajā izmērā, un to var izmantot ar gaisa padeves regulēšanas vārstu vai bez tā. Komplektācijā ir iekļauts piestiprināms skābekļa rezervuāra maiss.

Ambu SPUR II Resuscitator ieplūdes vārstu var savienot ar gaisa padeves regulēšanas vārstu, izmantojot adapteri.

Pievienošana pie gaisa padeves regulēšanas vārsta:

- Ja ir pievienots, noņemiet skābekļa rezervuāru no Ambu SPUR II Resuscitator ieplūdes vārsta.
- Pievienojet adapteri pie gaisa padeves regulēšanas vārsta sistēmas.
- Levietojiet gaisa padeves regulēšanas vārstu Ambu SPUR II Resuscitator ieplūdes vārstā.

PIEZĪME. Ar adapteri un gaisa padeves regulēšanas vārstu izmantojiet tikai to daļu, kas ir markēta kā "saspiešanas daļa". Daļa, kas ir markēta kā "skābekļa rezervuāra maiss", tiek uzskatīta par rezerves daļu, ja gaisa padeves regulēšanas vārsts pārstāj darboties.

Skābekļa ievadišana

Ievadiet skābekli atbilstoši medicīniskām indikācijām.

Attēlā 6 ir parādīti aprēķinātie piegādātā skābekļa procentuālie rādījumi, ko var iegūt ar dažādiem elpināšanas tilpumiem un frekvencēm pie dažādiem gāzes plūsmas ātrumiem. Skābekļa procentuālie rādījumi ir parādīti 6 pieaugušajiem paredzētajā versijā 6.1, bērniem paredzētajā versijā 6.2, zīdaiņiem paredzētajā versijā 6.3.

Skābekļa rezervuāra maiss 7

Plāno skābekļa rezervuāra maisa plastmasas foliju nevar noņemt no tā savienojuma vietas pie elpināšanas maisa.

Papildriki 8

Ambu SPUR II Resuscitator savienotāji atbilst standartam ISO 5356-1 un EN 13544-2, kas tos padara atbilstošus citam slimnīcas aprīkojumam. Pirms ārējo ierīču pievienošanas jāveic funkcionalitātes pārbaude un jāizlasa ārējās ierīces lietošanas instrukcija.

Tālāk norādīti Ambu izstrādājumi, kas ir saderīgi ar Ambu SPUR II Resuscitator:

Ambu® Disposable Face Mask

Sikāku informāciju skatiet Ambu Disposable Face Mask lietošanas pamācībā.

Ambu® Disposable PEEP 20 Valve 8.1 8.2

Sikāku informāciju skatiet Ambu Disposable PEEP 20 Valve lietošanas pamācībā vai skatiet attēlu 8.1 šajā lietošanas pamācībā. Lai piestiprinātu Ambu Disposable PEEP 20 Valve (ja nepieciešams) pie elpināšanas maskas, noņemiet izšķakstīšanās aizsargu. 8.2

Ambu® Disposable Pressure Manometer 8.3

Sikāku informāciju skatiet Ambu Disposable Pressure Manometer lietošanas pamācībā.

4.4. Pēc lietošanas

Izlietoti izstrādājumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējās iestādes procedūrām.

5. Izstrādājuma tehniskās specifikācijas

5.1. Izmantotie standarti

Ambu SPUR II elpināšanas maiss atbilst izstrādājumam piemērojamam standartam EN ISO 10651-4.

5.2. Specifikācijas

	Zīdaņiem	Bērniem	Pieaugušajiem
Elpināšanas maisa tilpums	aptuveni 220 ml	aptuveni 670 ml	aptuveni 1510 ml
Padotais tilpums ar vienu roku*	150 ml	450 ml	600 ml
Padotais tilpums ar divām rokām*	-	-	1000 ml
Izmēri (garums x diametrs) bez rezervuāra un paligrikiem	aptuveni 190 x 71 mm	aptuveni 223 x 99 mm	aptuveni 284 x 127 mm
Svars bez rezervuāra un paligrikiem	aptuveni 70 g	aptuveni 145 g	aptuveni 220 g
Spiedienu ierobežojošais vārsts**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Mirusī telpa	≤ 5 ml + 10 % no padotā tilpuma	≤ 5 ml + 10 % no padotā tilpuma	≤ 5 ml + 10 % no padotā tilpuma

	Zīdaņiem	Bērniem	Pieaugušajiem
Pretestība ieelpai***	ne vairāk kā 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) pie 5 l/min	ne vairāk kā 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pie 50 l/min	ne vairāk kā 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pie 50 l/min
Pretestība izelpai***	ne vairāk kā 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) pie 5 l/min	ne vairāk kā 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pie 50 l/min	ne vairāk kā 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pie 50 l/min
Rezervuāra tilpums	aptuveni 300 ml (maiss) aptuveni 100 ml (caurulīte)	aptuveni 2600 ml (maiss)	aptuveni 2600 ml (maiss)
Pacienta savienotājs		Ar izcilni, ārpuse, 22 mm (ISO 5356-1) Ar iedobi, iekšpuse, 15 mm (ISO 5356-1)	
Izelpas savienotājs (PEEP vārsta paligrikam)			ar izcilni, 30 mm (ISO 5356-1)
Manometra pieslēgvietas savienotājs			Ø 4,2 +/- 0,1 mm
Gaisa padeves regulēšanas vārsta savienotājs	-		Ar iedobi, iekšpuse, 32 mm (EN ISO 10651-4)
Noplūde uz priekšu un atpakaļ			Nav izmērāma
M pieslēveta			Savienotājs saderīgs ar EN ISO 80369-7
O ₂ ieplūdes vietas savienotājs			Saskaņā ar EN 13544-2
Darba temperatūras ierobežojumi			no -18 °C līdz +50 °C (-0,4 °F līdz +122 °F), testēts saskaņā ar EN ISO 10651-4
Uzglabāšanas temperatūras ierobežojumi			no -40 °C līdz +60 °C (-40 °F līdz +140 °F), testēts saskaņā ar EN ISO 10651-4
Ieteicams ilgstoši glabāt aizvērtā iepakojumā istabas temperatūrā saules stariem nepieejamā vietā.			

* Pārbaudits saskaņā ar EN ISO 10651-4.

** Augstāku padeves spiedienu var sasniegt, neizmantojot spiedienu ierobežojošo vārstu.

*** Vispārējos pārbaudes apstākļos saskaņā ar EN ISO 10651-4.



5.3. Informācija par lietošanas drošību MRI vidē

Ambu SPUR II Resuscitator¹, Ambu SPUR II Resuscitator ar pievienotu Ambu Disposable PEEP 20 Valve², Ambu SPUR II Resuscitator ar pievienotu Ambu Disposable PEEP 20 Valve un Ambu Disposable Pressure Manometer² ir saderīgi ar MR, tāpēc tos var droši izmantot MR vidē (taču ne MR atverē), ievērojot tālāk norādītos nosacījumus.

7 teslu vai mazāks statiskais magnētiskais lauks ar

- Maksimālo telpiskā lauka gradientu:
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Maksimālo spēka produktu:
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Izmantošana MR atveres iekšpusē var ietekmēt MR attēla kvalitāti.

RF izraisītā apsilde un MR attēla artefakti nav testēti. Visas metāliskās daļas ir pilnībā noslēgtas un nesaskaras ar cilvēka ķermenī.

1. Belangrijke informatie – Lezen vóór gebruik

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u de Ambu® SPUR® II Resuscitator gebruikt. De gebruiksaanwijzing kan zonder nadere kennisgeving worden bijgewerkt. Exemplaren van de huidige versie zijn op verzoek verkrijgbaar. Wij wijzen u erop dat deze gebruiksaanwijzing geen uitleg of besprekking bevat van klinische ingrepen. Hierin worden uitsluitend de algemene werking en de te nemen voorzorgsmaatregelen behandeld in verband met het gebruik van het beademingsapparaat. Het is uiterst belangrijk dat gebruikers voldoende zijn opgeleid in klinische beademingstechnieken voordat ze het beademingsapparaat voor de eerste keer gaan gebruiken en dat ze op de hoogte zijn van het beoogde gebruik en de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties in deze gebruiksaanwijzing. Er is geen garantie op de Ambu SPUR II Resuscitator.

1.1. Beoogd gebruik

Het Ambu SPUR II beademingsapparaat is een beademingsapparaat voor gebruik bij één patiënt dat bedoeld is voor longbeademing.

1.2. Gebruiksaanwijzingen

Het Ambu SPUR II beademingsapparaat is bedoeld voor gebruik in situaties waarin een handmatig cardiopulmonair beademingsapparaat nodig is voor ondersteunde beademing. Het Ambu SPUR II beademingsapparaat is geïndiceerd voor beademing en zuurstoftoevoer van patiënten totdat een definitievere luchtweg kan worden opgezet of de patiënt is hersteld.

1.3. Beoogde patiëntenpopulatie

Het toepassingsbereik voor elke versie is als volgt:

- **Volwassene:** Volwassenen en kinderen met een lichaamsgewicht van meer dan 30 kg (66 lbs).
- **Pediatrisch:** Zuigelingen en kinderen met een lichaamsgewicht van 6 tot 30 kg (13 - 66 lbs).
- **Zuigeling:** Pasgeborenen en zuigelingen met een lichaamsgewicht van maximaal 10 kg (22 lbs). Houd er rekening mee dat niet alle configuraties van het Ambu SPUR II beademingsapparaat beschikbaar zijn voor alle drie patiëntbereiken.

1.4. Beoogde gebruiker

Medische professionals die zijn opgeleid in luchtwegbeheer, zoals anesthesiologen, verpleegkundigen, reddingswerkers en noodhulpverleners.

1.5. Contra-indicaties

Geen bekend.

1.6. Klinische voordelen

De basistechniek voor luchtwegbeheer met behulp van een handbeademingsballon maakt beademing van en zuurstoftoevoer naar patiënten mogelijk totdat een definitievere luchtweg kan worden opgezet of de patiënt is hersteld.

1.7. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot inefficiënte beademing van en zuurstoftoevoer naar de patiënt of beschadiging van de apparatuur.

WAARSCHUWINGEN

1. Gebruik het beademingsapparaat niet langer dan 4 opeenvolgende uren gedurende een maximale tijdspanne van 1 week om het risico op infectie te verminderen.
2. Gebruik het beademingsapparaat niet opnieuw als er zichtbaar vocht of resten in het apparaat achterblijven, om infecties en storingen te voorkomen.
3. Zorg ervoor dat de spatbescherming of Ambu PEEP-klep op de expiratiepoort is aangesloten. Een open expiratiepoort kan per ongeluk geblokkeerd raken, wat kan leiden tot overmatig luchtvolume in de longen, wat kan leiden tot weefseltrauma.
4. Vermijd het gebruik van het beademingsapparaat in giftige of gevaarlijke omgevingen om het risico op weefselschade te voorkomen.

5. Zorg er altijd voor dat de slang van het zuurstofreservoir niet geblokkeerd is, omdat het blokkeren van de slang kan voorkomen dat de compressiezak opnieuw wordt gevuld, wat kan leiden tot geen mogelijke beademing.
6. Gebruik het product niet als het verontreinigd is door externe bronnen, omdat dit infectie kan veroorzaken.
7. Inspecteer het product altijd visueel en voer na het uitpakken, monteren en vóór gebruik altijd een werkingstest uit, aangezien defecten en vreemde voorwerpen kunnen leiden tot geen of verminderde beademing van de patiënt.
8. Gebruik het product niet als de test voor functionaliteit mislukt, aangezien dit kan leiden tot geen of verminderde ventilatie.
9. Schakel de drukbegrenzingsklep alleen uit als een medische beoordeling de noodzaak hiervan aangeeft. Een hoge beademingsdruk kan barotrauma veroorzaken.
10. Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Gebruik bij andere patiënten kan tot kruisbesmetting leiden.
11. Medicatie kan niet via de M-port worden geleverd als er accessoires (bijv. filter, CO₂-detector) zijn aangesloten tussen het beademingsapparaat en het gezichtsmasker.
12. Laat de M-port na gebruik niet openstaan om lekkage te voorkomen, wat kan leiden tot een verminderde afgifte van O₂ aan de patiënt.
13. De M-Port mag niet worden gebruikt voor het monitoren van etCO₂-zijstrom bij patiënten die met minder dan 400 ml teugvolume worden beademd, om onnauwkeurige EtCO₂-metingen te voorkomen.
14. Bij het toedienen van medicatie met een volume van minder dan 1 ml moet de M-Port worden gespoeld om een nauwkeurige dosering van de medicatie te garanderen.
15. Sluit de zuurstoftoevoerslang niet aan op de M-port, aangezien de beoogde O₂-concentratie dan niet aan de patiënt wordt toegediend.
16. Het gebruik van accessoires kan de inspiratoire en/of expiratoire weerstand verhogen. Bevestig geen accessoires als een verhoogde ademweerstand nadelig kan zijn voor de patiënt.
17. Uitsluitend bestemd voor gebruik door gebruikers die bekend zijn met de inhoud van deze handleiding, aangezien onjuist gebruik schadelijk kan zijn voor de patiënt.
18. Wanneer u extra zuurstof gebruikt, mag u niet roken of het apparaat gebruiken in de buurt van open vuur, olie, vet, andere brandbare chemicaliën of apparatuur en gereedschappen die vonken kunnen veroorzaken, vanwege het risico op brand en/of explosie.
19. Probeer geen inademklep aan te sluiten op de uitvoering voor zuigelingen, omdat dit hoge zuurstofconcentraties kan veroorzaken die schadelijk kunnen zijn voor pasgeborenen.
20. Let op tekenen van volledige/gedeeltelijke obstructie van de bovenste luchtwegen bij gebruik van het beademingsapparaat dat aan een gezichtsmasker is bevestigd, omdat dit geen of beperkte zuurstoftoediening tot gevolg heeft. Schakel altijd over op een alternatief voor het gebruik van een gezichtsmasker om lucht naar de patiënt te leiden, indien beschikbaar.
21. Gebruik het product niet met een bevestigd gezichtsmasker bij het beademen van zuigelingen met angeboren diafragmahlernia vanwege het risico op insufflatie. Schakel over op een alternatief voor het gebruik van een gezichtsmasker, indien beschikbaar, om lucht naar de patiënt te leiden.
22. Professionals die de procedure uitvoeren, moeten de keuze van de maat en accessoires van het beademingsapparaat beoordelen (bijv. gezichtsmasker, PEEP-klep enz.) in overeenstemming met de specifieke conditie(s) van de patiënt, aangezien onjuist gebruik de patiënt kan schaden.
23. Gebruik de Ambu SPUR II niet wanneer toediening van vrijstromende zuurstof nodig is, vanwege mogelijk onvoldoende toediening van zuurstof, wat kan leiden tot hypoxie.
24. De manometerdop moet altijd op de manometerpoort worden geplaatst wanneer de druk niet wordt bewaakt, om lekkage te voorkomen, wat kan leiden tot een verminderde afgifte van O₂ aan de patiënt.

25. Bevestig de zuurstofslang altijd vooraf aan de zuurstoftoevoer bij temperaturen boven 0 °C, omdat montage moeilijk kan worden bij temperaturen onder 0 °C, waardoor de zuurstoftoevoer naar de patiënt wordt verminderd.
26. Zorg bij gebruik van het beademingsapparaat met bevestigd gezichtsmasker voor een juiste plaatsing en afsluiting van het gezichtsmasker, aangezien een onjuiste afdichting kan leiden tot verspreiding van door de lucht verspreide infectieziekten bij de gebruiker.

VOORZORGSMAAATREGELLEN

1. Het beademingsapparaat bij opslaan altijd op dezelfde wijze opvouwen zoals deze door de fabrikant is geleverd. Door het niet opvolgen van deze aanwijzing zou de ballon permanent kunnen vervormen, wat de beademingsefficiëntie kan verminderen. De vouwzone is duidelijk zichtbaar op de ballon (alleen de typen Adult en Pediatric mogen worden gevouwen).
2. Observeer altijd de beweging van de borstkas en luister of u de expiratoire stroom uit de patiëntklep hoort om de beademing te controleren. Schakel onmiddellijk over op mond-op-mondbeademing als beademing met het beademingsapparaat niet mogelijk is.
3. U mag dit hulpmiddel niet weken, spoelen of steriliseren; dergelijke procedures kunnen schadelijke resten achterlaten of storing van het hulpmiddel veroorzaken. Het ontwerp en het gebruikte materiaal zijn niet compatibel met conventionele reinigings- en sterilisatieprocedures.
4. Gebruik de M-Port voor slechts één doel: EtCO₂-metingen of medicatietoediening, omdat dit de gemeten waarden kan wijzigen.
5. Raadpleeg indien van toepassing de verpakking van het accessoire voor specifieke informatie over het betreffende accessoire, aangezien onjuiste hantering kan leiden tot storing van het gehele product.

6. Het gebruik van producten van derden en zuurstoftoedieningsapparatuur (bijv. filters en inademkleppen) met het Ambu SPUR II beademingsapparaat kunnen de prestaties van het product beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant van het apparaat van derden om de compatibiliteit met het Ambu SPUR II beademingsapparaat te controleren en informatie te verkrijgen over mogelijke prestatiewijzigingen.
7. De zuurstofreservoirzak is permanent bevestigd aan de inlaatklep op beademingsapparaten voor volwassenen en kinderen, behalve bij uitvoeringen met een inademklep. Probeer niet om deze te demonteren. Trek niet aan de zuurstofreservoirzak, omdat dit kan leiden tot een storing van het hulpmiddel.

1.8. Mogelijke bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen in verband met beademing (niet uitputtend): barotrauma, volutrauma, hypoxie, hypercarbie en aspiratiepneumonie.

1.9. Algemene opmerkingen

Als tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, meld dit dan aan de fabrikant en uw nationale autoriteit.

2. Beschrijving van het apparaat

Het Ambu SPUR II beademingsapparaat kan worden aangesloten op de Ambu® disposable drukmeter, de Ambu® PEEP-ventielen en de Ambu® gezichtsmaskers, zoals beschreven in paragraaf 4.3 Bediening van het beademingsapparaat.

3. Toelichting op de gebruikte symbolen

Symboolindicatie	Beschrijving
	Volwassene Beoogde ideale lichaamsmassa van meer dan 30 kg
	Pediatrisch Beoogde ideale lichaamsmassa van 6 tot 30 kg
	Peuter Beoogde ideale lichaamsmassa tot 10 kg
	MR-voorwaardelijk
	Land van fabrikant
	Medisch hulpmiddel

Symboolindicatie	Beschrijving
	Meervoudig gebruik bij één patiënt
	Trek niet te hard aan de zuurstofreservoirzak

Een volledige lijst met symboolverklaringen is te vinden op
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Productgebruik

4.1. Werkingsprincipe

De afbeelding 1 toont de beademingsgasmengsels die in de ballon, en van en naar de patiënt stromen tijdens handmatige bediening van het beademingsapparaat. 1a Beademingsapparaat voor volwassenen en kinderen, 1b beademingsapparaat voor zuigelingen met gesloten zuurstofreservoirzak (ballonreservoir), 1c beademingsapparaat voor zuigelingen met open zuurstofreservoirslang (slangreservoir).

De gasstroom is vergelijkbaar met de stroom wanneer de patiënt spontaan door het apparaat ademt.

Het zuurstofreservoir is uitgerust met twee kleppen, waarvan de ene omgevingslucht inlaat wanneer het reservoir leeg is en de andere het overschot aan zuurstof afvoert wanneer het zuurstofreservoir vol is.

De M-Port biedt toegang tot de inspiratoire en expiratoire gasstroom en maakt het mogelijk om een spuit aan te sluiten voor toediening van medicijnen 1d of om een gasbemonsteringsslange aan te sluiten voor het meten van EtCO₂-zijstroom 1e.

- 1.1** Afgifte van overtollige zuurstof, **1.2** luchtinlaat, **1.3** zuurstofinlaat, **1.4** patiëntconnector, **1.5** expiratie, **1.6** manometerpoort, **1.7** drukbegrenzingsklep, **1.8** M-port.

OPMERKING: bevestiging aan 1.5 kan een spatbescherming of een PEEP-ventiel zijn.

4.2. Inspectie en voorbereiding

Het beademingsapparaat moet worden uitgepakt en klaargemaakt (met inbegrip van het uitvoeren van een functionaliteitstest) voor onmiddellijk gebruik voordat het gereed is voor gebruik in noodsituaties.

4.2.1. Voorbereiding

- Is het beademingsapparaat ineengedrukt opgeborgen, dan vouwt u het uit door te trekken aan de patiëntklep en de inlaatklep.
- Bereid het beademingsapparaat voor en plaats alle voorwerpen in de draagtas die bij het beademingsapparaat is geleverd.
- Als het gezichtsmasker verpakt in een beschermende zak bij het beademingsapparaat is geleverd, moet de zak vóór gebruik worden verwijderd.

Zie hoofdstuk 4.2.2. (Zuurstofslang) voor de voorbereiding van het hulpmiddel vóór gebruik bij een temperatuur onder 0 °C.

4.2.2. Werkigstest **2**

Beademingsapparaat

Sluit de drukbegrenzingsklep af met de uitschakeldop en sluit de patiëntconnector af met de duim **2.1**. Knijp stevig in de samendrukbare ballon. Het beademingsapparaat moet bestand zijn tegen de samendrukking.

Open de drukbegrenzingsklep door de uitschakelklem weg te schuiven en de procedure te herhalen. De drukbegrenzingsklep zou nu geactiveerd moeten zijn en het zou mogelijk

moeten zijn om de stroming uit de klep te horen tijdens flinke compressie van de samendrukbare zak.

Knijp een aantal keer in de beademingsballon om te controleren of lucht door het klepsysteem en uit de patiëntklep stroomt. **2.2**

OPMERKING: Tijdens de werkingstest en de beademing bewegen de klepschijven, waardoor een zacht geluid hoorbaar kan zijn. Dit heeft geen nadelige invloed op de werking van het beademingsapparaat.

Zuurstofslang

Montere de zuurstofslang en test de werking van de zuurstofreservoirballon en de zuurstofreservoirslang bij temperaturen boven 0 °C. Laat de zuurstofslang na de functietest aangesloten op de zuurstoftoevoer om het beademingsapparaat te gebruiken bij temperaturen onder 0 °C.

Zuurstofreservoirzak

Zorg voor een gasstroom van 10 l/min bij de zuurstofinlaatconnector. Ondersteun eventueel het uitklappen van de zak met de hand. Controleer of de zuurstofreservoirzak zich vult. Als dit niet het geval is, controleert u of de twee klepafsluiters intact zijn of op een gescheurd zuurstofreservoir.

Pas vervolgens de toegevoerde gasstroom aan volgens de medische indicatie.

Zuurstofreservoirslang

Zorg voor een gasstroom van 10 l/min bij de zuurstofinlaatconnector. Controleer of de zuurstof bij het uiteinde van de zuurstofreservoirslang naar buiten stroomt. Als dit niet geval is, controleert u of de zuurstofslang verstopt is. Pas vervolgens de toegevoerde gasstroom aan volgens de medische indicatie.

M-Port

Verwijder de dop van de M-Port en blokkeer de patiëntconnector. Knijp in de ballon en luister of u het geluid hoort van lucht die via de M-port naar buiten wordt geperst. **2.3**

4.3. Het beademingsapparaat bedienen

- Pas aanbevolen technieken toe om de mond en luchtweg van de patiënt vrij te maken en de patiënt in de juiste houding te brengen voor het openen van de luchtwegen.
- Houd het gezichtsmasker stevig tegen het gezicht van de patiënt. **3.1**
- Schuif uw hand (Adult-type) of ring- en middelvinger (Paediatric-type) onder de draagband. De uitvoering voor zuigelingen heeft geen draagband. Beademing zonder gebruik van de draagband is mogelijk door de ballon te draaien. **3.2** Beademing van de patiënt: Let tijdens de insufflatie op of de borstkas omhoog komt. Laat de hand die de ballon vasthoudt, abrupt los en luister naar de expiratoire stroom uit de patiëntklep. Let ook op het visueel dalen van de borstkas.
- Als er aanhoudende weerstand tegen insufflatie wordt ervaren, moet u de luchtweg controleren op obstrucie en moet de patiënt opnieuw worden gepositioneerd om een open luchtweg te waarborgen.
- Als de patiënt tijdens de beademing moet overgeven, moet u de luchtwegen van de patiënt onmiddellijk vrijmaken en het braaksel uit het beademingsapparaat verwijderen door het apparaat enkele keren krachtig en snel te schudden en samen te drukken voordat u de beademing hervat. Veeg het product zo nodig af met een doek die alcohol bevat en reinig de spatbescherming met water.

Manometeringang

De Ambu-drukmeter voor eenmalig gebruik en de drukmeter van derden kunnen worden aangesloten op de manometerpoort aan de bovenkant van de patiëntklep. De dop verwijderen en de manometer/drukmeter bevestigen

Drukbegrenzingssysteem **4**

De drukbegrenzingsklep is ingesteld op openen bij 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Als een medische en professionele beoordeling aangeeft dat een druk van meer dan 40 cm H₂O vereist is, kan de drukbegrenzingsklep worden uitgeschakeld door de uitschakelklem op de klep te plaatsen. **4.2**

U kunt de drukbegrenzingsklep ook uitschakelen door met een vinger op de rode knop te drukken terwijl u in de ballon knijpt.

M-Port

Het Ambu SPUR II beademingsapparaat wordt geleverd met of zonder M-Port. De M-Port biedt toegang tot de inspiratoire en expiratoire gasstroom en kan worden gebruikt voor het toedienen van medicatie, indien aangesloten op een spuit, alsook voor het meten van de zijstroom CO₂ (EtCO₂). Vergeet niet om de M-port af te sluiten met de rode dop van de M-port wanneer u deze niet gebruikt.

Meten van EtCO₂

Voor het meten van de zijstroom EtCO₂; sluit de gasbemonsteringsslang voor het EtCO₂-meetapparaat aan op de M-Port van het Ambu SPUR II beademingsapparaat. Sluit de connector van de gasbemonsteringsslang door deze te bevestigen en een kwartslag rechtsom te draaien.

Medicatie toedienen

Houd de reactie van de patiënt op de toegediende medicatie goed in de gaten. Het toedienen van volumes van 1 ml vloeistof of meer via de M-Port is te vergelijken met toediening direct in een endotracheale buis. De M-Port is getest met epinefrine, lidocaïne en atropine.

Ambu SPUR II beademingsapparaat-uitvoering met inademklep **5**

De Ambu SPUR II beademingsapparaat-uitvoering met inademklep is verkrijgbaar in de maten voor volwassenen en kinderen en kan met of zonder inademklep worden gebruikt. Het apparaat wordt geleverd met een aan te sluiten zuurstofreservoirzak.

De inlaatklep van het Ambu SPUR II beademingsapparaat wordt via een adapter op de inademklep aangesloten.

Bevestiging van de inademklep:

- Verwijder de zuurstofreservoireenheid van de inlaatklep van het Ambu SPUR II beademingsapparaat, indien aangesloten.

- Bevestig de adapter aan het inademklepsysteem.
- Steek de adapter van de inademklep in de inlaatklep van het Ambu SPUR II beademingsapparaat.

OPMERKING: Gebruik alleen het onderdeel met het label 'compressie-eenheid' met de adapter en de inademklep. Het onderdeel met het label 'Zuurstofreservoirzak' wordt beschouwd als reserveonderdeel als de inademklep faalt.

Toediening van zuurstof

Dien zuurstof toe conform de medische indicatie.

De afbeelding 6 toont de berekende toegediende zuurstofpercentages die kunnen worden verkregen met verschillende beademingsvolumes en -frequenties bij verschillende gasstroomsnelheden. De zuurstofpercentages zijn te zien bij 6 Volwassenen 6.1, Kinderen 6.2, Zuigelingen 6.3.

Zuurstofreservoirzak 7

De dunne plastic folie van de zuurstofreservoirzak kan op geen enkel moment worden losgemaakt van het bevestigingspunt ervan op het beademingsapparaat.

Accessoires 8

De Ambu SPUR II beademingsapparaatconnectors volgen ISO 5356-1 EN EN 13544-2, en zijn hierdoor compatibel met andere ziekenhuisapparatuur. Bij toepassing ervan op externe apparaten moet u zorgen dat u de functionaliteit test en dat u de gebruiksaanwijzing leest die met het externe apparaat is meegeleverd.

Ambu-producten die compatibel zijn met het Ambu SPUR II beademingsapparaat worden hieronder vermeld:

Ambu® Disposable Beademingsmasker

Raadpleeg voor nadere informatie de gebruiksaanwijzingen van het Ambu disposable beademingsmasker.

De Ambu® disposable PEEP 20-klep 8.1 8.2

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de Ambu Disposable PEEP 20-klep of raadpleeg de afbeelding 8.1 in deze gebruiksaanwijzing. Verwijder de spatbescherming om de Ambu Disposable PEEP 20-klep (indien nodig) op het beademingsapparaat te bevestigen. 8.2

Ambu® Disposable Drukmeter Manometer 8.3

Raadpleeg voor nadere informatie de gebruiksaanwijzingen van de Ambu disposable drukmeter.

4.4. Na gebruik

Gebruikte producten moeten in overeenstemming met de lokale procedures worden afgevoerd.

5. Technische productspecificaties

5.1. Toegepaste normen

Het Ambu SPUR II beademingsapparaat is in overeenstemming met de productspecifieke norm EN ISO 10651-4.

5.2. Specificaties

	Peuter	Pediatrisch	Volwassene
Volume beademingsapparaat	ongeveer 220 ml	ongeveer 670 ml	ongeveer 1.510 ml
Geleverd volume met één hand*	150 ml	450 ml	600 ml
Geleverd volume met twee handen*	-	-	1000 ml
Afmetingen (lengte x diameter) zonder reservoir en accessoire	ongeveer 190 x 71 mm	ongeveer 223 x 99 mm	ongeveer 284 x 127 mm

	Peuter	Pediatrisch	Volwassene		
Gewicht zonder reservoir en accessoire	ongeveer 70 g	ongeveer 145 g	ongeveer 220 g		
Drukbegrenzingsklep**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)		
Dode ruimte	≤ 5 ml + 10% van het geleverde volume	≤ 5 ml + 10% van het geleverde volume	≤ 5 ml + 10% van het geleverde volume		
Inspiratoire weerstand***	max. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) bij 5 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) bij 50 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) bij 50 l/min		
Expiratoire weerstand***	max. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) bij 5 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) bij 50 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) bij 50 l/min		
Reservoirvolume	ongeveer 300 ml (zak) ongeveer 100 ml (buis)	ongeveer 2600 ml (zak)	ongeveer 2.600 ml (zak)		
Patiëntconnector	Buiten 22 mm mannelijk (ISO 5356-1) Binnen 15 mm vrouwelijk (ISO 5356-1)				
Expiratieconnector (voor bevestiging van PEEP-klep)	30 mm mannelijk (ISO 5356-1)				
Connector drukmeterpoort	Ø 4,2 +/- 0,1 mm				
Inademklepconnector	-	Binnen 32 mm vrouwelijk (ISO 10651-4)			
Lekkage voorwaarts en achterwaarts	Niet meetbaar				
M-Port	Connector compatibel met EN ISO 80369-7				
O ₂ -inlaatconnector	Conform EN 13544-2				
Gebruikstemperatuurlimieten	-18 °C tot +50 °C (-0,4 °F tot +122 °F), getest conform EN ISO 10651-4				
Opslagtemperatuurlimieten	-40 °C tot +60 °C (-40 °F tot +140 °F), getest conform EN ISO 10651-4				
Aanbevolen voor langdurige opslag in gesloten verpakking bij kamertemperatuur, uit de buurt van zonlicht.					

* Getest conform EN ISO 10651-4.

** Een hogere aanvoerdruk kan worden verkregen door de drukbegrenzingsklep tijdelijk uit te schakelen.

*** Onder algemene testomstandigheden volgens EN ISO 10651-4.



5.3. MRI-veiligheidsinformatie

Het Ambu SPUR II beademingsapparaat en het Ambu SPUR II beademingsapparaat met aangesloten Ambu Disposable PEEP 20 klep² en het Ambu SPUR II beademingsapparaat met aangesloten Ambu Disposable PEEP 20-klep en Ambu Disposable Drukmeter² zijn onder de volgende voorwaarden MR-veilig en kunnen daarom veilig worden gebruikt in een MR-omgeving (niet in de MR-boring) onder de volgende omstandigheden.

Statisch magnetisch veld van 7 tesla en minder, met

- Maximale spatiële veldgradiënt van
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²
- Maximaal krachtproduct van
 - 450.000.000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G²/cm (721 T²/m)²

Gebruik in de MR-boring kan de kwaliteit van het MR-beeld beïnvloeden.

RF-geïnduceerde verwarming en MR-beeldartefacten zijn niet getest. Metalen onderdelen zijn volledig ingekapseld en maken geen contact met het menselijk lichaam.

1. Viktig informasjon – Les før bruk

Les disse sikkerhetsanvisningene nøyde før du bruker Ambu® SPUR® II ventilasjonsbag. Bruksanvisningen kan bli oppdatert uten varsel. Kopi av den nyeste versjonen kan skaffes på forespørsel. Vær oppmerksom på at denne bruksanvisningen ikke forklarer eller beskriver kliniske prosedyrer. Den inneholder bare en beskrivelse av de grunnleggende funksjonene og forholdsreglene som er forbundet med bruken av ventilasjonsbagen. Før ventilasjonsbagen tas i bruk for første gang, er det meget viktig at brukeren har gjennomført tilstrekkelig opplæring i kliniske ventileringsteknikker og er kjent med tiltenkt bruk, advarsler, forholdsregler og kontraindikasjoner som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Det er ikke garanti på Ambu SPUR II ventilasjonsbag.

1.1. Bruksområde

Ambu SPUR II ventilasjonsbag er en engangs ventilasjonsbag ment for hjerte-lungeredning.

1.2. Bruksindikasjoner

Ambu SPUR II ventilasjonsbag er ment for bruk i situasjoner der manuell hjerte-lungeredning er nødvendig for assistert ventilasjon.

Ambu SPUR II ventilasjonsbag er indisert for ventilering og oksygenering av pasienter til en mer permanent luftvei kan etableres eller pasienten kan puste på egen hånd.

1.3. Tiltenkt pasientgruppe

Bruksområdet for hver utgave er som følger:

- **Voksen:** Voksne og barn med en kroppsvekt på mer enn 30 kg (66 lb).
- **Barn:** Spedbarn og barn med en kroppsvekt fra 6 kg til 30 kg (13 – 66 lb).
- **Spedbarn:** Spedbarn og småbarn med en kroppsvekt på opptil 10 kg (22 lb).

Vær oppmerksom på at ikke alle konfigurasjoner av Ambu SPUR II ventilasjonsbag er tilgjengelige for alle tre pasientgrupper.

1.4. Tiltenkte brukere

Helsepersonell med opplæring i håndtering av luftveiene, som anestesileger, sykepleiere, redningspersonell og akuttpersonell.

1.5. Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

1.6. Kliniske fordeler

Den grunnleggende teknikken for luftveishåndtering ved bruk av en manuell ventilasjonsbag gjør det mulig å ventilere og oksygenerere pasienter til en mer permanent luftvei kan etableres eller pasienten kan puste på egen hånd.

1.7. Advarsler og forholdsregler

Hvis disse forholdsreglene ikke følges, kan det føre til ineffektiv ventilering og oksygenering av pasienten eller skade på utstyret.

ADVARSLER

1. Ikke bruk ventilasjonsbagen i mer enn 4 akkumulerte timer over et tidsrom på maksimalt 1 uke, for å unngå infeksjonsrisiko.
2. Ventilasjonsbagen må ikke gjenbrukes hvis det er synlig fuktighet eller rester inne i enheten, for å unngå risiko for infeksjon og funksjonsfeil.
3. Kontroller at enten sprutvernet eller Ambu PEEP-ventilen er koblet til ekspirasjonsporten. En åpen ekspirasjonsport kan blokkeres ved et uhell og føre til for stort luftvolum i lungene, noe som kan føre til vevsskade.
4. Unngå bruk av ventilasjonsbagen i giftige eller farlige miljøer, for å unngå risiko for vevsskade.

5. Sørg alltid for at oksygenreservoarslangen ikke er blokkert. Blokering av slangen kan hindre at kompresjonsposen blåses opp igjen, noe som kan føre til at ventilasjon ikke er mulig.
6. Ikke bruk produktet hvis det er kontaminert av eksterne kilder, da dette kan forårsake infeksjon.
7. Inspiser alltid produktet visuelt og utfør en funksjonstest etter utpakking, montering og før bruk. Defekter og fremmedlegemer kan føre til ingen eller redusert ventilasjon av pasienten.
8. Ikke bruk produktet hvis funksjonstesten mislykkes. Det kan føre til ingen eller redusert ventilasjon.
9. Trykkgrensningsventilen må ikke overstyres med mindre en medisinsk vurdering indikerer at det er nødvendig. Høyt ventilasjonstrykk kan forårsake barotraume.
10. Kun til engangsbruk. Bruk på andre pasienter kan forårsake kryssinfeksjon.
11. Legemidler kan ikke leveres gjennom M-porten hvis tilbehør (f.eks. filter, CO₂-detektor) er koblet mellom ventilasjonsbagen og ansiktsmasken.
12. Ikke la M-porten stå åpen etter bruk, for å unngå lekkasje som kan føre til redusert O₂-levering til pasienten.
13. M-porten må ikke brukes til sidestrøms EtCO₂-måling av pasienter som ventileres med et respirasjonsvolum på under 400 ml, for å unngå unøyaktige EtCO₂-målinger.
14. Ved administrering av medikament med et volum under 1 ml, må M-porten skylles for å sikre nøyaktig levering av medikamentdosering.
15. Ikke koble oksygenforsyningsslangen til M-porten. Det fører til at tiltenkt O₂-konsentrasjon ikke blir levert til pasienten.
16. Bruk av tilbehør kan øke motstanden ved innånding eller utånding. Bruk ikke tilbehør hvis økt pustemotstand kan være skadelig for pasienten.
17. Skal kun brukes av tiltenkte brukere som er kjent med innholdet i denne håndboken. Feil bruk kan skade pasienten.
18. Ved bruk av oksygentilførsel er det ikke tillatt å røyke eller bruke utstyret nær åpen ild, olje, fett, andre brannfarlige kjemikalier eller utstyr og verktøy som kan forårsake gnister på grunn av brann- og/eller ekspløsjonsfare.
19. Ikke forsøk å feste en behovsventil til spedbarnsversjonen. Det kan forårsake høye oksygenkonsentrasjoner, som kan være skadelige for nyfødte.
20. Vær oppmerksom på tegn på fullstendig/delvis obstruksjon av øvre luftveier hvis ventilasjonsbagen brukes med en ansiktsmaske, da dette vil føre til ingen eller begrenset oksygentilførsel. Bytt alltid til et alternativ til ansiktsmaske for å forsyne luft til pasienten, hvis tilgjengelig.
21. Ikke bruk produktet med påsatt ansiktsmaske ved ventilering av spedbarn med medfødt diafragmabrokk, på grunn av risikoen for insufflasjon. Bytt til et alternativ til ansiktsmaske for å forsyne luft til pasienten, hvis tilgjengelig.
22. Fagpersonene som utfører prosedyren, må vurdere valg av størrelse på ventilasjonsbag og tilbehør (f.eks. ansiktsmaske, PEEP-ventil osv.) i samsvar med pasientens spesifikke tilstand(er), da feil bruk kan skade pasienten.
23. Ikke bruk Ambu SPUR II når levering av oksygen med fri flow er nødvendig, på grunn av mulig utilstrekkelig administrering av oksygen, noe som kan føre til hypoksi.
24. Manometerhetten må alltid settes på manometerporten når trykket ikke overvåkes, for å unngå lekkasje, noe som kan føre til redusert O₂-forsyning til pasienten.
25. Fest alltid oksygenslangen til oksygenforsyningen på forhånd ved temperaturer over 0 °C, ettersom montering kan bli vanskelig ved temperaturer under 0 °C, noe som fører til redusert oksygentilførsel til pasienten.
26. Ved bruk av ventilasjonsbagen med påsatt ansiktsmaske må riktig plassering og forsegling av ansiktsmasken sikres, da feil forsegling kan føre til spredning av luftbårne smittsom sykdom for brukeren.

FORSIKTIGHETSREGLER

- Oppbevar aldri ventilasjonsbagen i deformert tilstand, bortsett fra når den er brettet slik den ble levert fra produsenten. Ellers kan bagen bli permanent deformert, noe som kan redusere ventilasjonseffektiviteten. Bretteområdet er lett synlig på bagen (kun voksne- og barnemodellene kan brettes)
- Observer alltid at brystet beveger seg, og lytt etter den utgående luftstrømmen fra ventilen for å kontrollere at ventilen fungerer som den skal. Bytt umiddelbart til munn-til-munn-ventilering hvis ventilering med ventilasjonsbag ikke kan oppnås.
- Apparatet må ikke bløtlegges, skylles eller steriliseres. Slike prosedyrer kan etterlate skadelige rester eller forårsake funksjonsfeil på apparatet. Konstruksjonen og materialene som er brukt, er ikke forlikelige med konvensjonelle rengjørings- og steriliseringsprosedyrer.
- Bruk M-porten kun til ett av de to følgende alternativene: EtCO₂-måling eller medikamentadministrering, da dette kan endre de målte verdiene.
- Se om nødvendig emballasjen på tilbehøret for mer spesifikk informasjon om det individuelle tilbehøret. Feil håndtering kan føre til funksjonsfeil på hele produktet.
- Bruk av tredjepartsprodukter og oksygenforsyningsutstyr (f.eks. filtre og behovsventiler) med Ambu SPUR II ventilasjonsbag kan påvirke produktets ytelse. Rådfør deg med produsenten av tredjepartenheten for å kontrollere kompatibiliteten med Ambu SPUR II ventilasjonsbag og få informasjon om mulige endringer i ytelse.
- Oksygenreservoarbagen er permanent festet til inntaksventilen på ventilasjonsbager for voksne og barn, unntatt på versjonen med behovsventil. Den skal ikke demonteres. Ikke trekk i oksygenreservoarbagen, da dette kan føre til funksjonsfeil på enheten.

1.8. Potensielle bivirkninger

Potensielle bivirkninger forbundet med gjenoppliving (ikke utfyllende): barotraume, volutraume, hypoksi, hyperkapni og aspirasjonspneumoni.

1.9. Generelle merknader

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av enheten eller som følge av bruk, skal det rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

2. Beskrivelse av utstyr

Ambu SPUR II ventilasjonsbag kan kobles til Ambu® trykkmanometer til engangsbruk, Ambu® PEEP ventiler og Ambu® ansiktmasker, som beskrevet i avsnitt 4.3 Bruke ventilasjonsbagen.

3. Symbolforklaring

Symbolindikasjon	Beskrivelse
	Voksen Tiltenkt ideell kropsvekt over 30 kg
	Barn Tiltenkt ideell kropsvekt fra 6 til 30 kg
	Spedbarn Tiltenkt ideell kropsvekt opptil 10 kg
	MR-betinget
	Produksjonsland

Symbolindikasjon	Beskrivelse
	Medisinsk utstyr
	Til bruk flere ganger for én pasient
	Ikke trekk i oksygenreservoarbagen med makt

En fullstendig liste over symbolforklaringer er tilgjengelig på
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Bruksområde

4.1. Funksjonsprinsipp

Illustrasjonen 1 viser ventileringsgassens strøm inn i bagen, samt til og fra pasienten under manuell bruk av ventilasjonsbagen. 1a Ventilasjonsbag for voksne og barn, 1b ventilasjonsbag for spedbarn med lukket oksygenreservoarbag (bagreservoar), 1c ventilasjonsbag for spedbarn med åpen oksygenreservoarslange (tuberreservoar).

Gasstrømmen er tilsvarende når pasienten puster spontant gjennom enheten.

Oksygenreservoaret er utstyrt med to ventiler, der den ene slipper inn luft fra omgivelsene når reservoaret er tomt, og den andre slipper ut overflødig oksygen når reservoarbagen er tom.

M-porten gir tilgang til gasstrømmen for inn- og utånding slik at en sprøyte kan kobles til for å administrere medikamenter 1d eller for å koble til en gassprøvelinje for sidestroms måling av EtCO₂ 1e.

- 1.1 Utslipp av overskytende oksygen, 1.2 luftinntak, 1.3 oksygeninntak, 1.4 pasientkobling, 1.5 ekspirasjon, 1.6 manometerport, 1.7 trykkgrensende ventil, 1.8 M-port.

MERK: Enten et sprutvern eller en PEEP-ventil kan være koblet til 1.5.

4.2. Inspeksjon og klargjøring

Ventilasjonsbagen må pakkes ut og klargjøres (inkludert en funksjonstest) for umiddelbar bruk før den settes klar til bruk i nødssituasjoner.

4.2.1. Klargjøring

- Hvis ventilasjonsbagen er pakket sammenslått, felles den ut ved å trekke i pasientventilen og inntaksventilen.
- Klargjør ventilasjonsbagen og plasser alle delene i bærevesken som følger med ventilasjonsbagen.
- Hvis ansiktsmasken som leveres med ventilasjonsbagen er pakket i en beskyttelsespose, må posen fjernes før bruk.

Se avsnitt 4.2.2. (Oksygenslange) for klargjøring av enheten før bruk i temperaturer under 0 °C.

4.2.2. Funksjonstest 2

Ventilasjonsbag

Lukk trykkgrensningsventilen med overstyringsklemmen, og lukk pasientkoblingen med tommelen 2.1. Klem raskt og bestemt på den komprimerbare bagen. Ventilasjonsbagen skal motstå klemmingen.

Åpne trykkgrensningsventilen ved å skyve bort overstyringsklemmen og gjenta prosedyren. Trykkgrensningsventilen skal nå aktiveres, og det skal være mulig å høre luftstrømmen fra ventilen når den komprimerbare bagen komprimeres raskt.

Klem sammen og slipp ventilasjonsbagen noen ganger for å sikre at luften føres gjennom ventilsystemet og ut av pasientventilen. **2.2**

MERK: En svak lyd kan høres når ventilskivene beveger seg under funksjonstest eller under ventilering. Dette går ikke ut over ventilasjonsbagens funksjonalitet.

Oksygenslange

Montering av oksygenslangen og funksjonstest av oksygenreservoarbagen og oksygenreservoarslangen skal utføres ved temperaturer over 0 °C. La oksygenslangen være tilkoblet oksygenforsyningen etter funksjonstesten hvis ventilasjonsbagen skal brukes ved temperaturer under 0 °C.

Oksygenreservoarbag

Tilfør en gassflow på 10 l/min ved oksygeninntakskoblingen. Bruk eventuelt hånden til å hjelpe bagen å felles ut. Kontroller at oksygenreservoarbagen fylles. Hvis ikke, kontroller tilstanden til de to ventillukkerne eller om det er en rift i reservoaret.

Juster deretter den leverte gasstrømmen i henhold til medisinsk indikasjon.

Oksygenreservoarslange

Tilfør en gassflow på 10 l/min ved oksygeninntakskoblingen. Kontroller at oksygen strømmer ut av enden på oksygenreservoarslangen. Hvis ikke kontrollerer du om oksygenslangen er blokkert. Juster deretter den leverte gasstrømmen i henhold til medisinsk indikasjon.

M-port

Fjern hetten fra M-porten og blokker pasientkoplingen. Klem på bagen og lytt etter lyden av luft som presses ut gjennom M-porten. **2.3**

4.3. Bruke ventilasjonsbagen

- Bruk anbefalt teknikk til å kontrollere pasientens munn og luftveier, og til å posisjonere pasienten riktig for å åpne luftveiene.
- Hold ansiktmasken fast mot pasientens ansikt. **3.1**
- Før hånden (voksen utgave) eller ring- og langfingeren (barneutgave) under håndtaket. Spedbarnsversionen har ikke støttehåndtak. Ventilasjon uten å bruke støttehåndtaket kan oppnås ved å vende posen. **3.2** Ventilering av pasienten: Kontroller at pasientens brystkasse hever seg under innblåsing. Slipp brått hånden som holder bagen, lytt etter den utgående luftstrømmen fra pasientventilen, og kontroller visuelt at brystet senkes.
- Hvis du opplever vedvarende motstand ved innblåsing, kontrollerer du luftveiene for obstruksjon og posisjonerer pasienten på nytt for å sikre åpne luftveier.
- Hvis pasienten kaster opp under ventilasjon, må pasientens luftveier umiddelbart åpnes og oppkastet fjernes fra ventilasjonsbagen ved å riste og komprimere den kraftig og raskt flere ganger før ventilering gjenopptas. Tørk om nødvendig av produktet med en klut som inneholder alkohol, og rengjør sprutvernet med vann.

Manometerport

Ambu trykkmometer for engangsbruk eller trykkmåler fra tredjepart kan festes til manometerporten, som sitter øverst på pasientventilen. Fjern hetten og fest manometeret/trykkmåleren

Trykkbegrensende system **4**

Trykkbegrensningsventilen er satt til å åpne ved 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Hvis medisinsk og profesjonell vurdering indikerer at et trykk på mer enn 40 cm H₂O er nødvendig, kan den trykkbegrensende ventilen overstyres ved å flytte overstyringsklemmen inn på ventilen. **4.2**

Alternativt kan den trykkgrensende ventilen overstyres ved å holde en finger på den røde knappen mens bagen klemmes.

M-port

Ambu SPUR II ventilasjonsbag leveres med eller uten M-port. M-porten gir tilgang til inspiratorisk og ekspiratorisk gassflow, og kan brukes til å gi legemidler ved å koble den til en sprøyte, samt til å måle sidestroms CO₂ (EtCO₂). Husk å lukke M-porten med den røde M-porthetten når den ikke er i bruk.

Måle EtCO₂

For måling av sidestroms EtCO₂: Koble gassprøveslangen for EtCO₂-måleenheten til M-porten på Ambu SPUR II ventilasjonsbag. Koble til kontakten på gassprøveslangen ved å montere og rotere den 1/4 omdreining med klokken.

Gi medisin

Pasientens reaksjon på den gitte medisinen må observeres nøyne. Administrasjon av mengder på 1 ml væske eller høyere gjennom M-porten kan sammenlignes med tilføring direkte inn i en endotrakealtube. M-porten er testet med epinefrin, lidokain og atropin.

Ambu SPUR II ventilasjonsbag, versjon med behovsventil 5

Ambu SPUR II ventilasjonsbag med behovsventil er tilgjengelig i voksen- og pediatrisk størrelse, og kan brukes med eller uten behovsventil og leveres med en oksygenreservoarbag som kan kobles til.

Inntaksventilen på Ambu SPUR II ventilasjonsbag kobles til behovsventilen via en adapter.

Montering av behovsventilen:

- Fjern oksygenreservoarenheten fra inntaksventilen på Ambu SPUR II-ventilasjonsbagen, hvis denne er montert.
- Fest adapteren til behovsventilsystemet.
- Sett tilførselventiladapteren inn i inntaksventilen på Ambu SPUR II-ventilasjonsbagen.

MERK: Bruk bare deler som er merket med "compression unit" (kompressjonsenhett) sammen med adapter og behovsventil. Delen som er merket "Oxygen reservoir bag" (oksigenreservoarbag) anses som reserve hvis behovsventilen svikter.

Administrering av oksygen

Administrerer oksygen ifølge medisinske indikasjoner.

Illustrasjonen 6 viser beregnet levert oksygenprosent som kan oppnås med ulike ventilasjonsvolumer og frekvenser ved ulike gassflowhastigheter. Oksygenprosenten kan ses hos 6 voksne 6.1, barn 6.2, spedbarn 6.3.

Oksygenreservoarbag 7

Oksygenreservoarbagen i tynn plastfolie skal aldri løsnes fra festepunktet på ventilasjonsbagen.

Tilbehør 8

Koblingene på Ambu SPUR II ventilasjonsbag følger ISO 5356-1 og EN 13544-2, slik at den er kompatibel med annet sykehusutstyr. Hvis eksterne enheter kobles til ventilasjonsbagen, må de testes for funksjonalitet, og bruksanvisningen som følger med den eksterne enheten, må konsulteres.

Ambu-produkter som er kompatible med Ambu SPUR II ventilasjonsbag, er angitt nedenfor:

Ambu® engangsansiktsmasker

Se mer informasjon i bruksanvisningen for Ambu ansiktmaske for engangsbruk.

Ambu® PEEP 20-ventil for engangsbruk 8.1 8.2

Se ytterligere informasjon i bruksanvisningen for Ambu PEEP 20-ventilen for engangsbruk, eller se illustrasjonen 8.1 i denne bruksanvisningen. Fjern sprutbeskyttelsen for å montere Ambu PEEP 20 engangsventil (om nødvendig) på ventilasjonsbagen. 8.2

Ambu® trykkmanometer til engangsbruk 8.3

Se bruksanvisningen for Ambu trykkmanometer for engangsbruk for mer informasjon.

4.4. Etter bruk

Brukte produkter skal kastes i henhold til lokale prosedyrer.

5. Tekniske produktspesifikasjoner

5.1. Anvendte standarder

Ambu SPUR II ventilasjonsbag er i samsvar med produktstandarden EN ISO 10651-4.

5.2. Spesifikasjoner

	Spedbarn	Barn	Voksen
Ventilasjonsbag volum	ca. 220 ml	ca. 670 ml	ca. 1510 ml
Administrert volum, én hånd*	150 ml	450 ml	600 ml
Administrert volum, to hender*	-	-	1000 ml
Mål (lengde x diameter) uten reservoar og tilbehør	ca. 190 x 71 mm	ca. 223 x 99 mm	ca. 284 x 127 mm
Vekt uten reservoar og tilbehør	ca. 70 g	ca. 145 g	ca. 220 g
Trykkgrensende ventil**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Ubrukt plass	≤ 5 ml + 10 % av levert volum	≤ 5 ml + 10 % av levert volum	≤ 5 ml + 10 % av levert volum
Innåndingsmotstand***	maks 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) ved 5 l/min	maks 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) ved 50 l/min	maks 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) ved 50 l/min

	Spedbarn	Barn	Voksen
Utåndingsmotstand***	maks 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) ved 5 l/min	maks 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) ved 50 l/min	maks 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) ved 50 l/min
Reservoarvolum	ca. 300 ml (bag) maks. 100 ml (tube)	ca. 2600 ml (bag)	ca. 2600 ml (bag)
Pasientkopling		Utvendig 22 mm hann (ISO 5356-1) Innvendig 15 mm hunn (ISO 5356-1)	
Utåndingskoppling (for PEEP-ventiltilbehør)		30 mm hann (ISO 5356-1)	
Manometerport-kopling		Ø 4,2 +/- 0,1 mm	
Behovsventilkoppling	-	Innvendig 32 mm hunn (ISO 10651-4)	
Lekkasje forover og bakover		Ikke målbar	
M-port		Kontakt kompatibel med EN ISO 80369-7	
O ₂ -innatkskoppling		Ifølge EN 13544-2	
Oppbevaringstemperatur		-18 °C til +50 °C (-0,4 °F til +122 °F), testet i samsvar med EN ISO 10651-4	
Temperaturområde ved oppbevaring		-40 °C til +60 °C (-40 °F til +140 °F), testet i samsvar med EN ISO 10651-4	
Anbefalt langtidslagring i lukket emballasje ved romtemperatur, beskyttet mot sollys.			

* Testet i samsvar med EN ISO 10651-4

** Høyere forsyningstrykk kan oppnås ved å overstyre den trykkgrensende ventilen.

*** Ved generelle testforhold i henhold til EN ISO 10651-4.

5.3. MR-sikkerhetsinformasjon



Ambu SPUR II ventilasjonsbag¹ og Ambu SPUR II ventilasjonsbag med tilkoblet Ambu PEEP 20-ventil² til engangsbruk og Ambu SPUR II ventilasjonsbag med tilkoblet Ambu PEEP 20-ventil til engangsbruk og Ambu trykkmanometer² er MR-sikre under følgende forhold, og kan derfor brukes trygt i MR-miljøet (ikke inne i MR-tunnelen) under følgende forhold.

Statisk magnetfelt på 7 Tesla og mindre, med

- Maksimal romlig feltgradient på
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Maksimalt kraftprodukt på
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Bruk innenfor MR-tunnelen kan påvirke MR-bildekvaliteten.

RF-indusert oppvarming og MR-bildeartefakter er ikke testet. Eventuelle metalldeler er helt innkapslet og har ikke kontakt med menneskekroppen.

1. Ważne informacje – Przeczytać przed użyciem

Przed użyciem resuscytatora Ambu® SPUR® II należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję dotyczącą bezpieczeństwa. Może one zostać zaktualizowana bez uprzedniego powiadomienia. Kopie bieżącej wersji są dostępne na życzenie. Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja nie objęła ani nie omawia zabiegów klinicznych. Opisano tu tylko podstawowe zasady działania i środki ostrożności związane ze stosowaniem resuscytatora. Przed pierwszym użyciem resuscytatora użytkownik musi zostać odpowiednio przeszkolony w zakresie technik resuscytacji i zapoznać się z przeznaczeniem urządzenia oraz wszystkimi ostrzeżeniami, środkami ostrożności i wskazaniami podanymi w niniejszej instrukcji. Resuscytator Ambu SPUR II nie jest objęty gwarancją.

1.1. Przeznaczenie

Ambu SPUR II to resuscytator do użytku u indywidualnych pacjentów przeznaczony do resuscytacji oddechowej.

1.2. Wskazania dotyczące użycia

Resuscytator Ambu SPUR II jest przeznaczony do użycia w sytuacjach, gdy do wentylacji wspomaganej potrzebny jest ręczny resuscytator krążeniowo-oddechowy.

Resuscytator Ambu SPUR II jest wskazyany do wentylacji i natleniania pacjentów do momentu zapewnienia bardziej stabilnego wsparcia dróg oddechowych lub ustąpienia objawów.

1.3. Docelowa populacja pacjentów

Zakres zastosowania poszczególnych wersji jest następujący:

- Wersja dla dorosłych:** Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg (66 funtów).
- Wersja pediatryczna:** Niemowlęta i dzieci o masie ciała od 6 kg do 30 kg (13-66 funtów).
- Wersja dla niemowląt:** Noworodki i niemowlęta o masie ciała nieprzekraczającej 10 kg (22 funty).

Należy pamiętać, że nie wszystkie konfiguracje resuscytatora Ambu SPUR II są dostępne dla wszystkich trzech typów pacjentów.

1.4. Docelowi użytkownicy

Specjalisi opieki zdrowotnej przeszkołeni w zakresie udrażniania dróg oddechowych, m.in. anestezjolodzy, pielęgniarki, personel ratunkowy i personel izby przyjęć.

1.5. Przeciwskazania

Brak poznanych.

1.6. Korzyści kliniczne

Podstawowa technika udrażniania dróg oddechowych z użyciem resuscytatora ręcznego umożliwia wentylację i natlenianie pacjentów do momentu zapewnienia bardziej stabilnego wsparcia dróg oddechowych lub ustąpienia objawów.

1.7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nieprzestrzeganie tych środków ostrożności może powodować nieskuteczną wentylację i natlenienie pacjenta lub uszkodzenie sprzętu.

OSTRZEŻENIA

1. Aby uniknąć ryzyka zakażenia, resuscytatora nie należy używać przez więcej niż 4 godziny w maksymalnym okresie 1 tygodnia.
2. Nie używać resuscytatora ponownie, jeśli w jego wnętrzu pozostaje widoczna wilgoć lub pozostałości, aby uniknąć ryzyka zakażenia i nieprawidłowego działania.
3. Upewnić się, że do portu wydechowego podłączona jest osłona przeciwbrzyzgowa lub zawór Ambu PEEP. Otwarty port wydechowy może się przypadkowo zablokować i spowodować przedostanie się do płuc nadmiernej objętości powietrza, co może prowadzić do urazu.
4. Unikać stosowania resuscytatora w toksycznym lub niebezpiecznym środowisku, aby nie doprowadzić do uszkodzenia tkanek.

5. Zawsze upewnić się, że przewód zbiornika tlenu nie jest zablokowany, ponieważ zablokowanie przewodu może uniemożliwić ponowne napełnienie worka kompresyjnego i uniemożliwić wentylację.
6. Nie używać produktu zanieczyszczonego przez źródła zewnętrzne, ponieważ może to prowadzić do infekcji.
7. Po rozpakowaniu, złożeniu i przed użyciem należy zawsze sprawdzić wzrokowo produkt i przeprowadzić test działania, ponieważ jego uszkodzenia i ciała obce mogą spowodować brak wentylacji lub ją ograniczyć.
8. Nie używać produktu w przypadku niezaliczenia testu działania, ponieważ może to spowodować brak wentylacji lub mniejszą wentylację pacjenta.
9. Nie blokować zaworu ograniczającego ciśnienie, chyba że w wyniku profesjonalnej medycznej oceny sytuacji zostanie stwierdzona taka konieczność. Wysokie ciśnienie wentylacji może spowodować uraz ciśnieniowy.
10. Wyrób przeznaczony do użytku wyłącznie u jednego pacjenta. Zastosowanie u innego pacjenta może doprowadzić do zakażenia krzyżowego.
11. Leki nie mogą być podawane przez M-port, jeśli akcesoria (np. filtr, detektor CO₂) są podłączone między resuscytatorem a maską twarzową.
12. Nie pozostawiać otwartego M-Portu po użyciu, aby uniknąć wycieku, który mógłby doprowadzić do zmniejszenia dostaw O₂ do pacjenta.
13. M-Portu nie należy używać do monitorowania EtCO₂ w strumieniu bocznym u pacjentów wentylowanych z objętością oddechową mniejszą niż 400 ml, aby uniknąć nieprecyzyjnych pomiarów EtCO₂.
14. W przypadku podawania leku o objętości poniżej 1 ml należy przepłukać M-Port, aby zapewnić podanie dokładnej dawki leku.
15. Nie podłączać przewodów doprowadzających tlen do M-Portu, ponieważ O₂ o zamierzonym stężeniu nie zostanie dostarczony pacjentowi.
16. Dodanie akcesoriów może zwiększyć opór wdechowy i/lub wydechowy. Nie należy dodawać akcesoriów, jeśli zwiększyony opór oddechowy mógłby być szkodliwy dla pacjenta.
17. Do użytku tylko przez osoby, które zapoznały się z treścią niniejszej instrukcji, ponieważ nieprawidłowe użycie może spowodować obrażenia u pacjenta.
18. Ze względu na ryzyko pożaru i/lub wybuchu podczas korzystania z dodatkowego źródła tlenu nie wolno palić tytoniu ani używać urządzeń w pobliżu otwartego ognia, oleju, smaru, innych łatwopalnych chemikaliów lub urządzeń i narzędzi, które mogą wywołać iskrzenie.
19. Nie należy podłączać zaworu dozującego do wersji dla niemowląt, ponieważ może to spowodować wysokie stężenie tlenu, które może być szkodliwe dla noworodków.
20. Podczas korzystania z resuscytatora przymocowanego do maski twarzowej należy zwracać uwagę na oznaki całkowitej/częściowej niedrożności górnych dróg oddechowych, ponieważ powoduje ona brak podaży tlenu lub jej ograniczenie. W miarę możliwości do dostarczania powietrza zawsze stosować inne rozwiązania niż maska twarzowa.
21. Nie używać produktu z maską twarzową do wentylacji niemowląt z wrodzoną przepukliną przeponową ze względu na ryzyko insuflacji. W miarę możliwości do dostarczania powietrza stosować inne rozwiązania niż maska twarzowa.
22. Specjalisiści wykonujący zabieg powinni dobrać rozmiar resuscytatora i akcesoria (np. maska twarzowa, zawór PEEP itp.) odpowiednio do pacjenta, ponieważ nieprawidłowe użycie może prowadzić do obrażeń u pacjenta.
23. Nie należy używać urządzenia Ambu SPUR II, jeśli wymagane jest podanie tlenu w swobodnym przepływie, gdyż możliwa niewystarczająca podaż tlenu może prowadzić do hipoksyji.
24. Gdy ciśnienie nie jest monitorowane, należy zawsze założyć zatyczkę manometru na port manometru, aby uniknąć wycieku, który może doprowadzić do zmniejszonego podania O₂ do pacjenta.
25. Zawsze podłączać rurkę tlenową do źródła tlenu w temperaturze powyżej 0 °C, ponieważ jej podłączanie może być utrudnione w temperaturach poniżej 0 °C, co prowadzi do zmniejszenia dopływu tlenu do pacjenta.
26. Używając resuscytatora z maską twarzową, należy prawidłowo założyć i uszczelnić maskę, ponieważ niewłaściwe uszczelnienie może prowadzić do narażenia użytkownika na infekcje przenoszące się drogą powietrzną.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Jedynym dopuszczalnym sposobem składania resuscytatora jest sposób przewidziany przez producenta. W przeciwnym razie worek może ulec trwałemu zniekształceniu, co może obniżyć skuteczność wentylacji. Prawidłowe miejsca zgięcia są wyraźnie widoczne na worku (składać można tylko wersje dla dorosłych i pediatryczną).
2. Aby kontrolować skuteczność wentylacji, należy zawsze obserwować ruchy klatki piersiowej i słuchać przepływu powietrza wydychanego przez zawór pacjenta. Jeśli urządzenie nie zapewnia właściwego poziomu wentylacji, należy natychmiast przystąpić do wentylacji metodą usta-usta.
3. Nie należy moczyć, płukać ani sterylizować urządzenia, ponieważ może to spowodować pozostawienie szkodliwych osadów lub nieprawidłowe działanie urządzenia. Konstrukcja i użyte materiały nie są zgodne z konwencjonalnymi metodami czyszczenia i sterylizacji.
4. M-Port może być używany tylko do jednego z dwóch celów: pomiarów EtCO₂ lub podawania leku, ponieważ może to wpływać na wartość pomiaru.
5. W razie potrzeby informacje na temat poszczególnych akcesoriów można znaleźć na opakowaniu. Nieprawidłowe obchodzenie się z akcesoriami może spowodować nieprawidłowe działanie całego produktu.
6. Stosowanie produktów i urządzeń do podawania tlenu (np. filtrów i zaworów dozujących) innych firm wraz z resuscytatorem Ambu SPUR II może wpływać na działanie produktu. Należy skonsultować się z producentem takich urządzeń w celu sprawdzenia zgodności z resuscytatorem Ambu SPUR II i uzyskania informacji na temat możliwych zmian w działaniu.
7. W przypadku resuscytatorów dla dorosłych i pediatrycznych worek ze zbiornikiem tlenu jest na stałe podłączony do zaworu wlotowego, z wyjątkiem wersji z zaworem doząjącym. Nie należy próbować go odłączać. Nie ciągnąć za worek zbiornika tlenu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

1.8. Potencjalne niepożądane zdarzenia

Potencjalne (przykładowe) zdarzenia niepożądane związane z resuscytacją: uraz spowodowany zbyt dużym ciśnieniem lub zbyt dużą objętością oddechową, hipoksja, hiperkapnia czy aspiracyjne zapalenie płuc.

1.9. Uwagi ogólne

Jeżeli podczas lub na skutek używania urządzenia dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, należy je zgłosić do producenta i odpowiedniej krajowej instytucji.

2. Opis urządzenia

Resuscytator Ambu SPUR II można podłączyć do jednorazowego manometru ciśnieniowego Ambu®, zaworów Ambu® PEEP i masek twarzowych Ambu® zgodnie z opisem w rozdziale 4.3 Obsługa resuscytatora.

3. Objasnienie używanych symboli

Znaczenie symboli	Opis
	Wersja dla dorosłych Masa ciała powyżej 30 kg
	Wersja pediatryczna Masa ciała od 6 do 30 kg
	Wersja dla niemowląt Masa ciała do 10 kg

Znaczenie symboli	Opis
	Warunkowo dopuszczane do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego
	Kraj producenta
	Wyrób medyczny
	Produkt wielokrotnego użytku, dla jednego pacjenta
	Nie ciągnąć worka zbiornika tlenu na siłę

Pełną listę objaśnień symboli można znaleźć na stronie
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Przeznaczenie produktu

4.1. Zasady działania

Na ilustracji 1 przedstawiono przepływ mieszanin gazów oddechowych do worka oraz do i od pacjenta podczas ręcznej obsługi resuscytatora. 1a Resuscytator dla dorosłych i dzieci, 1b resuscytator dla niemowląt z zamkniętym zbiornikiem tlenu (zbiornik workowy), 1c resuscytator dla niemowląt z otwartą rurką zbiornika tlenu (zbiornik rurkowy).

Przepływ gazów jest podobny, gdy pacjent oddycha samodzielnie przez urządzenie.

Zbiornik tlenu jest wyposażony w dwa zawory – jeden z nich umożliwia pobór powietrza atmosferycznego z otoczenia, gdy zbiornik jest pusty, a drugi kieruje nadmiar tlenu na zewnątrz, gdy worek zbiornika jest pełny.

M-Port zapewnia dostęp do przepływu gazów wdechowych i wydechowych, umożliwiając podłączenie strzykawki w celu podawania leków 1d lub podłączenie przewodu do pobierania próbek gazu w celu pomiaru EtCO₂ w strumieniu bocznym 1e.

1.1 Usuwanie nadmiar tlenu, 1.2 Wlot powietrza, 1.3 Wlot tlenu, 1.4 Złącze pacjenta, 1.5 Wydech, 1.6 Port manometru, 1.7 Zawór ograniczający, 1.8 port M.

UWAGA: do punktu 1.5 można podłączyć albo osłonę przeciwbrzegową albo zawór PEEP.

4.2. Kontrola i przygotowanie

Resuscytator należy rozpakować i przygotować do natychmiastowego użycia (oraz sprawdzić, czy działa), zanim zostanie umieszczony w stanie gotowości do użycia w sytuacjach awaryjnych.

4.2.1. Przygotowanie

- Jeśli resuscytator jest zapakowany w postaci skompresowanej, rozłożyć go, pociągając za zawór pacjenta i zawór wlotowy.
- Przygotować resuscytator i umieścić wszystkie elementy w torbie transportowej dostarczonej z resuscytatorem.
- Jeśli maska twarzowa dostarczona z resuscytatorem jest zapakowana w ochronne etui, zdjąć je przed użyciem.

Patrz rozdział 4.2.2. (Rurka tlenowa) do przygotowania urządzenia przed użyciem w temperaturze poniżej 0 °C.

4.2.2. Test poprawności działania 2

Resuscytator

Zamknąć zawór ograniczający za pomocą zatyczki blokującej i zamknąć złącze pacjenta kciukiem 2.1. Mocno ścisnąć worek resuscytatora. Resuscytator powinien stawić opór podczas ściskania.

Otworzyć zawór ograniczający, wysuwając zatyczkę blokującą i powtórzyć procedurę. Zawór ograniczający powinien teraz zadziałać i powinien być słyszalny przepływ z zaworu podczas mocnego ściskania worka.

Kilka razy ścisnąć i zwolnić resuscytator, aby się upewnić, że powietrze przechodzi przez system zaworów i wychodzi zaworem pacjenta. 2.2

UWAGA: Ruchom tarczy zaworu podczas testu poprawności działania lub podczas wentylacji może towarzyszyć cichy dźwięk. Nie ma to negatywnego wpływu na działanie resuscytatora.

Rurka tlenuowa

Montaż rurki tlenuowej i test działania zbiorników tlenu w postaci worka i rurki należy wykonać w temperaturze powyżej 0 °C. Przed użyciem resuscytatora w temperaturach poniżej 0 °C należy pozostawić rurkę tlenuową podłączoną do źródła tlenu po teście poprawnego działania.

Zbiornik tlenu (workowy)

Ustawić dopływ gazów do złącza wlotu tlenu na 10 l/min. Na koniec rozłożyć worek ręcznie. Sprawdzić, czy zbiornik tlenu napełnia się. Jeśli nie, sprawdzić, czy dwie zastawki zaworów nie uległy uszkodzeniu lub czy zbiornik nie został rozerwany.

Następnie wyregulować przepływ dostarczanego gazu zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Zbiornik tlenu (rurowy)

Ustawić dopływ gazów do złącza wlotu tlenu na 10 l/min. Sprawdzić, czy tlen wydostaje się końcem zbiornika rurowego. Jeśli nie, sprawdzić, czy rurka tlenuowa nie została zablokowana. Następnie wyregulować przepływ dostarczanego gazu zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

M-Port

Zdjąć nakrywkę M-Portu i zablokować złącze pacjenta. Ścisnąć worek i nasłuchiwać dźwięku powietrza przechodzącego przez M-Port. 2.3

4.3. Obsługa resuscytatora

- Zastosować zalecane techniki oczyszczania jamy ustnej i dróg oddechowych pacjenta oraz prawidłowego ułożenia pacjenta w celu otwarcia dróg oddechowych.
- Mocno przycisnąć maskę twarzową do twarzy pacjenta. 3.1
- Wsunąć dłoń (wersja dla dorosłych) lub palec środkowy i serdeczny (wersja pediatryczna) pod uchwyt na worku resuscytatora. Wersja dla niemowląt nie ma uchwytu podtrzymującego. Wentylacja bez uchwytu podtrzymującego jest możliwa po obróceniu worka. 3.2 Przystąpić do wentylacji pacjenta: Podczas wdmuchiwanego powietrza obserwować unoszenie się klatki piersiowej. Szybkim ruchem puścić uchwyty worka i nasłuchiwać przepływu wydechowego z zaworu pacjenta oraz obserwować opadanie klatki piersiowej pacjenta.
- W przypadku utrzymującego się oporu przy wdmuchiwaniu powietrza sprawdzić drogi oddechowe pod kątem niedrożności i zmienić pozycję pacjenta, aby zapewnić drożność dróg oddechowych.
- Jeśli pacjent wymiotuje podczas wentylacji, należy natychmiast oczyścić jego drogi oddechowe i usunąć wymiociny z resuscytatora, potrząsając nim kilkakrotnie mocno i szybko, a następnie wznowić wentylację.
W razie potrzeby produkt należy wytrzeć ściereczką nasączoną alkoholem i wyczyścić osłonę przeciwbrzyzgową wodą.

Port manometru

Do portu manometru znajdującego się na górze zaworu pacjenta można podłączyć jednorazowy manometr Ambu oraz manometr innego producenta. Zdjąć zatyczkę i podłączyć manometr/ciśnieniomierz.

System ograniczający ciśnienie 4

Zawór ograniczający ciśnienie jest ustawiony na otwarcie w ciśnieniu 40 cm H₂O (4,0 kPa). 4.1

Jeśli profesjonalna medyczna ocena sytuacji wskazuje, że wymagane jest ciśnienie powyżej 40 cm H₂O, można obejść zawór ograniczający, umieszczać na nim zatyczkę blokującą. 4.2

Zawór ograniczający ciśnienie można też zablokować, umieszczać palec na czerwonym przycisku podczas ścisania worka.

M-Port

Resuscytator Ambu SPUR II jest dostarczany z M-Portem lub bez niego. M-Port zapewnia dostęp do przepływu gazu wdechowego i wydechowego i może być używany do podawania leków, jeśli jest podłączona strzykawka, a także do pomiaru CO₂ w strumieniu bocznym (EtCO₂). Gdy M-Port nie jest używany, należy pamiętać o zamknięciu go czerwoną zatyczką.

Pomiar EtCO₂

W celu pomiaru EtCO₂ w strumieniu bocznym podłączyć przewód próbkowania gazu urządzenia pomiarowego EtCO₂ do portu M resuscytatora Ambu SPUR II. Podłączyć złącze przewodu próbkowania gazu, montując je i obracając o 1/4 obrotu w prawo.

Podawanie leków

Należy dokładnie obserwować reakcję pacjenta na podany lek. Podanie przez M-Port płynnego leku o objętości 1 ml lub więcej jest porównywalne z podaniem go bezpośrednio do rurki dotchawiczej. M-Port testowano z użyciem epinefryny, lidokainy i atropiny.

Resuscytator Ambu SPUR II z zaworem dozującym 5

Resuscytator Ambu SPUR II z zaworem dozującym jest dostępny w rozmiarach dla dorosłych i dzieci i może być używany zarówno z zaworem dozującym, jak i bez niego, oraz jest dostarczany z podłączanym workiem zbiornika tlenu.

Zawór wlotowy resuscytatora Ambu SPUR II łączy się z zaworem dozującym za pomocą adaptera.

Montaż zaworu dozującego:

- Wyjąć zestaw zbiornika tlenu z zaworu wlotowego resuscytatora Ambu SPUR II, jeśli jest podłączony.
- Podłączyć adapter do systemu zaworu dozującego.
- Włożyć adapter zaworu dozującego do zaworu wlotowego resuscytatora Ambu SPUR II.

UWAGA: Z adapterem i zaworem dozującym używać wyłącznie części oznaczonych jako „urządzenie pracujące pod ciśnieniem”. Część oznaczona jako „Worek zbiornika tlenu” jest częścią zapasową na wypadek awarii zaworu dozującego.

Podawanie tlenu

Tlen należy podawać zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Rycina 6 przedstawia obliczone wartości procentowe dostarczanego tlenu, które można uzyskać przy różnej objętości i częstotliwości wentylacji oraz różnej prędkości przepływu gazu. Procentową zawartość tlenu można sprawdzić w części 6 Dorośli 6.1, Dzieci 6.2, Niemowlęta 6.3.

Zbiornik tlenu (workowy) 7

W żadnym wypadku nie wolno odczepiać od resuscytatora cienkiej folii plastikowego zbiornika tlenu.

Akcesoria 8

Złącza resuscytatora Ambu SPUR II są zgodne z normami ISO 5356-1 i EN 13544-2, dzięki czemu pasują do innych urządzeń szpitalnych. W przypadku podłączenia urządzeń

zewnętrznych należy sprawdzić ich działanie oraz zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia zewnętrznego.

Poniżej wymieniono produkty Ambu kompatybilne z resuscytatorem Ambu SPUR II:

Jednorazowa maska twarzowa Ambu®

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi jednorazowej maski twarzowej Ambu.

Jednorazowy zawór Ambu® PEEP 20 8.1 8.2

Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi jednorazowego zaworu Ambu PEEP 20 lub na ilustracji **8.1** w niniejszej instrukcji obsługi. Aby zamontować na resuscytatorze jednorazowy zawór Ambu PEEP 20 (w razie potrzeby), należy zdjąć osłonę przeciwbrzyzgową. **8.2**

Jednorazowy manometr ciśnieniowy Ambu® 8.3

Dalsze informacje znajdują się w instrukcjach użytkowania jednorazowego manometru ciśnieniowego Ambu.

4.4. Po użyciu

Zużyte produkty należy utylizować zgodnie z lokalnymi procedurami.

5. Specyfikacje techniczne produktu

5.1. Zastosowane normy

Resuscytator Ambu SPUR II jest zgodny z normą dotyczącą produktu EN ISO 10651-4.

5.2. Specyfikacje

	Wersja dla niemowląt	Wersja pediatryczna	Wersja dla dorosłych
Objętość resuscytatora	ok. 220 ml	ok. 670 ml	ok. 1510 ml
Objętość podawana przy wentylacji jedną ręką*	150 ml	450 ml	600 ml
Objętość podawana przy wentylacji oburęcznej*	-	-	1000 ml
Wymiary (długość x średnica) bez zbiornika i akcesoriów	ok. 190 x 71 mm	ok. 223 x 99 mm	ok. 284 x 127 mm
Masa bez zbiornika i akcesoriów	ok. 70 g	ok. 145 g	ok. 220 g
Zawór ograniczający ciśnienie**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Martwa przestrzeń oddechowa	≤ 5 ml + 10 % podanej objętości	≤ 5 ml + 10 % podanej objętości	≤ 5 ml + 10 % podanej objętości
Opór wdechowy***	maks. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) przy 5 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) przy 50 l/min	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) przy 50 l/min
Opór wydechowy***	maks. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) przy 5 l/min	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) przy 50 l/min	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) przy 50 l/min
Objętość zbiornika	ok. 300 ml (worek) ok. 100 ml (rurka)	ok. 2600 ml (worek)	ok. 2600 ml (worek)

	Wersja dla niemowląt	Wersja pediatriczna	Wersja dla dorosłych
Złącze pacjenta		Zewn. 22 mm, męskie (ISO 5356-1) Wew. 15 mm, żeńskie (ISO 5356-1)	
Złącze wydechowe (do zaworu PEEP)		30 mm, męskie (ISO 5356-1)	
Złącze portu manometru		Ø 4,2 +/- 0,1 mm	
Złącze zaworu dozującego	-	Wew. 32 mm, żeńskie (EN ISO 10651-4)	
Nieszczelność przy przepływie do przodu i do tyłu		Niemierzalna	
M-Port		Złącze zgodne z EN ISO 80369-7	
Złącze wlotu O ₂		Zgodne z normą PN-EN 13544-2	
Zakres temperatury roboczej		od -18 °C do + 50 °C (od -0,4 °F do + 122 °F), testowane zgodnie z EN ISO 10651-4	
Zakres temperatury przechowywania		od -40 °C do + 60 °C (od -40 °F do +140 °F), testowane zgodnie z EN ISO 10651-4	
Zalecane warunki długotrwałego przechowywania: w zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, z dala od światła słonecznego.			

* Przetestowany zgodnie z normą EN ISO 10651-4.

** Blokując zawór ograniczający ciśnienie, można uzyskać wyższe ciśnienie podawanego powietrza.

*** W ogólnych warunkach testowych zgodnie z EN ISO 10651-4.



5.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa MRI

Resuscytatory Ambu SPUR II¹, Ambu SPUR II z jednorazowym zaworem Ambu PEEP 20² oraz Ambu SPUR II z jednorazowym zaworem Ambu PEEP 20 i jednorazowym manometrem Ambu² można bezpiecznie stosować w środowisku rezonansu magnetycznego (ale nie wewnętrz urządzienia do rezonansu) w następujących warunkach.

Statyczne pole magnetyczne o natężeniu 7 T i mniejszym, z

- Maksymalnym gradientem przestrzennym pola
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Maksymalną mocą produktu
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Użycie wewnętrz urządzienia do rezonansu może wpływać na jakość obrazu MR.

Nie badano nagrzewania wywołanego promieniowaniem RF ani artefaktów obrazu rezonansu magnetycznego. Wszystkie metalowe części są całkowicie osłonięte i nie mają kontaktu z ciałem pacjenta.

1. Informação Importante – Ler antes de usar

Leia atentamente estas instruções de segurança antes de utilizar o Ambu® SPUR® II Resuscitator. As instruções de utilização poderão ser atualizadas sem aviso prévio. Cópias da versão atual disponibilizadas mediante solicitação. Tenha em atenção que estas instruções não explicam nem abordam procedimentos clínicos. Descrevem apenas o funcionamento básico e as precauções relacionados com o funcionamento do ressuscitador. Antes da utilização inicial do ressuscitador, é essencial que os operadores recebam formação suficiente em técnicas de reanimação e estejam familiarizados com o uso pretendido, avisos, precauções e contraindicações mencionadas nestas instruções. Esta garantia não cobre o Ambu SPUR II Resuscitator.

1.1. Fim a que se destina

O Ambu SPUR II Resuscitator é um ressuscitador para utilização num único paciente, destinado à ressuscitação pulmonar.

1.2. Indicações de utilização

O Ambu SPUR II Resuscitator destina-se a ser utilizado em situações em que seja necessário um ressuscitador cardiopulmonar manual para ventilação assistida.

O Ambu SPUR II Resuscitator é indicado para a ventilação e oxigenação de pacientes até que possa ser estabelecida uma via aérea mais definitiva ou o paciente tenha recuperado.

1.3. Pacientes a que se destina

Os limites de aplicação de cada versão são:

- Adultos: Adultos e crianças com um peso corporal superior a 30 kg.

- Crianças: Bebés e crianças com um peso corporal entre 6 kg e 30 kg.

- Bebés: Recém-nascidos e bebés com peso corporal inferior a 10 kg.

Tenha em atenção que nem todas as configurações do Ambu SPUR II Resuscitator estão disponíveis para todos os três tipos de pacientes.

1.4. Utilizador previsto

Profissionais médicos com formação na gestão das vias aéreas, tais como anestesistas, enfermeiros, paramédicos e equipas de emergência.

1.5. Contraindicações

Não conhecidas.

1.6. Benefícios clínicos

A técnica básica de gestão das vias aéreas com recurso a um ressuscitador manual permite a ventilação e oxigenação de pacientes até ser possível estabelecer uma via aérea mais definitiva ou o paciente ter recuperado.

1.7. Advertências e precauções

A não observância destas precauções poderá resultar numa ventilação e oxigenação deficientes do paciente ou em danos no equipamento.

ADVERTÊNCIAS

1. Não utilize o ressuscitador durante mais de 4 horas acumuladas durante um período máximo de 1 semana, para evitar o risco de infecção.
2. Não reutilize o ressuscitador se existirem resíduos ou humidade visíveis no interior do dispositivo, para evitar o risco de infecção e avaria.
3. Certifique-se de que a proteção antissalpicos ou a válvula Ambu PEEP está instalada na porta expiratória. Uma porta expiratória aberta pode ser accidentalmente bloqueada e resultar num volume de ar excessivo nos pulmões, o que pode conduzir a traumatismo nos tecidos.
4. Evite a utilização do ressuscitador em ambientes tóxicos ou perigosos, para evitar o risco de danos nos tecidos.

5. Certifique-se sempre de que o tubo do reservatório de oxigénio não está bloqueado, uma vez que bloquear o tubo pode impedir o reenchimento do saco de compressão, o que pode resultar na inexistência de ventilação.
6. Não utilize o produto se estiver contaminado por fontes externas, pois pode causar infecção.
7. Ispécione sempre visualmente o produto e realize um teste de funcionalidade depois de desembalar, montar e antes da utilização, pois os defeitos e as matérias estranhas podem resultar na ausência de ventilação ou na redução da ventilação do paciente.
8. Não utilize o produto se o teste de funcionalidade falhar, pois pode resultar numa ventilação inexistente ou reduzida.
9. Não anule a válvula limitadora de pressão, a menos que seja recomendado por uma avaliação médica. As pressões de ventilação elevadas podem causar barotrauma.
10. Para uma única utilização. A utilização noutros pacientes poderá conduzir à infecção cruzada.
11. A medicação não pode ser fornecida através da M-port se estiverem ligados acessórios (por ex., filtro, detetor de CO₂) entre o ressuscitador e a máscara facial.
12. Não deixe a M-port aberta após a utilização, para evitar fugas, o que pode resultar na redução da distribuição de O₂ ao paciente.
13. A M-Port não deve ser utilizada para monitorização de EtCO₂ de fluxo lateral dos pacientes ventilados com menos de 400 ml de volume respiratório, para evitar medições incorretas do EtCO₂.
14. Ao administrar medicação com um volume inferior a 1 ml, é necessário lavar a M-Port para assegurar a dosagem precisa da medicação administrada.
15. Não ligue a tubagem de fornecimento de oxigénio à M-port, uma vez que a concentração de O₂ pretendida não será administrada ao paciente.
16. Adicionar acessórios poderá aumentar a resistência inspiratória e/ou expiratória. Não instale acessórios se o aumento da resistência respiratória for prejudicial para o paciente.
17. Apenas destinado a utilização por utilizadores previstos familiarizados com o conteúdo deste manual, uma vez que a utilização incorreta pode provocar lesões no paciente.
18. Quando utilizar oxigénio suplementar, não permita que se fume nem utilize o dispositivo junto de chamas abertas, óleo, gordura, outros produtos químicos ou equipamentos e ferramentas inflamáveis, que possam causar faíscas, devido ao risco de incêndio e/ou explosão.
19. Não tente instalar qualquer válvula de controlo de admissão na versão para crianças, pois pode provocar concentrações de oxigénio elevadas, o que pode ser nocivo para os recém-nascidos.
20. Tenha em atenção os sinais de obstrução das vias aéreas superiores/parciais quando utilizar o ressuscitador ligado a uma máscara facial, pois isso resultará numa administração de oxigénio inexistente ou limitada. Mude sempre para uma alternativa à utilização de uma máscara facial para direcionar o ar para o paciente, se disponível.
21. Não utilize o produto com máscara facial fixa quando ventilar bebés com hérnia congénita diafragmática devido ao risco de insuflação. Mude para uma alternativa à utilização de uma máscara facial para direcionar o ar para o paciente, se disponível.
22. Os profissionais que realizem o procedimento devem avaliar a escolha do tamanho e dos acessórios do ressuscitador (por exemplo, máscara facial, válvula PEEP, etc.) de acordo com a(s) condição(ões) específica(s) do paciente, uma vez que uma utilização incorreta pode causar lesões no paciente.
23. Não utilize o Ambu SPUR II quando for necessário o fornecimento de oxigénio de fluxo livre, devido a uma possível administração insuficiente de oxigénio, o que pode resultar em hipoxia.
24. A tampa do manômetro deve ser sempre colocada na porta do manômetro quando a pressão não estiver a ser monitorizada, para evitar fugas, o que pode resultar numa redução da distribuição de O₂ ao paciente.
25. Pré-instale sempre o tubo de oxigénio no fornecimento de oxigénio a temperaturas superiores a 0 °C, uma vez que a montagem pode tornar-se difícil a temperaturas inferiores a 0 °C, resultando numa redução do fornecimento de oxigénio ao paciente.
26. Quando utilizar o ressuscitador com a máscara facial instalada, assegure-se do correto posicionamento e vedação da máscara facial, uma vez que um isolamento inadequado pode resultar na propagação de doenças infecciosas transportadas pelo ar ao utilizador.

PRECAUÇÕES

1. Nunca guarde o ressuscitador deformado, salvo se for dobrado conforme fornecido pelo fabricante, caso contrário, o balão poderá ficar irremediavelmente distorcido, o que poderá reduzir a eficácia da ventilação. A zona de dobra é claramente visível no balão (apenas as versões para Adultos e Pediátrica podem ser dobradas).
2. Observe o movimento do tórax e escute o fluxo expiratório da válvula do paciente, para verificar a ventilação. Mude imediatamente para ventilação boca-a-boca se não for possível obter ventilação com o ressuscitador.
3. Não embeba ou esterilize este dispositivo, uma vez que estes procedimentos poderão deixar resíduos perigosos ou avariar o dispositivo. O desenho do dispositivo e os materiais utilizados não são compatíveis com os procedimentos convencionais de limpeza e esterilização.
4. Utilize a M-Port apenas para um dos dois; medição de EtCO₂ ou administração de fármacos, uma vez que tal pode modificar os valores medidos.
5. Se aplicável, consulte a embalagem dos acessórios para obter informações mais específicas sobre o acessório individual, uma vez que o manuseamento incorreto pode resultar na avaria de todo o produto.
6. A utilização de produtos de terceiros e dispositivos de administração de oxigénio (por ex., filtros e válvulas de aspiração) com o Ambu SPUR II Resuscitator pode influenciar o desempenho do produto. Consulte o fabricante do dispositivo de terceiros para verificar a compatibilidade com o Ambu SPUR II Resuscitator e obter informações sobre as possíveis alterações de desempenho.
7. O balão do reservatório de oxigénio está permanentemente ligado à válvula de entrada em ressuscitadores para adultos e crianças, exceto nas versões com válvula de controlo de admissão. Não tente desmontar. Não puxe o balão do reservatório de oxigénio, uma vez que pode na avaria do dispositivo.

1.8. Eventos adversos possíveis

Potenciais eventos adversos relacionados com a reanimação (não exaustiva): barotrauma, volutrauma, hipoxia, hipercarbia e pneumonia por aspiração.

1.9. Notas gerais

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao fabricante e à autoridade competente do seu país.

2. Descrição do dispositivo

O Ambu SPUR II Resuscitator pode ser ligado ao Manômetro de Pressão Descartável Ambu®, às Válvulas Ambu® PEEP e às máscaras faciais Ambu®, conforme descrito na secção 4.3 Funcionamento do ressuscitador.

3. Explicação dos símbolos utilizados

Indicações dos símbolos	Descrição
	Adulto Massa corporal ideal pretendida superior a 30 kg
	Crianças Massa corporal ideal pretendida de 6 a 30 kg
	Infantil Massa corporal ideal pretendida de até 10 kg
	Condisional para RM

Indicações dos símbolos	Descrição
	País do fabricante
	Dispositivo médico
	Utilização múltipla num único paciente
	Não puxe o balão do reservatório de oxigénio à força

Pode encontrar uma lista completa das explicações dos símbolos em
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Utilização do produto

4.1. Princípio de funcionamento

A ilustração 1 mostra as misturas do gás de ventilação que fluem para dentro do balão e para o paciente durante o funcionamento manual do ressuscitador. 1a) Ressuscitador para adultos e crianças, 1b) ressuscitador para bebés com balão do reservatório de oxigénio fechado (reservatório de balão), 1c) ressuscitador para bebés com tubo do reservatório de oxigénio aberto (tubo do reservatório).

O fluxo de gás é similar quando o paciente está a respirar espontaneamente através do dispositivo.

O reservatório de oxigénio possui duas válvulas, uma que permite a entrada de ar ambiente quando o reservatório está vazio e outra que expulsa o oxigénio em excesso quando o balão reservatório de oxigénio está cheio.

O M-Port proporciona acesso ao fluxo de gases inspiratórios e expiratórios, permitindo ligar uma seringa para administração de medicamento 1d ou uma linha de amostragem de gás para medição do EtCO₂ 1e de fluxo lateral.

1.1 Libertaçāo de oxigénio em excesso, 1.2 Entrada de ar, 1.3 Entrada de oxigénio, 1.4 Conector do paciente, 1.5 Expiração, 1.6 Porta do manómetro, 1.7 Válvula limitadora de pressão, 1.8 porta M.

NOTA: o acessório para 1.5 pode ser uma proteção contra salpicos ou uma válvula PEEP.

4.2. Inspeção e preparação

O ressuscitador deve ser desembalado e preparado (incluindo a realização de um teste de funcionalidade) para utilização imediata antes de ser disponibilizado para utilização em situações de emergência.

4.2.1. Preparação

- Se o ressuscitador estiver comprimido quando embalado, desdobre-o puxando pela válvula do paciente e pela válvula de entrada.
- Prepare o ressuscitador e coloque todos os itens no saco de transporte fornecido com o mesmo.
- Se a máscara facial fornecida com o ressuscitador estiver embrulhada numa bolsa de protecção, a bolsa deve ser removida antes da utilização.

Consulte a secção 4.2.2. (Tubo de oxigénio) para preparação do dispositivo antes da utilização a uma temperatura inferior a 0 °C.

4.2.2. Teste de funcionamento 2

Ressuscitador

Feche a válvula limitadora de pressão com a mola de acionamento e feche o conector do paciente com o polegar **2.1**. Aperte ligeiramente o saco compressível. O ressuscitador deve resistir ao aperto.

Abra a válvula limitadora de pressão deslizando para fora a mola de acionamento e repetindo o procedimento. A válvula limitadora de pressão deve agora estar ativada e deve ser possível ouvir o fluxo da válvula durante a compressão do balão compressível pelo peso acentuado.

Aperte e solte o ressuscitador várias vezes para garantir que o ar está a circular através do sistema de válvulas e a sair pela válvula do paciente. **2.2**

NOTA: Uma vez que os discos de válvula estão em movimento durante o teste de funcionalidade ou durante a ventilação, poderá ser perceptível um ligeiro ruído. Isto não compromete a funcionalidade do ressuscitador.

Tubo de oxigénio

A montagem do tubo de oxigénio e o teste de funcionamento do balão do reservatório de oxigénio e do tubo do reservatório de oxigénio devem ser realizados a temperaturas superiores a 0 °C. Para utilizar o ressuscitador a temperaturas inferiores a 0 °C, deixe o tubo de oxigénio ligado ao fornecimento de oxigénio após o teste de funcionamento.

Balão reservatório de oxigénio

Forneça um fluxo de gás de 10 l/min no conector de entrada de oxigénio. Eventualmente, apoie o desdobramento do saco à mão. Verifique se o balão do reservatório de oxigénio enche. Se não encher, verifique a integridade dos dois fechos das válvulas ou se o reservatório de oxigénio está rasgado.

Em seguida, ajuste o fluxo de gás fornecido de acordo com a indicação médica.

Tubo reservatório de oxigénio

Forneça um fluxo de gás de 10 l/min no conector de entrada de oxigénio. Verifique se o oxigénio sai na extremidade do tubo do reservatório de oxigénio. Se não sair, verifique se o tubo de oxigénio está obstruído. Em seguida, ajuste o fluxo de gás fornecido de acordo com a indicação médica.

M-Port

Retire a tampa do M-Port e bloquee o conector do paciente. Aperte o balão e verifique se ouve ar a ser expulso através do M-Port. **2.3**

4.3. Funcionamento do ressuscitador

- Utilize as técnicas recomendadas para desobstruir a boca e as vias aéreas do paciente e para posicionar corretamente o paciente de modo a abrir as vias aéreas.
 - Segure a máscara facial firmemente contra o rosto do paciente. **3.1**
 - Passe a mão (versão para Adultos) ou os dedos anelar e médio (versão para Crianças) sob a alça de suporte. A versão para bebés não possui pega de apoio. Pode conseguir-se a ventilação sem utilizar a pega de apoio, rodando o saco. **3.2** Ventilação do paciente: Durante a insuflação, observe a subida do tórax. Solte o balão subitamente, escute o fluxo expiratório proveniente da válvula do paciente e observe visualmente a descida do tórax.
 - Se sentir resistência continuada à insuflação, verifique se as vias aéreas estão obstruídas e reposicione o paciente, para garantir que as vias aéreas estão abertas.
 - Se o paciente vomitar durante a ventilação; limpe imediatamente as vias aéreas do paciente e retire o vómito do ressuscitador agitando e comprimindo-o com força e rapidez várias vezes antes de retomar a ventilação.
- Se necessário, limpe o produto com um pano que contenha álcool e limpe a proteção antissalpicos com água.

Porta do manómetro

O manómetro de pressão descartável Ambu, bem como um manómetro de pressão de terceiros, podem ser ligados à porta do manómetro, situada no topo da válvula do paciente. Retire a tampa e coloque o manómetro/manómetro de pressão

Sistema de limitação da pressão 4

A válvula limitadora de pressão está regulada para abrir a 40 cm H₂O (4,0 kPa). 4.1

Se a avaliação médica e profissional indicar que é necessária uma pressão superior a 40 cm H₂O, a válvula limitadora de pressão pode ser anulada deslocando a mola de acionamento para a válvula. 4.2

Em alternativa, a válvula limitadora de pressão pode ser anulada ao colocar um dedo no botão vermelho enquanto aperta o balão.

M-Port

O Ambu SPUR II Resuscitator é fornecido com ou sem uma M-Port. A M-Port proporciona acesso ao fluxo de gás inspiratório e expiratório e pode ser utilizada para aplicação de medicação, quando ligada a uma seringa, bem como para medir o CO₂ (EtCO₂) de fluxo lateral. Quando não estiver a ser utilizada, lembre-se de fechar a M-port com a tampa vermelha da M-port.

Medição de EtCO₂

Para medir o EtCO₂ de fluxo lateral, ligue a linha de amostragem de gás do dispositivo de medição de EtCO₂ à M-Port do Ambu SPUR II Resuscitator. Ligue o conector da linha de amostragem de gás, montando e rodando 1/4 de volta para a direita.

Aplicar a medicação

Observe cuidadosamente a resposta do paciente à medicação administrada. A administração de volumes de 1 ml de fluido ou superiores através do M-Port é comparável

à administração directa num tubo endotraqueal. A M-Port foi testada com epinefrina, lidocaína e atropina.

Versão da válvula de controlo de admissão do Ambu SPUR II Resuscitator 5

A versão da válvula de controlo de admissão do Ambu SPUR II Resuscitator está disponível em tamanhos para adultos e crianças e pode ser utilizada com ou sem uma válvula de controlo de admissão e inclui um balão reservatório de oxigénio para instalação.

A válvula de entrada do Ambu SPUR II Resuscitator liga-se à válvula de controlo de admissão através de um adaptador.

Instalação da válvula de controlo de admissão:

- Remova a unidade do reservatório de oxigénio da válvula de entrada do Ambu SPUR II Resuscitator, se estiver colocada.
- Ligue o adaptador ao sistema de válvula de controlo de admissão.
- Insira o adaptador da válvula de controlo de admissão na válvula de entrada do Ambu SPUR II Resuscitator.

NOTA: Utilize apenas a peça identificada com "unidade de compressão" com o adaptador e a válvula de controlo de admissão. A peça identificada com "Saco de reservatório de oxigénio" é considerada como reserva se a válvula de controlo de admissão falhar.

Administração de oxigénio

Administre oxigénio de acordo com as indicações médicas.

A figura 6 apresenta as percentagens de fornecimento calculado de oxigénio que podem ser obtidas com diferentes volumes e frequências de ventilação a diferentes taxas de fluxo de gás. As percentagens de oxigénio podem ser vistas em 6 Adultos 6.1, Crianças 6.2, Bebés 6.3.

Balão reservatório de oxigénio 7

A folha de plástico fina do balão reservatório de oxigénio não pode, nunca, ser separada do seu ponto de fixação ao ressuscitador.

Acessórios 8

Os conectores do Ambu SPUR II Resuscitator cumprem as normas ISO 5356-1 e EN 13544-2, tornando-o compatível com outros equipamentos hospitalares. Quando aplicar dispositivos externos, certifique-se de que testa a funcionalidade e consulta as instruções de utilização que acompanham o dispositivo externo.

Os produtos Ambu compatíveis com o Ambu SPUR II Resuscitator estão indicados abaixo:

Máscara facial descartável Ambu®

Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização da Máscara facial descartável Ambu.

A válvula descartável Ambu® PEEP 20 8.1 8.2

Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização da válvula descartável Ambu PEEP 20 ou consulte a ilustração 8.1 nestas Instruções de utilização. Para instalar a válvula descartável Ambu PEEP 20 (se necessário) no ressuscitador, retire a proteção contra salpicos. 8.2

Manômetro de pressão descartável Ambu® 8.3

Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização do Manômetro de Pressão Descartável Ambu.

4.4. Após utilização

Os produtos usados devem ser descartados de acordo com os procedimentos locais.

5. Especificações técnicas do produto

5.1. Normas aplicadas

O ressuscitador Ambu SPUR II está em conformidade com a norma específica aplicável, EN ISO 10651-4.

5.2. Especificações

	Infantil	Crianças	Adulto
Volume do ressuscitador	aprox. 220 ml	aprox. 670 ml	aprox. 1510 ml
Volume doseado com uma mão*	150 ml	450 ml	600 ml
Volume doseado com duas mãos*	-	-	1000 ml
Dimensões (comprimento x diâmetro) sem reservatório e acessório	aprox. 190 x 71 mm	aprox. 223 x 99 mm	aprox. 284 x 127 mm
Peso sem reservatório e acessório	aprox. 70 g	aprox. 145 g	aprox. 220 g
Válvula limitadora de pressão**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Espaço morto	≤5 ml + 10 % do volume fornecido	≤5 ml + 10 % do volume fornecido	≤5 ml + 10 % do volume fornecido
Resistência inspiratória***	máx. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) a 5 l/min	máx. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) a 50 l/min	máx. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) a 50 l/min
Resistência expiratória***	máx. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) a 5 l/min	máx. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) a 50 l/min	máx. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) a 50 l/min
Volume do reservatório	aprox. 300 ml (balão) aprox. 100 ml (tubo)	aprox. 2600 ml (balão)	aprox. 2600 ml (balão)
Conector do paciente	Exterior: 22 mm, conector macho (ISO 5356-1) Interior: 15 mm, conector fêmea (ISO 5356-1)		
Conector expiratório (para ligação da válvula PEEP)	30 mm, conector macho (ISO 5356-1)		
Conector para porta do manômetro	Ø 4,2 +/- 0,1 mm		
Conector da válvula de controlo de admissão	-	Interior: 32 mm, conector fêmea (EN ISO 10651-4)	

	Infantil	Crianças	Adulto
Fuga de avanço e deretorno		Não mensurável	
M-Port		Conektor compatível com a EN ISO 80369-7	
Conektor de admissão de O ₂		Em conformidade com a EN 13544-2	
Limites da temperatura de funcionamento		-18 °C a +50 °C (-0,4 °F a +122 °F), testado em conformidade com a EN ISO 10651-4	
Limites da temperatura de armazenamento		-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F), testado em conformidade com a EN ISO 10651-4	
Armazenamento a longo prazo recomendado em embalagem fechada à temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar.			

* Testado de acordo com a EN ISO 10651-4

** Pode ser obtida uma pressão de descarga superior anulando a função da válvula limitadora de pressão.

*** Em condições gerais de teste de acordo com a norma EN ISO 10651-4.

- Força máxima do produto de
 - 450.000.000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G2/cm (721 T²/m)²

A utilização no interior do orifício de RM pode influenciar a qualidade da imagem de RM. O aquecimento induzido por RF e os artefactos de imagem de RM não foram testados. Quaisquer peças metálicas estão totalmente encapsuladas e não têm contacto com o corpo humano.

5.3. Informações de segurança para RM

O Ambu SPUR II Resuscitator¹, o Ambu SPUR II Resuscitator com válvula descartável Ambu PEEP 20 instalada², o Ambu SPUR II Resuscitator com válvula descartável Ambu PEEP 20 instalada e Manómetro de pressão descartável Ambu² podem ser utilizados em segurança no ambiente de RM (não no interior do orifício de RM) nas seguintes condições.

Campo magnético estático de 7 Tesla e inferior, com

- Gradiente máximo do campo espacial de
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²

1. Informații importante – A se citi înainte de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni referitoare la siguranță înainte de a utiliza resuscitatorul Ambu® SPUR®. Instrucțiunile de utilizare pot fi actualizate fără notificare prealabilă. La cerere, vi se pot pune la dispoziție copii ale actualei versiuni. Vă rugăm să țineți cont de faptul că aceste instrucțiuni nu explică și nu dezbat procedurile clinice. Acestea descriu doar operarea de bază și măsurile de precauție legate de operarea resuscitatorului. Înainte de prima utilizare a resuscitatorului, este esențial ca operatorii să fi fost instruiți suficient cu privire la tehniciile de resuscitare și să fie familiarizați cu domeniul de utilizare, avertismentele, precauțiile și contraindicațiile din aceste instrucțiuni. Pentru resuscitatorul Ambu SPUR II nu există garanție.

1.1. Domeniul de utilizare

Resuscitatorul Ambu SPUR II este destinat utilizării pe un singur pacient pentru resuscitare pulmonară.

1.2. Instrucțiuni de utilizare

Resuscitatorul Ambu SPUR II este destinat utilizării în situațiile în care este necesar un resuscitator cardiopulmonar manual pentru ventilația asistată.

Resuscitatorul Ambu SPUR II este indicat pentru ventilația și oxigenarea pacienților până când se poate stabili o cale respiratorie mai bună sau până când pacientul se recuperează.

1.3. Pacienții vizați

Mărimele utilizate pentru fiecare model sunt:

- **Adulți:** adulți și copii cu o greutate corporală mai mare de 30 kg (66 lb).
 - **Copii:** sugari și copii cu o greutate corporală cuprinsă între 6 și 30 kg (13 – 66 lb).
 - **Sugari:** nou-născuți și sugari cu o greutate corporală de până la 10 kg (22 lb).
- Rețineți că nu toate configurațiile resuscitatorului Ambu SPUR II sunt disponibile pentru toate cele trei game de mărime.

1.4. Utilizatori vizați

Personalul medical instruit în managementul căilor respiratorii, cum ar fi anesteziaști, asistente medicale, personal de salvare și personal pentru intervenții de urgență.

1.5. Contraindicații

Nu se cunosc.

1.6. Beneficii clinice

Tehnica de bază de management al căilor respiratorii, folosind un resuscitator manual, permite ventilația și oxigenarea pacienților până când se poate stabili o cale respiratorie mai bună sau până când pacientul se recuperează.

1.7. Avertismente și măsuri de precauție

Ignorarea acestor măsuri de precauție poate conduce la ventilația neficientă a pacientului sau la deteriorarea echipamentului.

AVERTISMENTE

1. Pentru a evita riscul de infecție, nu utilizați resuscitatorul mai mult de 4 ore cumulate într-o perioadă maximă de 1 săptămână.
2. Pentru a evita riscul de infecție și funcționare defectuoasă, nu reutilizați resuscitatorul dacă în interiorul acestuia au rămas urme de umezeală sau reziduuri vizibile.
3. Asigurați-vă că protecția împotriva stropilor sau valva PEEP de la Ambu (una dintre acestea două) este atașată la portul expirator. Un port expirator deschis poate fi blocat accidental și poate duce la un volum excesiv de aer în plămâni, cauzând traumatismul tisular.
4. Evitați utilizarea resuscitatorului în medii toxice sau periculoase pentru a evita riscul de lezare a țesuturilor.

5. Asigurați-vă că tubul rezervorului de oxigen nu este blocat, deoarece blocarea tubului poate împiedica reumflarea balonului de compresie, ceea ce poate duce la lipsa ventilației.
6. Nu utilizați produsul dacă este contaminat din surse externe, deoarece acest lucru poate provoca infecții.
7. Inspectați vizual produsul și efectuați un test de funcționare după despachetare, asamblare și înainte de utilizare, deoarece defectele și materiile străine pot duce la lipsa ventilației sau la ventilația redusă a pacientului.
8. Nu utilizați produsul dacă nu trece de testul de funcționare, deoarece utilizarea sa în aceste condiții poate cauza lipsa ventilației sau ventilația redusă a pacientului.
9. Nu decuplați valva de limitare a presiunii decât dacă o evaluare medicală indică necesitatea acestei acțiuni. Presiunile ridicate de ventilare pot cauza barotraumă.
10. De unică folosință. Utilizarea pe alții pacienți poate provoca infecții încrucisate.
11. Medicamentele nu pot fi administrate prin M-Port dacă accesoriile (de ex., filtrul, detectoarea de CO₂) sunt conectate între resuscitator și masca facială.
12. Nu lăsați portul M-Port deschis după utilizare pentru a evita surgerile, care ar putea duce la reducerea livrării de O₂ către pacient.
13. M-Port nu trebuie utilizat pentru monitorizarea EtCO₂ în flux secundar la pacienții ventilați cu un volum al fluxului mai mic de 400 ml pentru a se evita măsurarea incorectă a EtCO₂.
14. La administrarea medicamentelor cu un volum mai mic de 1 ml, este necesară spălarea portului M-Port pentru a se asigura dozarea corectă a medicamentelor.
15. Nu atașați tubul de alimentare cu oxigen la M-Port, deoarece concentrația de O₂ vizată nu va fi furnizată pacientului.
16. Rezistența la inspirație și/sau la expirație poate crește dacă se adaugă accesorii. Nu atașați accesorii dacă rezistența respiratorie mai mare poate fi dăunătoare pentru pacient.
17. A se utiliza doar de către utilizatorii vizați, care sunt familiarizați cu conținutul acestui manual, deoarece utilizarea incorectă poate vătăma pacientul.
18. Din cauza riscului de incendiu și/sau explozie, atunci când utilizați oxigen suplimentar, nu permiteți fumatul sau utilizarea dispozitivului în apropierea focului deschis, a uleiului, a grăsimii, a altor substanțe chimice sau a echipamentelor și sculelor inflamabile, care pot produce scânteie.
19. Nu încercați să ataşați nicio valvă de dozaj de oxigen la modelul pentru sugarii, deoarece acest lucru poate cauza concentrații mari de oxigen, care pot fi dăunătoare pentru nou-născuți.
20. Aveți grijă la semnele de blocare completă/parțială a căilor respiratorii superioare atunci când utilizați resuscitatorul atașat la o mască facială, deoarece blocarea va duce la oprirea administrării de oxigen sau la administrarea acestuia în cantități limitate. Dacă este posibil, utilizați o alternativă la folosirea măștii faciale pentru direcționarea aerului către pacient.
21. Nu utilizați produsul cu masca facială atașată atunci când ventilați sugarii cu hernie congenitală diafragmatică, deoarece există riscul de insuflație. Dacă este posibil, utilizați o alternativă la folosirea măștii faciale pentru direcționarea aerului către pacient.
22. Personalul medical care efectuează procedura trebuie să selecteze dimensiunea resuscitatorului și a accesoriilor (de ex., masca facială, valva PEEP etc.) în funcție de afecțiunile pacientului, deoarece utilizarea incorectă poate vătăma pacientul.
23. Nu utilizați Ambu SPUR II atunci când se impune administrarea de oxigen cu flux liber din cauza posibilei administrări insuficiente a oxigenului, ceea ce poate duce la hipoxie.
24. Capacul manometrului trebuie să fie montat pe portul pentru manometru atunci când presiunea nu este monitorizată pentru a se evita surgerile, care pot duce la reducerea fluxului de O₂ către pacient.
25. Atașați tubul de oxigen la sursa de alimentare cu oxigen la temperaturi peste 0 °C, deoarece montarea poate fi dificilă la temperaturi sub 0 °C, iar montarea incorectă poate duce la reducerea fluxului de oxigen către pacient.
26. Dacă utilizați resuscitatorul cu mască facială atașată, asigurați poziționarea și etanșare corectă a măștii faciale, deoarece o etanșare necorespunzătoare poate duce la transmiterea bolilor infecțioase pe calea aerului către utilizator.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Resuscitatorul nu trebuie să fie depozitat niciodată deformat, pliat în alt mod decât cel în care a fost livrat de producător; în caz contrar se poate produce distorsiunea permanentă a balonului, care poate reduce eficiența ventilăției. Zona de pliere este clar vizibilă pe balon (doar modelele pentru adulți și cele pentru copii pot fi pliate).
2. Urmăriți mișcarea toracelui și ascultați debitul expirator din valva pentru pacient pentru a verifica ventilăția. Treceți imediat la ventilăția gură la gură dacă nu se poate realiza ventilăție cu resuscitatorul.
3. Nu clătiți și nu sterilizați acest dispozitiv, deoarece aceste proceduri pot lăsa reziduuri periculoase sau pot cauza defectarea dispozitivului. Modelul și materialul utilizat nu sunt compatibile cu procedurile convenționale de curățare și sterilizare.
4. Utilizați M-Port doar pentru una dintre următoarele două acțiuni: măsurarea EtCO₂, sau administrarea de medicamente, deoarece acestea pot modifica valorile măsurate.
5. Dacă este cazul, consultați ambalajul accesoriilor pentru informații detaliate despre accesori, deoarece manipularea incorectă poate duce la defectarea întregului produs.
6. Utilizarea produselor și a dispozitivelor de administrare a oxigenului furnizate de terț (de ex., filtre și valve de dozaj) cu resuscitatorul Ambu SPUR II poate influența performanțele produsului. Consultați producătorul dispozitivului terț pentru a verifica compatibilitatea cu resuscitatorul Ambu SPUR II și pentru a obține informații cu privire la posibilele modificări ale performanței.
7. Balonul cu rezervor pentru oxigen este atașat în permanență la valva de admisie de pe resuscitatoarele pentru adulți și copii, cu excepția modelelor cu valvă de dozaj. Nu încercați să îldezamblați. Nu trageți balonul cu rezervor pentru oxigen, deoarece acest lucru poate cauza defectarea dispozitivului.

1.8. Reacții adverse posibile

Reacții adverse posibile asociate cu resuscitarea (nu sunt exhaustive): barotraumă, volutraumă, hipoxie, hipercarbie și pneumonie de aspirație.

1.9. Observații generale

Dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale, se produce un incident grav, raportați acest lucru producătorului și autorității naționale din țara dvs.

2. Descrierea dispozitivului

Resuscitatorul Ambu SPUR II poate fi conectat la manometrul Ambu® de unică folosință, la valvele PEEP Ambu® și la măștile faciale Ambu®, după cum se descrie în secțiunea 4.3 Utilizarea resuscitatorului.

3. Explicarea simbolurilor utilizate

Semnificația simbolului	Descriere
	Adulți Masă corporală ideală mai mare de 30 kg
	Copii Masă corporală ideală între 6 și 30 kg
	Sugari Masă corporală ideală mai mică de 10 kg
	Utilizare pentru RMN în anumite condiții

Semnificația simbolului	Descriere
	Țara producătorului
	Dispozitiv medical
	Utilizare multiplă pentru un singur pacient
	Nu trageți cu forță de balonul cu rezervor pentru oxigen

Lista completă cu explicațiile simbolurilor se află la
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Utilizarea produsului

4.1. Principii de operare

Imaginea 1 arată modul în care amestecul gazos ventilat circulă prin balon, către și dinspre pacient, în timpul operării manuale a resuscitatorului. 1a Resuscitator pentru adulți și copii, 1b resuscitator pentru sugari cu balon cu rezervor pentru oxigen închis (rezervor pentru balon), 1c resuscitator pentru sugari cu tub cu rezervor pentru oxigen deschis (rezervor pentru tub).

Debitul de gaz este similar când pacientul respiră spontan prin intermediul dispozitivului.

Rezervorul pentru oxigen este prevăzut cu două valve, una care permite aerului ambiant să fie aspirat în interior când rezervorul este gol și una care evacuează surplusul de oxigen când balonul rezervorului este plin.

M-Port oferă acces la debitul de gaz inspirator și expirator, permitând conectarea unei seringi pentru administrarea de medicamente 1d sau conectarea unui tub de prelevare a mostrelor de gaz pentru măsurarea EtCO₂ în flux secundar 1e.

1.1 Eliberare de oxigen în exces, 1.2 admisie de aer, 1.3 admisie de oxigen, 1.4 conector pentru pacient, 1.5 expirație, 1.6 port manometru, 1.7 valvă de limitare a presiunii, 1.8 M-Port.

NOTĂ: raccordul la 1,5 poate fi o protecție împotriva stropilor sau o valvă PEEP.

4.2. Inspectia și pregătirea

Resuscitatorul trebuie despachetat și pregătit (trebuie efectuat și un test de funcționare) pentru utilizare imediată înainte de a fi pus în folosință în situațiile de urgență.

4.2.1. Pregătirea

- Dacă resuscitatorul este livrat în ambalaj comprimat, despachați trăgând de valva pentru pacient și de valva de admisie.
- Pregătiți resuscitatorul și puneți toate piesele în geanta de transport livrată odată cu resuscitatorul.
- Dacă masca facială livrată odată cu resuscitatorul este ambalată într-un săculeț protector, acesta trebuie îndepărtat înainte de utilizare.

Consultați secțiunea 4.2.2. (tub oxigen) pentru pregătirea dispozitivului înainte de utilizare la temperaturi sub 0 °C.

4.2.2. Test de funcționare 2

Resuscitatorul

Închideți valva de limitare a presiunii cu clema de decuplare și închideți conectorul pentru pacient cu degetul mare **2.1**. Strângeți cu putere balonul comprimabil. Resuscitatorul se va opune la strângere.

Deschideți valva de limitare a presiunii glisând clema de decuplare și repetând procedura. Valva de limitare a presiunii trebuie să fie acum activată și ar trebui să se poată auzi debitul dinspre valvă în timpul strângerii balonului comprimabil.

Strângeți și eliberați de mai multe ori resuscitatorul pentru a vă asigura că aerul circulă prin sistemul cu valvă și că este evacuat prin valva pentru pacient. **2.2**

NOTĂ: Deoarece discurile valvei se mișcă pe durata testului de funcționare sau a ventilării, este posibil să se audă un mic zgomot. Acest lucru nu pune în pericol funcționarea resuscitatorului.

Tubul de oxigen

Montarea tubului de oxigen și testarea funcționării balonului cu rezervor pentru oxigen și a tubului cu rezervor pentru oxigen trebuie efectuate la temperaturi peste 0 °C. Pentru utilizarea resuscitatorului la temperaturi sub 0 °C, lăsați tubul de oxigen conectat la sursa de oxigen după ce ați testat funcționarea.

Balonul cu rezervor pentru oxigen

Furnizați un flux de gaz de 10 l/min la conectorul de admisie pentru oxigen. În cele din urmă, desfaceți balonul cu mâna. Verificați dacă balonul rezervorului pentru oxigen se umple. În caz contrar, verificați integritatea clapetelor celor două valve sau dacă rezervorul pentru oxigen nu este deteriorat.

Ulterior, reglați debitul de gaz furnizat conform indicațiilor medicale.

Tubul rezervorului de oxigen

Furnizați un flux de gaz de 10 l/min la conectorul de admisie pentru oxigen. Verificați ca oxigenul să fie evacuat la capătul tubului rezervorului pentru oxigen. În caz contrar, verificați ca tubul de oxigen să nu fie blocat. Ulterior, reglați debitul de gaz furnizat conform indicațiilor medicale.

M-Port

Îndepărtați capacul M-Port și blocați conectorul pacientului. Strângeți balonul și ascultați cum aerul este evacuat prin M-Port. **2.3**

4.3. Utilizarea resuscitatorului

- Utilizați tehnici recomandate pentru a elibera gura și căile respiratorii ale pacientului și pentru a așeza pacientul într-o poziție corectă în vederea deschiderii căilor respiratorii.
- Aplicați masca facială etanș pe fața pacientului. **3.1**
- Introduceți mâna (modelul pentru adulți) sau degetul inelar și cel mijlociu (modelul pentru copii) sub mâner. Modelul pentru sugari nu este prevăzut cu mâner. Ventilația fără utilizarea mânerului se poate realiza prin rotirea balonului. **3.2** Ventilația pacientului: În timpul insuflației, observați dacă toracele se ridică. Eliberați brusc balonul din mâină, ascultați debitul expirator din valva pentru pacient și urmăriți mișcarea de coborâre a toracelui.
- Dacă întâmpinați rezistență continuă la insuflație, verificați dacă există blocaje la nivelul căilor respiratorii și reposiționați pacientul pentru a vă asigura că sunt deschise căile respiratorii.
- Dacă pacientul vomită în timpul ventilației, eliberați imediat căile respiratorii ale pacientului și evacuați voma din resuscitator prin scuturare și comprimare rapidă, cu forță, de câteva ori înainte de reluarea ventilației. Dacă este necesar, ștergeți produsul cu o cărpă cu alcool și curățați protecția împotriva stropilor.

Portul pentru manometru

Manometrul Ambu de unică folosință sau indicatorul de presiune produs de o terță parte poate fi atașat la portul pentru manometru, situat pe partea superioară a valvei pentru pacient. Îndepărtați capacul și montați manometrul/indicatorul de presiune.

Sistem de limitare a presiunii 4

Valva de limitare a presiunii este setată să se deschidă la 40 cm H₂O (4,0 kPa). 4.1

Dacă evaluarea medicală și de specialitate indică necesitatea unei presiuni mai mari de 40 cm H₂O, valva de limitare a presiunii poate fi reglată prin deplasarea clemei de decuplare pe valvă. 4.2

De asemenea, valva de limitare a presiunii poate fi deconectată plasând un deget pe butonul roșu în timp ce strângeți balonul.

M-Port

Resuscitatorul Ambu SPUR II se livrează cu sau fără M-Port. M-Port asigură accesul la fluxul de gaz inspirator și expirator și poate fi utilizat pentru administrarea medicamentelor, dacă este conectat la o seringă, precum și pentru măsurarea CO₂ în flux secundar (EtCO₂). Când nu este utilizat, nu uitați să închideți portul M-Port cu capacul roșu pentru M-Port.

Măsurarea EtCO₂

Pentru măsurarea EtCO₂ în flux secundar, conectați tubul de prelevare a mostrelor de gaz pentru dispozitivul de măsurare EtCO₂ la portul M-Port al resuscitatorului Ambu SPUR II. Raciordăți conectorul tubului de prelevare a mostrelor de gaz montându-l și rotindu-l cu un sfert de rotație în sensul acelor de ceasornic.

Administrarea de medicamente

Observați cu atenție răspunsul pacientului la medicamentele administrate. Administrarea unui volum de 1 ml sau mai mare de lichid prin M-Port este comparabilă cu administrarea directă printr-un tub de intubație. M-Port a fost testat cu epinefrină, lidocaină și atropină.

Model de resuscitator Ambu SPUR II cu valvă de dozaj 5

Modelul resuscitatorului Ambu SPUR II cu valvă de dozaj este disponibil pentru mărimile pentru adulți și copii și poate fi utilizat cu sau fără valvă de dozaj, fiind livrat împreună cu un balon detașabil cu rezervor pentru oxigen.

Valva de admisie a resuscitatorului Ambu SPUR II se conectează la valva de dozaj printr-un adaptor.

Atașarea valvei de dozaj:

- Îndepărtați rezervorul pentru oxigen de pe valva de admisie a resuscitatorului Ambu SPUR II, dacă este atașat.
- Ataşați adaptorul la sistemul cu valvă de dozaj.
- Introduceți adaptorul valvei de dozaj în valva de admisie a resuscitatorului Ambu SPUR II.

NOTĂ: Utilizați numai piesa etichetată „compression unit” (unitate de compresie) cu adaptorul și cu valva de dozaj. Piesa cu eticheta „Oxygen Reservoir Bag” (balon cu rezervor pentru oxigen) este considerată de rezervă și se folosește în cazul în care valva de dozaj se defectează.

Administrarea oxigenului

Administrați oxigen conform indicațiilor medicale.

Figura 6 prezintă procentele calculate de oxigen administrat, care pot fi obținute în funcție de diversele volume și frecvențe de ventilație la debite de gaz diferite. Procentele de oxigen pot fi consultate pentru 6.1 Adulti 6.1, Copii 6.2, Nou-născuți 6.3.

Balonul cu rezervor pentru oxigen 7

Folia subțire din plastic a balonului cu rezervor pentru oxigen nu poate fi desprinsă din punctul de fixare de pe resuscitator.

Accesorii 8

Conectorii resuscitatorului Ambu SPUR II respectă cerințele standardelor ISO 5356-1 și EN 13544-2, astfel încât aparatul este conform cu alte echipamente spitalicești. În cazul în care conectați dispozitive externe, testați funcționarea acestora și consultați instrucțiunile de utilizare care le însoțesc.

Produsele Ambu compatibile cu resuscitatorul Ambu SPUR II sunt menționate mai jos:

Mască facială Ambu®, de unică folosință

Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de utilizare pentru masca facială Ambu de unică folosință.

Valva Ambu® PEEP 20 de unică folosință 8.1 8.2

Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de utilizare ale valvei Ambu PEEP 20 de unică folosință sau consultați ilustrația 8.1 din aceste Instrucțiuni de utilizare. Pentru a monta valva Ambu PEEP 20 de unică folosință (dacă este necesar) la resuscitator, îndepărtați apărătoarea de protecție împotriva stropilor. 8.2

Manometru Ambu® de unică folosință 8.3

Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile de utilizare a manometrului Ambu de unică folosință.

4.4. După utilizare

Produsele folosite trebuie eliminate în conformitate cu procedurile locale.

5. Specificațiile tehnice ale produsului

5.1. Standarde aplicate

Resuscitatorul Ambu SPUR II este în conformitate cu standardul de produs EN ISO 10651-4.

5.2. Specificații

	Sugari	Copii	Adulți
Volum resuscitator	aprox. 220 ml	aprox. 670 ml	aprox. 1.510 ml
Volum administrat cu o mână*	150 ml	450 ml	600 ml
Volum administrat cu două mâini**	-	-	1.000 ml
Dimensiuni (lungime x diametru) fără rezervor și accesori	aprox. 190 x 71 mm	aprox. 223 x 99 mm	aprox. 284 x 127 mm

	Sugari	Copii	Adulți
Greutate fără rezervor și accesori	aprox. 70 g	aprox. 145 g	aprox. 220 g
Valva de limitare a presiunii**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Punct mort	≤5 ml + 10 % din volumul administrat	≤5 ml + 10 % din volumul administrat	≤5 ml + 10 % din volumul administrat
Rezistență la inspirație***	max. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) la 5 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) la 50 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) la 50 l/min
Rezistență la expirație***	max. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) la 5 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) la 50 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) la 50 l/min
Volum rezervor	aprox. 300 ml (balon) aprox. 100 ml (tub)	aprox. 2.600 ml (balon)	aprox. 2.600 ml (balon)
Conector pacient		Exterior 22 mm tată (ISO 5356-1) Interior 15 mm mamă (ISO 5356-1)	
Conector expirator (pentru atașare la valva PEEP)		30 mm tată (ISO 5356-1)	
Conector orificiu manometru		Ø 4,2 +/-0,1 mm	
Conector valvă de dozaj	-	Interior 32 mm mamă (EN ISO 10651-4)	
Scurgere în amonte și în aval		Nu se poate măsura	
M-Port		Conector compatibil cu EN ISO 80369-7	
Conector admisie O ₂		Conform EN 13544-2	
Limite de temperatură de utilizare		-18 – +50 °C (-0,4 – +122 °F), testat conform EN ISO 10651-4	
Limite de temperatură pentru depozitare		-40 – +60 °C (-40 – +140 °F), testat conform EN ISO 10651-4	
Depozitare recomandată pe termen lung în ambalaj închis, la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.			

* Testat conform EN ISO 10651-4.

** Reglând valva de limitare a presiunii se poate obține o presiune de alimentare mai mare.

*** În condiții generale de testare, conform EN ISO 10651-4.

5.3. Informații privind siguranța pentru IRM



Resuscitatorul Ambu SPUR II¹, resuscitatorul Ambu SPUR II cu valva Ambu PEEP 20 de unică folosință² și resuscitatorul Ambu SPUR II cu valva Ambu PEEP 20 de unică folosință și cu manometrul Ambu de unică folosință² trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a putea fi utilizate pentru RMN și, prin urmare, pot fi utilizate în siguranță în mediul RMN (nu în interiorul tubului pentru RMN) în următoarele condiții.

Câmp magnetic static de 7 tesla și mai puțin, cu

- Gradient spațial maxim al câmpului de
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²
- Produs cu forță maximă de
 - 450.000.000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G²/cm (721 T²/m)²

Utilizarea în interiorul tubului pentru RMN poate influența calitatea imaginii de RMN.

Încălzirea indusă de RF și artefactele de imagine RMN nu au fost testate. Componentele metalice sunt complet încapsulate și nu intră în contact cu corpul uman.

1. Важная информация – Прочтите перед использованием

Перед использованием ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu® SPUR® II внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по безопасности. Инструкция по эксплуатации может быть обновлена без дополнительного уведомления. Копии текущей версии предоставляются по запросу. Обратите внимание на то, что в настоящих инструкциях не объясняются и не описываются клинические процедуры. В инструкции описаны только основные манипуляции и меры предосторожности, связанные с использованием ручного аппарата искусственной вентиляции легких. Перед первым использованием ручного аппарата искусственной вентиляции легких операторы должны пройти соответствующее обучение методикам реанимации и ознакомиться с назначением, предупреждениями, мерами предосторожности и показаниями, перечисленными в настоящей инструкции. Для ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II гарантия не предусмотрена.

1.1. Назначение

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II относится к ручным аппаратам искусственной вентиляции легких для индивидуального использования, предназначенных для легочной реанимации.

1.2. Показания к применению

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II предназначен для использования в ситуациях, когда для вспомогательной вентиляции требуется ручной аппарат сердечно-легочной реанимации.

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II предназначен для вентиляции и оксигенации пациентов в период до обеспечения более полного контроля над проходимостью дыхательных путей или восстановления пациента.

1.3. Возрастная группа

Диапазон размеров пациента при применении каждой модели:

- **Версия для взрослых:** взрослые и дети с массой тела более 30 кг (66 фунтов);
- **Версия для детей:** младенцы и дети с массой тела от 6 кг до 30 кг (13–66 фунтов);
- **Версия для младенцев:** новорожденные и младенцы с массой тела до 10 кг (22 фунта).

Обратите внимание, что не все конфигурации ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II доступны для всех трех категорий пациентов.

1.4. Предполагаемые пользователи

Медицинские специалисты, имеющие квалификацию в области поддержания проходимости дыхательных путей, такие как анестезиологи, медсестры, спасатели и работники экстренных служб.

1.5. Противопоказания

Неизвестны.

1.6. Клинические преимущества

Основной метод поддержания проходимости дыхательных путей с использованием ручного аппарата искусственной вентиляции легких позволяет проводить вентиляцию и оксигенацию пациента до обеспечения более полного контроля над проходимостью дыхательных путей или восстановления пациента.

1.7. Предупреждения и меры предосторожности

Несоблюдение перечисленных мер предосторожности может повлечь за собой снижение эффективности вентиляции и оксигенации пациента или повреждение оборудования.

ВНИМАНИЕ!



1. Во избежание риска инфекции запрещается использовать ручной аппарат искусственной вентиляции легких в течение более 4 накопленных часов за максимальный период времени 1 неделя.
2. Во избежание риска инфекции и неправильной работы запрещается использовать ручной аппарат искусственной вентиляции легких повторно, если внутри него осталась видимая влага или остатки.
3. Убедитесь, что к порту выдоха подсоединен защитный колпачок или клапан Ambu PEEP. Открытый порт выдоха может быть случайно заблокирован и привести к образованию избыточного объема воздуха в легких, что может привести к травмированию тканей.
4. Во избежание повреждения тканей не используйте ручной аппарат искусственной вентиляции легких в токсичной или опасной среде.
5. Всегда следите, чтобы трубка кислородного резервуара не была засорена, поскольку засорение трубы может препятствовать дальнейшему надуванию сжимаемого мешка, что может привести к невозможности вентиляции.
6. Запрещается использовать изделие, если оно имеет попавшие извне загрязнения, так как это может привести к инфекции.
7. Всегда визуально обследуйте изделие и выполняйте проверку работоспособности после распаковки, сборки и перед использованием, поскольку дефекты и посторонние предметы могут привести к отсутствию или уменьшению вентиляции у пациента.
8. Запрещается использовать изделие, если не проведена проверка работоспособности: это может привести к отсутствию или снижению уровня вентиляции у пациента.
9. Запрещается вручную блокировать клапан ограничения давления, если только на необходимость этого не указывает медицинская оценка. Высокое давление вентиляции может вызвать баротравму.

10. Предназначен для индивидуального использования. Использование для нескольких пациентов может привести к перекрестному инфицированию.
11. Лекарство нельзя вводить через М-порт, если между ручным аппаратом искусственной вентиляции легких и лицевой маской подключены принадлежности (например, фильтр, детектор CO₂).
12. Не оставляйте М-порт открытым после использования во избежание утечки, которая может привести к снижению подачи O₂ пациенту.
13. М-порт не должен использоваться для мониторинга EtCO₂ в боковом потоке у пациентов, которым выполняют вентиляцию с дыхательным объемом менее 400 мл, во избежание неточных измерений EtCO₂.
14. При введении лекарственного средства объемом менее 1 мл необходимо промыть М-порт для обеспечения точной дозировки лекарственного средства.
15. Не присоединяйте трубку подачи кислорода к М-порту, так как в этом случае не будет обеспечена ожидаемая концентрация O₂.
16. Установка принадлежностей может увеличить сопротивление вдоху и (или) выдоху. Не устанавливайте принадлежности, если сопротивление дыханию будет оказывать неблагоприятное воздействие на пациента.
17. Прибор применять использовать только тем предполагаемым пользователям, которые ознакомлены с данным руководством, поскольку некорректное использование может причинить вред пациенту.
18. При использовании дополнительного кислорода не допускайте курения и использования прибора вблизи открытого огня, масла, смазки, других горючих химических веществ, оборудования или инструментов, которые могут вызвать появление искры, поскольку это может создать риск возгорания и (или) взрыва.
19. Не пытайтесь устанавливать клапаны подачи кислорода по требованию на версии для младенцев, так как это может привести к повышению концентрации кислорода, что может представлять опасность для новорожденных.

20. При использовании ручного аппарата искусственной вентиляции легких, присоединенного к лицевой маске, следует обращать внимание на признаки полной/частичной обструкции верхних дыхательных путей, поскольку это приведет к отсутствию или ограничению подачи кислорода. Если есть альтернатива лицевой маске для подачи воздуха пациенту, всегда используйте ее.
21. Запрещается использовать изделие с присоединенной лицевой маской при вентиляции младенцев с врожденной диафрагмальной грыжей из-за риска инсуффляции. Если есть альтернатива лицевой маске для подачи воздуха пациенту, используйте ее.
22. Специалисты, выполняющие данную процедуру, должны оценить выбор размера ручного аппарата искусственной вентиляции легких и принадлежностей (например, лицевой маски, клапана PEEP и т.д.) с учетом состояния конкретного пациента, так как некорректное использование может причинить вред пациенту.
23. Запрещается использовать Ambu SPUR II при необходимости подачи свободного потока кислорода из-за возможного недостаточного введения кислорода, что может привести к гипоксии.
24. Если мониторинг давления не ведется, нужно обязательно установить колпачок манометра на порт манометра во избежание утечки, которая может привести к снижению подачи O_2 к пациенту.
25. Всегда предварительно присоединяйте кислородную трубку к источнику кислорода при температурах выше 0 °C, так как при температурах ниже 0 °C установка может затрудняться, что приводит к снижению подачи кислорода пациенту.
26. При использовании ручного аппарата искусственной вентиляции легких с присоединенной лицевой маской убедитесь в правильном расположении и герметичности лицевой маски, поскольку ненадлежащая герметизация может привести к появлению воздушно-капельного инфекционного заболевания у пользователя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Ни при каких обстоятельствах не храните ручной аппарат искусственной вентиляции легких в деформированном состоянии, кроме случаев, когда он поставляется изготовителем в сложенном состоянии, в противном случае возможна необратимая деформация дыхательного мешка, что может снизить эффективность вентиляции. Место складки четко видно на дыхательном мешке (складывать можно только версии для взрослых и детей).
2. Всегда следите за движениями грудной клетки и прислушивайтесь к выходному потоку воздуха из клапана пациента, чтобы контролировать вентиляцию. Если вентиляция с помощью ручного аппарата искусственной вентиляции легких невозможна, немедленно переходитите на вентиляцию методом рот-в-рот.
3. Не замачивайте, не мойте и не стерилизуйте данное устройство, поскольку в результате этих процедур на нем могут оставаться остатки опасных веществ или это может привести к нарушению работы устройства. Конструкция устройства и используемый в нем материал несовместимы с традиционными процедурами обработки и стерилизации.
4. Используйте M-порт только для одной из двух целей: измерения EtCO₂ или введения лекарственного средства, так как это может привести к изменению измеренных значений.
5. Изучите более подробную информацию об отдельных принадлежностях на упаковке принадлежностей (если применимо), поскольку некорректное обращение может привести к нарушению работы всего изделия.
6. Использование продукции сторонних производителей и устройств подачи кислорода (например, фильтров и клапанов для подачи кислорода по требованию) с ручным аппаратом искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II может повлиять на работу изделия. Для проверки совместимости с ручным аппаратом искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II и получения информации о возможных изменениях эффективности обратитесь к производителю стороннего устройства.

7. Кислородный мешок в ручных аппаратах искусственной вентиляции легких для взрослых и детей неразъемно прикреплен к входному клапану, за исключением версий с клапаном подачи кислорода по требованию. Не пытайтесь разбирать. Не тяните за кислородный мешок, так как это может привести к нарушению работы устройства.

1.8. Потенциальные нежелательные явления

Потенциальные нежелательные явления, связанные с реанимацией (список не исчерпывающий): баротравма, волюмотравма, гипоксия, гиперкапния и аспирационная пневмония.

1.9. Общие примечания

Если во время или в результате использования данного устройства произойдет серьезное происшествие, сообщите об этом изготовителю и в местные органы власти.

2. Описание устройства

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II можно подключать к одноразовому манометру Ambu®, клапанам Ambu® PEEP и лицевым маскам Ambu®, как описано в разделе 4.3 «Эксплуатация ручного аппарата искусственной вентиляции легких».

3. Пояснение используемых символов

Символическое обозначение	Описание
	Взрослые Предполагаемая идеальная масса тела: более 30 кг

Символическое обозначение	Описание
	Дети Предполагаемая идеальная масса тела: от 6 до 30 кг
	Младенцы Предполагаемая идеальная масса тела: до 10 кг
	MR-совместимый
	Страна-изготовитель
	Медицинское изделие
	Для индивидуального многоразового использования
	Не тяните за кислородный мешок с усилием

Полный список пояснений для символов можно найти на сайте
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Использование изделия

4.1. Принцип работы

На рисунке 1 приводится направление потока газовой смеси вентиляции в дыхательный мешок, а также к пациенту и от него во время работы ручного аппарата искусственной вентиляции легких. 1а Ручной аппарат искусственной вентиляции легких для взрослых и детей, 1б ручной аппарат искусственной вентиляции легких для младенцев с закрытым кислородным мешком (мешок-резервуар), 1с ручной аппарат искусственной вентиляции легких для младенцев с открытой трубкой кислородного резервуара (трубка-резервуар).

Поток газа остается практически таким же, если у пациента проявляется спонтанное дыхание через устройство.

Кислородный резервуар снабжен двумя клапанами: один позволяет поступать воздуху извне при пустом резервуаре, а другой выпускает избыточный кислород при полном кислородном мешке.

М-порт обеспечивает доступ к потоку вдыхаемого и выдыхаемого газа, что позволяет присоединять шприц для введения лекарства 1д или линию отбора проб газа для измерения в боковом потоке EtCO₂ 1е.

1.1 Выброс избыточного кислорода, 1.2 вход для воздуха, 1.3 вход для кислорода, 1.4 разъем подключения пациента, 1.5 выдох, 1.6 порт манометра, 1.7 клапан ограничения давления, 1.8 М-порт.

ПРИМЕЧАНИЕ. К 1.5 можно присоединить защитный колпачок либо клапан PEEP.

4.2. Осмотр и подготовка

Прежде чем ручной аппарат искусственной вентиляции легких будет готов к применению в неотложных ситуациях, его необходимо распаковать и подготовить к немедленному использованию (в том числе выполнить функциональную проверку).

4.2.1. Подготовка

- Если ручной аппарат искусственной вентиляции легких упакован в сложенном виде, разверните его, потянув за клапан пациента и входной клапан.
- Подготовьте ручной аппарат искусственной вентиляции легких и поместите все элементы в сумку для переноски, поставляемую вместе с ручным аппаратом искусственной вентиляции легких.
- Если поставляемая с ручным аппаратом искусственной вентиляции легких лицевая маска помещена в защитную упаковку, перед использованием упаковку следует снять.

См. раздел 4.2.2. (Кислородная трубка) для подготовки устройства к использованию при температуре ниже 0 °C.

4.2.2. Проверка работоспособности 2

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких

Закройте клапан ограничения давления с помощью зажима блокировки и закройте разъем подключения пациента большим пальцем 2.1. Резко сожмите сжимаемый мешок. Ручной аппарат искусственной вентиляции легких должен оказывать сопротивление сжатию.

Откройте клапан ограничения давления, сдвинув зажим блокировки, и повторите процедуру. Теперь клапан ограничения давления должен активироваться, и должен быть слышен поток воздуха из клапана во время резкого сжатия сжимаемого мешка.

Несколько раз сожмите и отпустите ручной аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы убедиться в том, что воздух проходит через клапанную систему и клапан пациента. 2.2

ПРИМЕЧАНИЕ. Поскольку во время проверки работоспособности или в процессе вентиляции происходит движение тарелок клапана, возможен слабый шум. Это не снижает эффективности работы ручного аппарата искусственной вентиляции легких.

Кислородная трубка

Установка кислородной трубки и проверка работоспособности кислородного мешка и трубы кислородного резервуара должны выполняться при температурах выше 0 °C. При использовании ручного аппарата искусственной вентиляции легких при температурах ниже 0 °C оставьте кислородную трубку подсоединеной к источнику кислорода после проверки работоспособности.

Кислородный мешок

Подавайте поток газа со скоростью 10 л/мин на вход для кислорода. В конце вручную помогите мешку развернуться. Убедитесь, что кислородный мешок наполняется. Если наполнения не происходит, проверьте работу двух створок клапанов и убедитесь в отсутствии разрывов кислородного резервуара.

Затем отрегулируйте подачу газа в соответствии с медицинскими показаниями.

Трубка кислородного резервуара

Подавайте поток газа со скоростью 10 л/мин на вход для кислорода. Убедитесь в том, что кислород выходит из конца трубы кислородного резервуара. Если этого не происходит, проверьте, не засорена ли кислородная трубка. Затем отрегулируйте подачу газа в соответствии с медицинскими показаниями.

M-порт

Снимите колпачок M-порта и заблокируйте разъем подключения пациента. Сожмите мешок и прислушайтесь к шуму воздуха, выходящего под давлением из M-порта. **2.3**

4.3. Эксплуатация ручного аппарата искусственной вентиляции легких

- Используя рекомендованные методики, очистите рот и дыхательные пути пациента и расположите пациента таким образом, чтобы открыть дыхательные пути.
- Плотно прижмите лицевую маску к лицу пациента. **3.1**

- Поместите руку (версия для взрослых) или безымянный и средний пальцы (версия для детей) под рукоятку. Версия для младенцев не оснащена опорной рукояткой. Вентиляцию без использования опорной рукоятки можно вести путем поворота мешка. **3.2** Вентиляция пациента: во время вдувания следите за подъемом грудной клетки. Резко разжимайте руку, держащую мешок, прислушивайтесь к потоку выдыхаемого воздуха через клапан пациента и следите за опусканием грудной клетки.

- Если наблюдается постоянное сопротивление вдуванию, проверьте дыхательные пути на предмет обструкции и измените положение пациента, чтобы дыхательные пути были открыты.
- Если во время вентиляции у пациента возникает рвота, немедленно очистите дыхательные пути пациента и удалите рвоту из ручного аппарата искусственной вентиляции легких, несколько раз сильно и быстро встряхнув и скав его, прежде чем возобновлять вентиляцию. При необходимости протрите изделие тканью, смоченной спиртом, и очистите защитный колпачок водой.

Порт манометра

Одноразовый манометр Ambu Disposable Pressure Manometer, а также датчик давления стороннего производителя можно подключить к порту манометра, расположенному в верхней части клапана пациента. Снимите колпачок и установите манометр/датчик давления

Система ограничения давления **4**

Клапан ограничения давления настроен на открытие при 40 см H_2O (4,0 кПа). **4.1**

Если по медицинским и профессиональным оценкам требуется давление выше 40 см H_2O , можно заблокировать клапан ограничения давления перемещением зажима блокировки на клапан. **4.2**

Можно также воспользоваться другим способом блокировки клапана ограничения давления, а именно нажать пальцем на красном кнопку при одновременном сжатии мешка.

M-порт

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II поставляется с M-портом или без него. M-порт обеспечивает доступ к потоку вдыхаемого и выдыхаемого газа и может использоваться для введения лекарственного средства с подключением шприца, а также для измерения в боковом потоке CO₂ (EtCO₂). Неиспользуемый M-порт следует закрыть красным колпачком M-порта.

Измерение EtCO₂

Для измерения в боковом потоке EtCO₂ подключите линию отбора проб газа для измерительного устройства EtCO₂ к M-порту ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II. Подсоедините коннектор линии отбора проб газа, установив и повернув его на 1/4 оборота по часовой стрелке.

Ввод лекарственного препарата

Внимательно следите за реакцией пациента на введенное лекарственное средство. Ввод объемов жидкости на уровне 1 мл и выше через M-порт сопоставим с непосредственным вводом в эндотрахеальную трубку. M-порт прошел испытания с использованием эpineфрина, лидокаина и атропина.

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II, версия с клапаном подачи кислорода по требованию 5

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II версии с клапаном подачи кислорода по требованию доступен в размерах для взрослых и детей, может использоваться как с клапаном подачи кислорода по требованию, так и без него, и поставляется с присоединяемым кислородным мешком.

Входной клапан ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II соединяется с клапаном подачи кислорода по требованию через адаптер.

Установка клапана подачи кислорода по требованию:

- Отсоедините блок кислородного резервуара от входного клапана ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II, если он установлен.

- Присоедините адаптер к клапану подачи кислорода по требованию.

- Вставьте адаптер клапана подачи кислорода по требованию во входной клапан ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II.

ПРИМЕЧАНИЕ. С адаптером и клапаном подачи кислорода по требованию используйте только детали с маркировкой «компрессионный блок». В случае отказа клапана подачи кислорода по требованию в качестве резерва предполагается деталь, обозначенная как «кислородный мешок».

Введение кислорода

Введение кислорода должна производиться в соответствии с медицинскими показаниями.

На рисунке 6 показаны расчетные процентные значения подаваемого кислорода, которые могут быть получены при различных объемах и частотах вентиляции при разных скоростях потока газа. Процентные значения кислорода можно увидеть для версий для 6 взрослых 6.1, детей 6.2, младенцев 6.3.

Кислородный мешок 7

Тонкую пластиковую фольгу кислородного мешка никогда нельзя отсоединять от места фиксации к ручному аппарату искусственной вентиляции легких.

Принадлежности 8

Коннекторы ручного аппарата искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II соответствуют стандартам ISO 5356-1 и EN 13544-2, что делает его совместимым с другим больничным оборудованием. При подключении к ручному аппарату искусственной вентиляции легких внешних устройств обязательно проверьте его работоспособность и ознакомьтесь с прилагаемой к нему инструкцией по эксплуатации.

Ниже перечислены изделия Ambu, совместимые с ручным аппаратом искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II.

Одноразовая лицевая маска Ambu®

Дополнительную информацию см. в указаниях по применению одноразовой лицевой маски Ambu.

Одноразовый клапан Ambu® PEEP 20 8.1 8.2

Дополнительную информацию см. в инструкции по эксплуатации одноразового клапана Ambu PEEP 20 или на иллюстрации 8.1 в данной инструкции по эксплуатации. Для установки одноразового клапана Ambu PEEP 20 (при необходимости) на ручной аппарат искусственной вентиляции легких снимите защитный колпачок. 8.2

Одноразовый манометр Ambu® 8.3

Дополнительную информацию см. в инструкциях по эксплуатации одноразового манометра Ambu Disposable Pressure Manometer.

4.4. После использования

Использованные изделия подлежат утилизации в соответствии с местными правилами.

5. Технические характеристики изделия

5.1. Применяемые стандарты

Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II соответствует стандарту для данной продукции EN ISO 10651-4.

5.2. Технические характеристики

	Младенцы	Дети	Взрослые
Объем аппарата ИВЛ	прибл. 220 мл	прибл. 670 мл	прибл. 1510 мл
Объем воздуха, подаваемый одной рукой*	150 мл	450 мл	600 мл
Объем воздуха, подаваемый двумя руками*	-	-	1000 мл
Размеры (длина x диаметр) без резервуара и принадлежности	прибл. 190 x 71 мм	прибл. 223 x 99 мм	прибл. 284 x 127 мм
Вес без резервуара и принадлежностей	прибл. 70 г	прибл. 145 г	прибл. 220 г
Клапан ограничения давления**	4,0 кПа (40 см H ₂ O)	4,0 кПа (40 см H ₂ O)	4,0 кПа (40 см H ₂ O)
Мертвое пространство	≤ 5 мл + 10 % подаваемого объема	≤ 5 мл + 10 % подаваемого объема	≤ 5 мл + 10 % подаваемого объема
Сопротивление вдоху***	макс. 0,1 кПа (1,0 см H ₂ O) при 5 л/мин	макс. 0,5 кПа (5,0 см H ₂ O) при 50 л/мин	макс. 0,5 кПа (5,0 см H ₂ O) при 50 л/мин
Сопротивление выдоху***	макс. 0,2 кПа (2,0 см H ₂ O) при 5 л/мин	макс. 0,27 кПа (2,7 см H ₂ O) при 50 л/мин	макс. 0,27 кПа (2,7 см H ₂ O) при 50 л/мин
Объем резервуара	прибл. 300 мл (мешок) прибл. 100 мл (трубка)	прибл. 2600 мл (мешок)	прибл. 2600 мл (мешок)
Разъем подключения пациента	Внешний 22 мм, штекерный (ISO 5356-1) Внутренний 15 мм, гнездовой (ISO 5356-1)		

	Младенцы	Дети	Взрослые
Коннектор для выдоха (для присоединения клапана PEEP)		30 мм, штекерный (ISO 5356-1)	
Коннектор порта манометра		Ø 4,2 +/-0,1 мм	
Коннектор клапана подачи кислорода по требованию	-	Внутренний 32 мм, гнездовой (EN ISO 10651-4)	
Прямая и обратная утечка		Не выявляется	
M-порт	Коннектор соответствует EN ISO 80369-7		
Входной коннектор O ₂	В соответствии с EN 13544-2		
Диапазон рабочих температур	от -18 °C до +50 °C (от -0,4 °F до +122 °F), испытано в соответствии с EN ISO 10651-4		
Диапазон температур хранения	от -40 °C до +60 °C (от -40 °F до +140 °F), испытано в соответствии с EN ISO 10651-4		
Длительное хранение рекомендуется в закрытой упаковке при комнатной температуре в месте, защищенном от солнечного света.			

* Испытано в соответствии с EN ISO 10651-4.

** За счет блокировки клапана ограничения давления можно добиться более высокого давления подачи.

*** При общих условиях испытаний, соответствующих EN ISO 10651-4.

5.3. Информация о безопасности при МРТ



Ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II¹, ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II с присоединенным одноразовым клапаном Ambu PEEP 20², и ручной аппарат искусственной вентиляции легких Ambu SPUR II с присоединенным одноразовым клапаном Ambu PEEP 20 и одноразовым манометром Ambu Disposable Pressure Manometer² являются условно совместимыми с

MPT и, следовательно, могут безопасно использоваться во время проведения МРТ (не внутри тоннеля аппарата МРТ) при соблюдении указанных ниже условий.

Статическое магнитное поле 7 Тл и менее, с

- Максимальным пространственным градиентом поля
 - 10,000 гаусс/см (100 Тл/м)¹
 - 16,000 гаусс/см (160 Тл/м)²
- Максимальным влиянием силы
 - 450,000,000 гаусс²/см (450 Тл²/м)¹
 - 721,000,000 гаусс²/см (721 Тл²/м)²

Использование внутри тоннеля аппарата МРТ может влиять на качество МРТ-изображения.

Нагревание, индуцированное РЧ-полем, и артефакты МРТ-изображения не тестировались. Все металлические части полностью инкапсулированы и не вступают в контакт с телом человека.

1. Dôležité informácie – Prečítajte si pred použitím

Pred použitím resuscitátora Ambu® SPUR® II si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny. Návod na použitie sa môže aktualizovať bez oznámenia. Jeho aktuálna verzia je k dispozícii na vyžiadanie. Nezabúdajte, že tento návod nevysvetľuje klinické postupy ani sa nimi nezaoberá. Opisuje len základné úkony a opatrenia súvisiace s činnosťou resuscitátora. Pred prvým použitím resuscitátora je nevyhnutné, aby bola jeho obsluha dostatočne odborne pripravená v oblasti resuscitačných techník a oboznámila sa s určeným použitím, výstrahami, upozorneniami a indikáciami uvedenými v tomto návode. Na resuscitátor Ambu SPUR II sa neposkytuje žiadna záruka.

1.1. Určené použitie

Resuscitátor Ambu SPUR II je resuscitátor na pulmonálnu resuscitáciu určený na použitie u jedného pacienta.

1.2. Indikácie na použitie

Resuscitátor Ambu SPUR II je určený na použitie v situáciach, keď je na asistovanú ventiláciu potrebný ručný kardiopulmonálny resuscitátor.

Resuscitátor Ambu SPUR II je určený na ventiláciu a okysličovanie pacientov, kým nie je možné zabezpečiť účinnejší spôsob ventilácie pacienta, alebo kým sa neobnoví spontánne dýchanie pacienta.

1.3. Určená populácia pacientov

Rozsah použitia pre každú verziu je nasledujúci:

- Verzia pre dospelých:** Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou viac ako 30 kg (66 lb).
- Pediatrická verzia:** Dojčatá a deti s telesnou hmotnosťou od 6 kg do 30 kg (13 – 66 lb).
- Verzia pre dojčatá:** Novorodenci a dojčatá s telesnou hmotnosťou do 10 kg (22 lb).

Pamäťajte na to, že nie všetky konfigurácie resuscitátora Ambu SPUR II sú k dispozícii pre všetky tri okruhy pacientov.

1.4. Určení používateľia

Zdravotnícki pracovníci, ktorí sú vyškolení v oblasti starostlivosti o dýchacie cesty, ako sú napríklad anesteziológovia, zdravotné sestry, záchranári a pracovníci na pohotovosti.

1.5. Kontraindikácie

Žiadne známe.

1.6. Klinické výhody

Základná technika starostlivosti o dýchacie cesty použitím ručného respirátora umožňuje ventiláciu a okysličovanie pacientov, kým nie je možné zabezpečiť účinnejší spôsob ventilácie pacienta, alebo kým sa neobnoví spontánne dýchanie pacienta.

1.7. Výstrahy a upozornenia

Ak tieto preventívne upozornenia nedodržíte, môže to spôsobiť neefektívnu ventiláciu a okysličovanie pacienta alebo poškodenie zariadenia.

VÝSTRAHY

1. Resuscitátor nepoužívajte dlhšie ako celkovo 4 hodiny počas maximálne 1 týždňa, aby sa zabránilo riziku infekcie.
2. Resuscitátor nepoužívajte opakovane, ak v ňom zostane viditeľná vlhkosť alebo zvyšky, aby sa zabránilo riziku infekcie a poruchy.
3. Uistite sa, že k expiračnému portu je pripojený buď chránič proti postriekaniu, alebo ventil Ambu PEEP. Otvorený expiračný port sa môže náhodne zablokovať a viesť k nadmernému objemu vzduchu v plúcach, čo môže viesť k poranieniu tkaniva.
4. Nepoužívajte resuscitátor v toxickej alebo nebezpečnej prostredí, aby ste predišli riziku poškodenia tkaniva.

5. Vždy sa uistite, že hadička zásobného vaku na kyslík nie je upchatá, pretože upchatie hadičky môže zabrániť opäťovnému nafúknutiu kompresného vaku, čo by mohlo znemožniť ventiláciu.
6. Výrobok nepoužívajte, ak je kontaminovaný externými zdrojmi, pretože by to mohlo spôsobiť infekciu.
7. Po vybalení, zmontovaní a pred použitím výrobok vždy vizuálne skontrolujte a vykonajte skúšku funkčnosti, pretože chyby a cudzie telesá môžu viesť k nulovej alebo zniženej ventilácii pacienta.
8. Nepoužívajte výrobok, ak bola skúška funkčnosti neúspešná, pretože to môže viesť k nulovej alebo zniženej ventilácii pacienta.
9. Nepotláčajte funkciu ventilu na obmedzenie tlaku, pokiaľ to nie je nutné na základe lekárskeho posúdenia. Vysoký ventilačný tlak môže spôsobiť barotraumu.
10. Použite len u jedného pacienta. Použitie u iných pacientov môže spôsobiť križovú infekciu.
11. Lieky nie je možné podávať cez port M-port, ak je príslušenstvo (napr. filter, detektor CO₂) pripojené medzi resuscitátorom a tvárovou maskou.
12. Na zabránenie úniku nenechávajte port M-port po použití otvorený, inak by mohlo dôjsť k zniženému prívodu O₂ pacientovi.
13. Port M-Port sa nemá používať na monitorovanie EtCO₂ metódou sidestream u pacientov ventilovaných s dychovým objemom nižším ako 400 ml, aby sa zabránilo nepresným meraniam EtCO₂.
14. Pri podávaní liekov s objemom menej ako 1 ml je potrebné prepláchnuť port M-Port na zaistenie podania presnej dávky liečiva.
15. K portu M-port nepripájajte hadičku na prívod kyslíka, pretože pacientovi sa nebude dodávať správna koncentrácia O₂.
16. Pridaním príslušenstva sa môže zvýšiť odpor pri nádychu a/alebo výdychu. Príslušenstvo nepripájajte, ak by zvýšený odpor pri dýchaní mohol byť pre pacienta škodlivý.
17. Túto pomôcku smú používať len určení používateľa, ktorí sú oboznámení s obsahom tohto návodu, pretože nesprávne používanie môže ubližiť pacientovi.
18. Pri používaní doplnkového kyslíka nefajčte ani pomôcku nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa, oleja, mazív a iných horľavých chemikálií alebo vybavenia a nástrojov, ktoré generujú iskry, pretože hrozí riziko požiaru a/alebo výbuchu.
19. Nepokúšajte sa pripojiť žiadnu plúcnu automatiku k verzii pre dojčatá, pretože to môže spôsobiť vysokú koncentráciu kyslíka, ktorá môže byť pre novorodencov škodlivá.
20. Pri používaní resuscitátora pripojeného k tvárovej maske si dávajte pozor na známky zablokovania horných dýchacích ciest, pretože to vedie k nulovému alebo obmedzenému prívodu kyslíka. Ak je to možné, vždy použite namiesto tvárovej masky inú alternatívnu, aby ste nasmerovali vzduch do plúc pacienta.
21. Výrobok s nasadenou tvárovou maskou nepoužívajte pri ventilácii detí s vrodenou herniou bránice z dôvodu rizika insuflácie. Ak je to možné, použite namiesto tvárovej masky inú alternatívnu, aby ste nasmerovali vzduch do plúc pacienta.
22. Odborníci vykonávajúci postup by mali posúdiť výber veľkosti resuscitátora a príslušenstva (napr. tvárová maska, ventil PEEP atď.) v súlade so špecifickým stavom pacienta, pretože nesprávne použitie môže pacientovi ubližiť.
23. Nepoužívajte Ambu SPUR II, ak je potrebná dodávka kyslíka s voľným prietokom z dôvodu možného nedostatočného prísunu kyslíka, čo môže viesť k hypoxii.
24. Keď sa tlak nemonitoruje, na porte manometra musí byť vždy umiestnený kryt manometra na zabránenie netesnosti, čo môže viesť k zniženému prívodu O₂ pacientovi.
25. Vždy vopred pripojte kyslikovú hadičku k prívodu kyslíka pri teplote nad 0 °C, pretože pripojenie môže byť pri teplotách pod 0 °C náročné, čo môže viesť k zniženiu prívodu kyslíka pacientovi.
26. Pri použití resuscitátora s pripojenou tvárovou maskou sa uistite, že maska je správne umiestnená a tesní na tvári, pretože nesprávne utesnenie môže viesť k prenosu infekčného ochorenia prenášaného vzduchom na používateľa.

UPOZORNENIA

1. Resuscitátor pri uskladnení nikdy neskladajte inak, ako je preložený pri dodávke od výrobcu, inak by mohlo dojst' k trvalej deformácii vaku, ktorá môže znížiť efektivitu ventilácie. Miesto preloženia je na vaku jasne viditeľné (preložiť sa môžu len verzie pre dospelých a pediatrická verzia).
2. Vždy pozorujte pohyb hrudníka a počúvajte prúdenie vzduchu z ventilu pacienta pri výdychu, aby ste kontrolovali ventiláciu. Ak nie je možné zabezpečiť ventiláciu pomocou resuscitátora, okamžite prejdite na umelé dýchanie z úst do úst.
3. Pomôcku neponárajte, neoplachujte ani nesterilizujte, pretože pri týchto postupoch môžu na nej zostať škodlivé zvyšky alebo môže dojst' k jej poruche. Použité konštrukčné riešenia a materiál nie sú kompatibilné s bežnými postupmi pri čistení a sterilizácii.
4. Port M-Port používajte len na jednu z dvoch možností: meranie EtCO₂ alebo podávanie liekov, pretože to môže zmeniť namerané hodnoty.
5. V prípade potreby si pozrite podrobnejšie informácie o jednotlivých kusoch príslušenstva na ich obale, pretože nesprávna manipulácia môže viesť k poruche celého výrobku.
6. Použitie produktov od iných výrobcov a zariadení na prívod kyslíka (ako sú napr. filtre a plúcne automaty) s resuscitátorom Ambu SPUR II môže mať vplyv na výkonnosť výrobku. Na overenie kompatibility s resuscitátorom Ambu SPUR II a získanie informácií o možných zmenách výkonu sa obráťte na výrobcu zariadenia tretej strany.
7. Zásobný vak na kyslík je trvalo pripojený k prívodnému ventilu na resuscitátoroch pre dospelých a pediatrických pacientov s výnimkou verzí s plúcnowou automatikou. Nepokúsajte sa o demontáž. Neťahajte za zásobný vak na kyslík, pretože to môže spôsobiť poruchu pomôcky.

1.8. Potenciálne nežiaduce udalosti

Potenciálne nežiaduce udalosti súvisiace s resuscitáciou (okrem iného): barotrauma, volutrauma, hypoxia, hyperkapnia a aspiračná pneumónia.

1.9. Všeobecné poznámky

Ak počas používania tejto pomôcky alebo v dôsledku jej používania dojde k váznej nehode, ohláste to výrobcovi a štátному orgánu.

2. Popis pomôcky

Resuscitátor Ambu SPUR II sa môže pripojiť k jednorazovému manometru Ambu®, ventilom Ambu® PEEP a tvárovým maskám Ambu®, ako je opísané v časti 4.3 Používanie resuscitátora.

3. Vysvetlenie použitých symbolov

Indikácia symbolov	Opis
	Verzia pre dospelých Určená ideálna telesná hmotnosť väčšia ako 30 kg
	Pediatrická verzia Určená ideálna telesná hmotnosť od 6 do 30 kg
	Verzia pre dojčatá Určená ideálna telesná hmotnosť do 10 kg
	Bezpečné pri zachovaní stanovených podmienok MR
	Krajina výrobcu

Indikácia symbolov	Opis
	Zdravotnícka pomôcka
	Na opakované použitie u jedného pacienta
	Neťahajte nasilu zásobný vak na kyslík

Úplný zoznam vysvetliviek k symbolom nájdete na webovej lokalite
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Použitie výrobku

4.1. Princíp použitia

Na obrázku 1 je znázornené, ako počas manuálneho používania resuscitátora zmesi ventilačného plynu prúdi do vaku, do plúc a von z plúc pacienta. 1a Resuscitátor pre dospelých a deti, 1b resuscitátor pre dojčatá s uzavretým zásobným vakom na kyslík (zásobný vak), 1c resuscitátor pre dojčatá s otvorenou hadičkou zásobného vaku na kyslík (hadička zásobníka).

Prúdenie plynu je podobné, ako keď pacient dýcha touto pomôckou spontánne.

Zásobník na kyslík je vybavený dvomi ventilmi – jeden umožňuje nasatie okolitého vzduchu, keď je zásobník prázdny, a druhý vypustenie nadbytočného kyslíka, keď je zásobný vak na kyslík plný.

Port M-Port umožňuje prístup k inspiračnému a expiračnému prietoku plynu a pripojenie injekčnej striekačky na podávanie liekov 1d alebo hadičky na odber vzoriek plynu na meranie vedľajšieho prúdu (sidestream) EtCO₂ 1e.

- 1.1 Uvoľnenie nadbytočného kyslíka, 1.2 Prívod vzduchu, 1.3 Prívod kyslíka, 1.4 Konektor pacienta, 1.5 Výdych, 1.6 Port pre manometer, 1.7 Ventil na obmedzenie tlaku, 1.8 Port M-port.

POZNÁMKA: ako nadstavec k 1.5 môže byť použitý buď chránič proti postriekaniu, alebo ventil PEEP.

4.2. Kontrola a príprava

Pred prípravou na použitie v nádzových situáciách sa resuscitátor musí odbaliť a pripraviť (vrátane vykonania funkčného testu) na okamžité použitie.

4.2.1. Príprava

- Ak je resuscitátor zabalený v stlačenom stave, rozbalte ho potiahnutím za ventil pacienta a vstupný ventil.
- Pripravte resuscitátor a všetky položky vložte do prepravného vaku dodaného s resuscitátorom.
- Ak je tvárová maska dodávaná s resuscitátorom zabalená v ochrannom obale, musí sa pred použitím vybrať.

Pozrite si oddiel 4.2.2. (Kysliková hadička) na prípravu pomôcky pred použitím pri teplote nižšej ako 0 °C.

4.2.2. Testovanie funkčnosti 2

Resuscitátor

Pomocou vyrádovacej svorky zavorte ventil na obmedzenie tlaku a palcom uzavrite konektor pacienta 2.1. Rýchlo stlačte kompresný vak. Resuscitátor musí klást odpor pri stláčaní.

Otvorte ventil na obmedzenie tlaku vysunutím vyráďovacej svorky a zopakujte postup. Ventil na obmedzenie tlaku by teraz mal byť aktivovaný a počas rýchleho stlačenia kompresného vaku by malo byť počúť prúdenie z ventilu.

Niekoľkokrát stlačte a uvoľnite resuscitátor s cieľom uistiť sa, že vzduch prúdi cez systém ventilov a von cez ventil pacienta. **2.2**

POZNÁMKA: Pri pohybe ventilových krúžkov počas skúšky funkčnosti alebo počas ventilácie môže pomôcka vydávať tichý zvuk. Nemá to vplyv na funkčnosť resuscitátora.

Kyslíková hadička

Montáž kyslíkovej hadičky a testovanie funkcie zásobného vaku na kyslík a hadičky zásobného vaku na kyslík by sa mali vykonávať pri teplotách nad 0 °C. Pri použíti resuscitátora pri teplotách nižších ako 0 °C nechajte kyslíkovú hadičku po skúške funkčnosti pripojenú k prívodu kyslíka.

Zásobný vak na kyslík

Do vstupného konektora na kyslík privádzajte kyslík s prietokom 10 l/min. Prípadne rukou podporite rozloženie vaku. Skontrolujte, či sa zásobný vak na kyslík plní. Ak sa nenapĺňa, skontrolujte celistvosť dvoch klapiek ventilov, alebo či zásobný vak na kyslík nie je natrhnutý.

Následne upravte prietok privádzaného plynu podľa zdravotníckych indikácií.

Hadička zásobného vaku na kyslík

Do vstupného konektora na kyslík privádzajte kyslík s prietokom 10 l/min. Skontrolujte, či kyslík vychádza z koncovej časti hadičky zásobného vaku na kyslík. Ak nie, skontrolujte, či nie je upcháta kyslíková hadička. Následne upravte prietok privádzaného plynu podľa zdravotníckych indikácií.

Port M-Port

Zložte kryt portu M-Port a zablokujte konektor pacienta. Stlačte vak a počúvajte zvuk vzdachu vytiahnutého cez port M-Port. **2.3**

4.3. Používanie resuscitátora

- Použite odporúčané techniky na vyčistenie úst a dýchacích ciest pacienta a umiestnite pacienta do správnej polohy, v ktorej má otvorené dýchacie cesty.
- Tvárovú masku pevne držte na tvári pacienta. **3.1**
- Zasuňte ruku (verzia pre dospelých) alebo prstenník a prostredník (pri pediatrickej verzii) pod rukoväť. Verzia pre dojčiatá nemá podpornú rukoväť. Ventiláciu bez použitia podpornej rukoväti je možné dosiahnuť otočením vaku. **3.2** Ventilácia pacienta: Počas insuflácie (vdýchnutia) sledujte, či sa hrudník nadvahuje. Prudko uvoľnite ruku držiacu vak, počúvajte expiračný prietok z ventilu pacienta a zároveň vizuálne sledujte pokles hrudníka.
 - Ak počas insuflácie pocítujete trvalý odpor, skontrolujte prekážku v dýchacích cestách a zmeňte polohu pacienta tak, aby boli dýchacie cesty otvorené.
 - Ak pacient počas ventilácie vracia; okamžite vyčistite dýchacie cesty pacienta a pred pokračovaním vo ventilácii odstráňte zvratky z resuscitátora tak, že ním niekolkokrát rýchlo zatrasiete a silno ho stlačíte.
 - Ak je to potrebné, utrite produkt handričkou obsahujúcou alkohol a vyčistite chránič proti postriekaniu vodom.

Port pre manometer

K portu pre manometer, ktorý sa nachádza vo vrchnej časti ventilu pacienta, sa môže pripojiť jednorazový manometer od spoločnosti Ambu, ako aj manometer od iných výrobcov. Zložte kryt a pripojte manometer/tlakomer

Systém na obmedzenie tlaku **4**

Ventil na obmedzenie tlaku je nastavený tak, aby sa otváral pri tlaku ekvivalentnom 40 cm stĺpca H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Ak lekárske a odborné posúdenie indikuje potrebu tlaku vyššieho ako 40 cm stĺpca H₂O, funkciu ventilu na obmedzenie tlaku je možné potlačiť zasunutím vyráďovacej svorky na ventil. **4.2**

Funkciu ventilu na obmedzenie tlaku je možné potlačiť aj priložením prsta na červené tlačidlo počas stláčania vaku.

Port M-Port

Resuscitátor Ambu SPUR II sa dodáva s portom M-Port alebo bez neho. Port M-Port poskytuje prístup k inspiračnému a expiračnému prietoku plynu a môže sa použiť na podávanie liekov, keď je k nemu pripojená injekčná striekačka, ako aj na meranie CO₂ metódou sidestream (EtCO₂). Keď port M-port nepoužívate, nezabudnite ho zatvoriť červeným uzáverom portu M-port.

Meranie EtCO₂

Pri meraní EtCO₂ metódou sidestream pripojte hadičku na odber vzorky plynu pre merací prístroj EtCO₂ k portu M-Port resuscitátora Ambu SPUR II. Pripojte konektor hadičky na odber vzorky plynu tak, že ho namontujete a otočíte o ¼ otáčky v smere chodu hodinových ručičiek.

Podanie liekov

Starostlivo sledujte reakciu pacienta na podávaný liek. Podanie objemov 1 ml (alebo viac) prchavej látky cez port M-Port je porovnatelné s podaním priamo do endotracheálnej trubice. Port M-Port bol testovaný s epinefrínom, lidokaínom a atropínom.

Verzia resuscitátora Ambu SPUR II s plúcnowou automatikou 5

Verzia resuscitátora Ambu SPUR II s plúcnowou automatikou je k dispozícii vo veľkostiach pre dospelých a pediatrických pacientov; môže sa používať s plúcnowou automatikou alebo bez nej a dodáva sa s pripojiteľným zásobným vakom na kyslík.

Prívodný ventil resuscitátora Ambu SPUR II sa pripája k plúcnej automatike prostredníctvom adaptéra.

Montáž plúcnej automatiky:

– Odstráňte jednotku zásobníka na kyslík z prívodného ventilu resuscitátora Ambu SPUR II, ak je pripojená.

– Pripojte adaptér k systému plúcnej automatiky.

– Zasuňte adaptér plúcnej automatiky do prívodného ventilu resuscitátora Ambu SPUR II.

POZNÁMKA: Používajte len diel s označením „kompresná jednotka“ s adaptérom a plúcnowou automatikou. Diel s označením „Zásobný vak na kyslík“ sa považuje za záložný diel v prípade zlyhania plúcnej automatiky.

Podávanie kyslíka

Kyslík podávajte podľa zdravotníckych indikácií.

Obrázok 6 ukazuje vypočítané percentuálne hodnoty dodaného kyslíka, ktoré je možné dosiahnuť pri rôznych objemoch a frekvenciach ventilácie s rôznymi prietokmi plynu.

Percentuálne hodnoty kyslíka môžete vidieť pre 6 dospelých pacientov 6.1, pediatrických pacientov 6.2, dojčiatá 6.3.

Zásobný vak na kyslík 7

Tenká plastová fólia zásobného vaku na kyslík sa nedá kedykoľvek odpojiť od miesta jej upevnenia k resuscitátoru.

Príslušenstvo 8

Konektory resuscitátora Ambu SPUR II sú v súlade s normami ISO 5356-1 a EN 13544-2, vďaka čomu sú v súlade s inými nemocničnými zariadeniami. Pri použití externých zariadení nezabudnite vykonať skúšku ich funkčnosti a prečítajte si návod na použitie príslušného externého zariadenia.

Výrobky spoločnosti Ambu kompatibilné s resuscitátorom Ambu SPUR II sú uvedené nižšie:

Jednorazová tvárová maska Ambu®

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie pre jednorazovú tvárovú masku Ambu.

Jednorazový ventil Ambu® PEEP 20 8.1 8.2

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie pre jednorazový ventil Ambu PEEP 20 alebo si pozrite obrázok 8.1 v tomto návode na použitie. Ak chcete k resuscitátoru pripojiť jednorazový ventil Ambu PEEP 20 (ak sa vyžaduje), odstráňte chránič proti postriekaniu. 8.2

Jednorazový manometer Ambu® 8.3

Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie jednorazového manometra Ambu.

4.4. Po použití

Použité výrobky sa musia zlikvidovať podľa miestnych postupov.

5. Technické údaje o výrobku

5.1. Použité normy

Resuscitátor Ambu SPUR II je v súlade s osobitnou normou pre tieto výrobky EN ISO 10651-4.

5.2. Špecifikácie

	Verzia pre dojča-tá	Pediatrická verzia	Verzia pre dospelých
Objem resuscitátora	pribl. 220 ml	pribl. 670 ml	pribl. 1 510 ml
Dodávaný objem jednou rukou*	150 ml	450 ml	600 ml
Dodávaný objem dvoma rukami*	–	–	1 000 ml
Rozmery (dlžka × priemer) bez zásobníka a príslušenstva	pribl. 190 × 71 mm	pribl. 223 × 99 mm	pribl. 284 × 127 mm
Hmotnosť bez zásobníka a príslušenstva	pribl. 70 g	pribl. 145 g	pribl. 220 g
Ventil na obmedzenie tlaku**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Mŕtvy priestor	≤5 ml + 10 % dodaného objemu	≤5 ml + 10 % dodaného objemu	≤5 ml + 10 % dodaného objemu

	Verzia pre dojča-tá	Pediatrická verzia	Verzia pre dospelých
Inspiračná rezistencia***	max. 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) pri 5 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pri 50 l/min	max. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pri 50 l/min
Exspiračná rezistencia***	max. 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) pri 5 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pri 50 l/min	max. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pri 50 l/min
Objem zásobníka	pribl. 300 ml (vak) pribl. 100 ml (hadička)	pribl. 2 600 ml (vak)	pribl. 2 600 ml (vak)
Konektor pacienta		Vonkajší, 22 mm, zasúvací (ISO 5356-1) Vnútorný, 15 mm, nasúvací (ISO 5356-1)	
Výdychový konektor (na pripojenie ventilu PEEP)		30 mm, zasúvací (ISO 5356-1)	
Konektor portu manometra		Ø 4,2 +/-0,1 mm	
Konektor plúcnej automatiky	–	Vnútorný, 32 mm, nasúvací (ISO 10651-4)	
Únik smerom dopredu a dozadu		Nemerateľný	
Port M-Port		Konektor kompatibilný s normou EN ISO 80369-7	
Vstupný konektor O ₂		Podľa normy EN 13544-2	
Obmedzenia prevádzkovej teploty		-18 až +50 °C (-0,4 až +122 °F), testované podľa normy EN ISO 10651-4	
Obmedzenia skladovacej teploty		-40 až +60 °C (-40 až +140 °F), testované podľa normy EN ISO 10651-4	
Pri dlhodobom skladovaní odporúčame skladovať v zatvorených obaloch pri izbovej teplote mimo dosahu slnečného žiarenia.			

* Testované podľa normy EN ISO 10651-4.

** Vyšší prívodný tlak môžete dosiahnuť potlačením funkcie ventilu na obmedzenie tlaku.

*** Pri všeobecných testovacích podmienkach podľa normy EN ISO 10651-4.

5.3. Bezpečnostné informácie týkajúce sa MRI



Resuscitátor Ambu SPUR II¹ a resuscitátor Ambu SPUR II s pripojeným jednorazovým ventilom Ambu PEEP 20² a resuscitátor Ambu SPUR II s pripojeným jednorazovým ventilom Ambu PEEP 20 a jednorazovým manometrom Ambu² sú podmienečne bezpečné na použitie v prostredí MR, preto sa môžu bezpečne používať v prostredí MR (nie vnútri otvora MR) za nasledujúcich podmienok.

Statické magnetické pole s intenzitou max. 7 T a

- Maximálny priestorový gradient poľa
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Produkt maximálnej intenzity
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Použitie vo vnútri otvora MR môže ovplyvniť kvalitu obrazu MR.

Zahrievanie indukované RF a artefakty obrazu MR neboli testované. Všetky kovové diely sú úplne zapuzdrené a nemajú žiadny kontakt s ľudským telom.

1. Pomembne informacije – Preberite pred uporabo

Pred uporabo pripomočka za oživljjanje Ambu® SPUR® II natančno preberite ta varnostna navodila. Pridržujemo si pravico do sprememb teh navodil za uporabo brez predhodnega obvestila. Kopije trenutne razlike so na voljo le na zahtevo. Ta navodila ne pojasnjujejo niti ne obravnavajo kliničnih postopkov. Pojasnjujejo le osnovno delovanje in previdnostne ukrepe v zvezi z delovanjem pripomočka za oživljjanje. Pred prvo uporabo pripomočka za oživljjanje mora biti upravljač ustrezno usposobljen na področju uporabe tehnik oživljjanja ter seznanjen z namenom uporabe, opozorili, previdnostnimi ukrepi in indikacijami, ki so omenjeni v teh navodilih. Pripomoček za oživljjanje Ambu® SPUR II ne vključuje garancije.

1.1. Predvidena uporaba

Pripomoček za oživljjanje Ambu SPUR II je pripomoček za uporabo samo pri enem bolniku, namenjen pljučnemu oživljjanju.

1.2. Indikacije za uporabo

Pripomoček za oživljjanje Ambu SPUR II je predviden za uporabo v primerih, ko je za pomoč pri dihanju potrebna uporaba ročnega pripomočka za vzpostavitev delovanja srca in pljuč. Pripomoček za oživljjanje Ambu SPUR II je indiciran za predihavanje in oksigenacijo bolnikov, dokler ni mogoče vzpostaviti zanesljivejše dihalne poti ali dokler si bolnik ne opore.

1.3. Predvidena populacija bolnikov

Razpon velikosti za uporabo posamezne razlike:

- Za odrasle:** odrasli in otroci s telesno težo najmanj 30 kg (66 funtov).
- Za otroke:** dojenčki in otroci s telesno težo od 6 kg do 30 kg (13–66 funtov).
- Za dojenčke:** novorojenčki in dojenčki s telesno težo največ 10 kg (22 funtov).

Upoštevajte, da vse konfiguracije pripomočka za oživljjanje Ambu SPUR II niso na voljo za vse tri tipe bolnikov.

1.4. Predvideni uporabnik

Zdravstveni delavci, usposobljeni za vzpostavljanje dihalnih poti, kot so anesteziologi, medicinski tehnički, reševalno osebje in osebje za nujne primere.

1.5. Kontraindikacije

Ni znanih kontraindikacij.

1.6. Prednosti pri klinični uporabi

Osnovna tehnika vzpostavljanja dihalnih poti z uporabo ročnega pripomočka za oživljjanje omogoča predihavanje in oksigenacijo bolnikov, dokler ni mogoče vzpostaviti zanesljivejše dihalne poti ali dokler si bolnik ne opore.

1.7. Opozorila in previdnostni ukrepi

Neupoštevanje teh previdnostnih ukrepov je lahko vzrok za neučinkovito predihavanje in oksigenacijo bolnika oziroma poškodbe opreme.

OPOZORILA

1. Pripomočka za oživljjanje ne uporablajte več kot skupno 4 ure v enem tednu, da preprečite nevarnost okužbe.
2. Če v pripomočku za oživljjanje opazite vlago ali morebitne ostanke, ga ne uporablajte znova, da preprečite nevarnost okužbe in okvare.
3. Prepričajte se, da je v ekspiratorni vhod priključena zaščita pred brizganjem ali ventil Ambu PEEP. Ekspiratorni vhod se lahko nenamerno zamaši in povzroči prekomerno količino zraka v pljučih, kar lahko privede do poškodb tkiva.
4. Izogibajte se uporabi pripomočka za oživljjanje v strupenih ali nevarnih okoljih, da se preprečite nevarnost poškodb tkiva.

5. Poskrbite, da rezervoar za kisik v obliki vrečke ni zamašen, saj lahko oviran pretok skozi cevko prepreči vnovično polnjenje kompresijske vrečke, kar lahko onemogoči predihavanje.
6. Izdelka ne uporabljajte, če je kontaminiran z zunanjimi viri, saj lahko to povzroči okužbo.
7. Izdelek po razpakiraju, sestavljanju in pred uporabo vedno preglejte ter opravite preskus delovanja, saj lahko okvare in tukti onemogočijo ali omejijo predihavanje bolnika.
8. Izdelka ne uporabljajte, če preskus delovanja ne uspe, sicer lahko pride do onemogočenega ali omejenega predihavanja bolnika.
9. Ventil za omejitve tlaka preglasite samo, če je to po vaši zdravstveni presoji nujno. Visok tlak pri predihavanju lahko povzroči barotraumo.
10. Samo za enkratno uporabo. Uporaba pri drugih bolnikih lahko povzroči navzkrižno okužbo.
11. Dovajanje zdravila skozi nastavek M-Port ni mogoče, če so med pripomočkom za oživljvanje in obrazno masko priključeni dodatki (npr. filter, detektor CO₂).
12. Nastavka M-port po uporabi ne puščajte odprtrega, da preprečite puščanje, ki lahko privede do omejenega dovajanja O₂ bolniku.
13. Nastavka M-Port ne uporabljaljte za spremeljanje posrednega EtCO₂ pri bolnikih, ki se predihavajo z manj kot 400 ml največje prostornine, da preprečite netočne meritve EtCO₂.
14. Pri dovajanju zdravil z volumnom manj kot 1 ml sperite nastavek M-Port, da zagotovite natančen odmerek zdravila.
15. V nastavek M-Port ne priključujte cevka za dovod kisika, saj bolniku ne bo dovedena predvidena koncentracija O₂.
16. Pri dodajanju pripomočkov se lahko upor vdiha in/ali izdiha poveča. Pripomočkov ne dodajte, če bi povečan upor pri dihanju bolniku lahko povzročil resne težave.
17. Uporaba je dovoljena samo predvidenim uporabnikom, ki so seznanjeni z vsebinou tega priročnika, saj lahko nepravilna uporaba škoduje bolniku.
18. Pri uporabi dodatnega kisika ni dovoljeno kaditi ali pripomoček uporabljati v bližini odprtega ognja, olja, masti, drugih vnetljivih kemikalij ali opreme in orodij, 1 ki povzročajo iskre, saj obstaja nevarnost požara in/ali eksplozije.
19. Na različico za dojenčke ne priključujte nobenega ventila na zahtevo, saj lahko to privede do visokih koncentracij kisika, ki lahko škodujejo novorojenčkom.
20. Pri uporabi pripomočka za oživljvanje, povezanega z obrazno masko, bodite pozorni na znake popolnega/delnega oviranja zgornjih dihalnih poti, saj lahko to onemogoči ali omeji dovajanje kisika. Namesto obrazne maske vedno uporabite drugo možnost za usmerjanje zraka k bolniku (če je na voljo).
21. Izdelka s priloženo obrazno masko ne uporabljajte pri predihavanju dojenčkov s prirojeno diafragmatično kilo, saj obstaja nevarnost insuflacije. Namesto obrazne maske uporabite drugo možnost za usmerjanje zraka k bolniku (če je na voljo).
22. Strokovnjaki, ki izvajajo postopek, morajo izbiro velikosti pripomočka za oživljvanje in dodatne opreme (npr. obrazna maska, ventil PEEP itd.) oceniti v skladu s specifičnim zdravstvenim stanjem bolnika, saj lahko nepravilna uporaba bolniku škoduje.
23. Pripomočka Ambu SPUR II ne uporabljajte, če je zaradi možne nezadostne dovedene količine kisika treba zagotoviti prost pretok kisika, saj lahko pride do hipoksije.
24. Ko se tlak ne spreminja, mora biti nastavek za manometer vedno zaprt s pokrovčkom manometra, da se prepreči puščanje, ki lahko privede do omejenega dovajanja O₂ bolniku.
25. Cevko za dovod kisika vedno predhodno priključite na dovod kisika pri temperaturi nad 0 °C, saj je lahko priključitev pri temperaturah pod 0 °C otežena, kar lahko privede do omejenega dovajanja kisika bolniku.
26. Pri uporabi pripomočka za oživljvanje s priključeno obrazno masko poskrbite za pravilno namestitev in tesnjenje obrazne maske, saj lahko nepravilno tesnjenje povzroči širjenje nalezljive bolezni, ki se prenaša po zraku, na uporabnika.

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Pripravite za oživljjanje ne shranjujte zloženega drugače, kot je bil zložen ob dobavi, saj se lahko v nasprotnem primeru deformira in se posledično zmanjša učinkovitost predihavanja. Območje za pregibanje je na vrečki jasno nakazano (pregibati je mogoče le različico za odrasle in otroke).
2. Vedno spremljajte premikanje prsnega koša in poslušajte pretok izdiha iz ventila za bolnika, da preverite predihavanje. Če s pripravkom za oživljjanje ne morete zagotoviti predihavanja, takoj začnite z oživljjanjem usta na usta.
3. Pripravka ne namakajte, drgnite ali sterilizirajte, saj lahko ti postopki pustijo škodljive ostanke ali povzročijo okvaro pripravke. Oblika in uporabljeni material nista združljiva z običajnimi postopki za čiščenje in sterilizacijo.
4. M-Port uporabljajte le za enega od teh postopkov: merjenje EtCO₂ ali dovajanje zdravil, saj lahko to vpliva na izmerjene vrednosti.
5. Podrobnejše informacije o posameznem dodatku poiščite na njegovi embalaži (če je to ustrezno), saj lahko nepravilno ravnanje privede do okvare celotnega izdelka.
6. Uporaba izdelkov drugih proizvajalcev in pripravkov za dovajanje kisika (npr. filterov in ventilov na zahtevo) s pripravkom za oživljjanje Ambu SPUR II lahko vpliva na delovanje izdelka. Za preverjanje združljivosti pripravka drugega proizvajalca s pripravkom za oživljjanje Ambu SPUR II in informacije o možnih spremembah delovanja se obrnite na proizvajalca pripravka.
7. Rezervoar s kisikom v obliki vrečke je pri različici pripravka za oživljjanje za odrasle in otroke trajno priključen na dovodni ventil, razen pri različicah za ventil na zahtevo. Ne poskušajte ga odstraniti. Ne vlecite za rezervoar s kisikom v obliki vrečke, saj lahko pride do okvare pripravka.

1.8. Možni neželeni učinki

Nekateri možni neželeni učinki, povezani z oživljjanjem: barotravma, volutratravma, hipoksija, hiperkarbija in aspiracijska pljučnica.

1.9. Splošne opombe

Če pride med uporabo tega pripravka ali zaradi njegove uporabe do resnega incidenta, o tem obvestite proizvajalca in državni organ.

2. Opis pripravka

Pripravček za oživljjanje Ambu SPUR II je mogoče povezati s tlačnim manometrom Ambu® za enkratno uporabo, ventilji Ambu® PEEP in obraznimi maskami Ambu®, kot je opisano v razdelku 4.3 Upravljanje pripravka za oživljjanje.

3. Razlaga uporabljenih simbolov

Simbol	Opis
	Za odrasle Predvidena idealna telesna teža več kot 30 kg
	Za otroke Predvidena idealna telesna teža od 6 kg do 30 kg
	Za dojenčke Predvidena idealna telesna teža največ 10 kg
	Pogojni MR

Simbol	Opis
	Država proizvajalca
	Medicinski pripomoček
	Za večkratno uporabo pri enem bolniku
	Rezervoarja s kisikom v obliki vrečke ne vlecite na silo

Celoten seznam razlag simbolov je na voljo na spletnem mestu
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Uporaba izdelka

4.1. Način delovanja

Slika 1 prikazuje, kako se mešanica dihalnih plinov med ročnim upravljanjem pripomočka za oživljjanje pretaka v vrečko oziroma proti bolniku in stran od bolnika. 1a Pripomoček za oživljjanje za odrasle in otroke, 1b pripomoček za oživljjanje za dojenčke z zaprtim rezervoarjem s kisikom (v obliki vrečke), 1c pripomoček za oživljjanje za dojenčke z odprtim rezervoarjem s kisikom (v obliki cevke).

Pretok plina je podoben kot takrat, ko bolnik spontano diha skozi pripomoček.

Rezervoar s kisikom je opremljen z dvema ventiloma, pri čemer eden omogoča dovajanje zunanjega zraka v rezervoar, ko je ta prazen, drugi pa odvajanje odvečnega kisika, ko je rezervoar poln.

M-port omogoča dostop do pretoka plina za vdihavanje in izdihavanje za priključitev brizgalke za dovajanje zdravil 1d ali vod za preverjanje plinov za merjenje posrednega EtCO₂ 1e.

1.1 Sprostitev odvečnega kisika, 1.2 dovod zraka, 1.3 dovod kisika, 1.4 priključek za bolnika, 1.5 izdihavanje, 1.6 nastavek za manometer, 1.7 ventil za omejitev tlaka, 1.8 nastavek M-port.

OPOMBA: Na 1.5 je mogoče priključiti zaščito pred brizganjem ali ventil PEEP.

4.2. Pregled in priprava

Pripomoček za oživljjanje je treba odstraniti iz embalaže in pripraviti za takojšnjo uporabo (vključno s preskusom delovanja), šele nato je pripravljen za uporabo v nujnih primerih.

4.2.1. Priprava

- Če je pripomoček za oživljjanje zapakiran v stisnjeni obliku, ga razvijte tako, da povlečete ventil za bolnika in dovodni ventil.
- Pripravite pripomoček za oživljjanje in vse predmete iz priložene plastične vrečke.
- Če je maska, priložena pripomočku za oživljjanje, v zaščitni vrečki, jo pred uporabo pripomočka odstranite iz vrečke.

Glejte razdelek 4.2.2. (Cevka za dovod kisika) za pripravo pripomočka pred uporabo pri temperaturi manj kot 0 °C.

4.2.2. Preskus delovanja 2

Pripomoček za oživljjanje

Zaprite ventil za omejitev tlaka z zaponko za preglasitev in s palcem zaprite priključek za bolnika 2.1. Hitro stiskajte stisljivo vrečko. Pripomoček za oživljjanje bo preprečil stiskanje.

Odprite ventil za omejitev tlaka tako, da pomaknete zaponko za preglasitev vstran in ponovite postopek. Ventil za omejitev tlaka bi zdaj moral biti aktiviran in pretok iz ventila bi med hitrim stiskanjem stisljive vrečke moral biti slišen.

Nekajkrat stisnite in spustite pripomoček za oživljjanje. Tako preverite, ali se zrak pretaka skozi sistem ventilov in izhaja iz ventila za bolnika. **2.2**

OPOMBA: Ker se ploščice ventilov med preskusom delovanja ali med predihavanjem premikajo, se bo morda slišal tih zvok. To ne vpliva na delovanje pripomočka za oživljjanje.

Cevka za dovod kisika

Namestitev cevke za dovod kisika ter preskus delovanja rezervoarja s kisikom v obliki vrečke in rezervoarja s kisikom v obliki cevke je treba izvesti pri temperaturi več kot 0 °C. Za uporabo pripomočka za oživljjanje pri temperaturah manj kot 0 °C po preskusu delovanja pustite cevko za dovod kisika priključeno na dovod kisika.

Rezervoar s kisikom v obliku vrečke

Omogočite pretok plina 10 l/min skozi priključek za dovod kisika. Ob koncu si pri razvijanju vrečke pomagajte z roko. Preverite, ali se rezervoar s kisikom v obliku vrečke napolni. Če se ne napolni, preverite, ali zapirali ventila delujeta oz. ali je rezervoar s kisikom morda poškodovan.

Nato prilagodite pretok dovedenega plina v skladu z medicinskim indikacijami.

Rezervoar s kisikom v obliku cevke

Omogočite pretok plina 10 l/min skozi priključek za dovod kisika. Preverite, ali skozi zadnji del rezervoarja v obliku cevke izhaja kisik. Če ne izhaja, preverite, ali je cevka za kisik morda zamašena. Nato prilagodite pretok dovedenega plina v skladu z medicinskim indikacijami.

M-Port

Odstranite pokrovček M-Port in zaprite priključek za bolnika. Stisnite vrečko in poslušajte, ali se zrak iztiska skozi M-Port. **2.3**

4.3. Upravljanje pripomočka za oživljjanje

- S priporočenimi tehnikami sprostite pretok zraka skozi bolnikova usta in bolnika pravilno namestite, da sprostite dihalno pot.
- Obrazno masko pridržite zatesnjeno ob bolnikov obraz. **3.1**
- Dlan (pri različici za odrasle) ali prstanec in sredinec (pri različici za otroke) namestite pod ročaj. Različica za dojenčke nima podpornega ročaja. Predihavanje brez uporabe podpornega ročaja omogočite tako, da obrnete vrečko. **3.2** Predihavanje bolnika: Pri insuflaciji opazujte dvigovanje prsnega koša. Z roko sunkovito izpustite vrečko ter poslušajte pretok izdihanega zraka iz ventila za bolnika in opazujte spuščanje prsnega koša.
- Če pri insuflaciji opazite stalen odpor, preverite, ali je dihalna pot ovirana, in bolnika namestite tako, da dihalno pot sprostite.
- Če bolnik med predihavanjem bruha, mu takoj očistite dihalno pot in ostanke bruhanja odstranite iz pripomočka za oživljjanje tako, da pripomoček nekajkrat močno in hitro pretresete oziroma stisnete, preden nadaljujete predihavanje.
Po potrebi pripomoček obrišite s krpo, namočeno v alkohol, in z vodo sperite zaščito pred brizganjem.

Nastavek za manometer

Na nastavek za manometer na vrhu ventila za bolnika lahko priključite tlačni manometer Ambu za enkratno uporabo ali merilnik tlaka drugega proizvajalca. Odstranite pokrovček in pritrдite manometer/merilnik tlaka

Sistem za omejitev tlaka **4**

Ventil za omejitev tlaka je odprt pri tlaku 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Če je po vaši zdravniški in strokovni presoji potreben tlak nad 40 cm H₂O, je ventil za omejitev tlaka mogoče preglasiti s pomikom zaponke za preglasitev v ventil. **4.2**

Ventil za omejitev tlaka lahko preglasite tudi tako, da med stiskanjem vrečke postavite prst na rdeči gumb.

M-Port

Pripomoček za oživljanje Ambu SPUR II je na voljo z nastavkom M-Port ali brez njega. M-port omogoča dostop pretoka plina za vdihavanje in izdihavanje oziroma se lahko uporablja za dovajanje zdravil, kadar je priključena brizgalka, in tudi za merjenje posrednega CO₂ (EtCO₂). Kadar M-port ni v uporabi, mora biti zaprt s pokrovčkom nastavka M-Port.

Merjenje EtCO₂

Za merjenje posrednega EtCO₂ priključite vod za vzročenje plinov za pripomoček za merjenje EtCO₂ v nastavek M-Port pripomočka za oživljanje Ambu SPUR II. Vod za vzročenje plinov priključite tako, da ga namestite z obratom za 1/4 v smeri urnega kazalca.

Dovajanje zdravila

Skrbno spremljajte odziv bolnika na prejeto zdravilo. Dovajanje 1 ml tekočine ali več skozi M-Port je primerljivo z dovajanjem neposredno v endotrahealno cev. M-port je bil preskušen z epinefrinom, lidokainom in atropinom.

Različica pripomočka za oživljanje Ambu SPUR II z ventilom na zahtevo 5

Različica pripomočka za oživljanje Ambu SPUR II z ventilom na zahtevo je na voljo v velikosti za odrasle in otroke. Lahko se uporablja z ventilom na zahtevo ali brez njega, priložen pa ji je priključni rezervoar s kisikom v obliki vrečke.

Dovodni ventil pripomočka za oživljanje Ambu SPUR II je z ventilom na zahtevo mogoče povezati prek adapterja.

Priklučitev ventila na zahtevo:

- Z dovodnega ventila pripomočka za oživljanje Ambu SPUR II odstranite rezervoar s kisikom (če je priključen).
- Priklučite adapter na sistem ventila na zahtevo.
- Adapter ventila na zahtevo vstavite v dovodni ventil pripomočka za oživljanje Ambu SPUR II.

OPOMBA: Uporabite izključno del z oznako »kompresijska enota« z adapterjem in ventilom na zahtevo. Del z oznako »rezervoar s kisikom v obliki vrečke« se uporablja kot nadomestna rešitev v primeru nedelovanja ventila na zahtevo.

Dovajanje kisika

Dovajajte kisik v skladu z medicinskim indikacijami.

Slika 6 prikazuje izračunane odstotke dovedenega kisika na podlagi različnih volumnov in frekvenc pri različnih hitrostih pretoka plina. Odstotki kisika so vidni pri različicah 6 za odrasle 6.1, otroke 6.2 in dojenčke 6.3.

Rezervoar s kisikom v obliki vrečke 7

Tanke plastične folije rezervoarja s kisikom v obliki vrečke ni mogoče sneti s točke pritrditve na pripomoček za oživljanje.

Dodatna oprema 8

Priklučki pripomočka za oživljanje Ambu SPUR II izpolnjujejo zahteve standardov ISO 5356-1 in EN 13544-2, zaradi česar so združljivi z drugo bolnišnično opremo. Pri uporabi zunanjih pripomočkov preverite delovanje in preberite navodila za uporabo, priložena uporabljenemu zunanjemu pripomočku.

V nadaljevanju so navedeni izdelki Ambu, ki so združljivi s pripomočkom za oživljanje Ambu SPUR II:

Obrazna maska Ambu® za enkratno uporabo

Če želite izvedeti več, glejte navodila za uporabo obrazne maske Ambu® za enkratno uporabo.

Ventil Ambu® PEEP 20 za enkratno uporabo 8.1 8.2

Če želite izvedeti več, glejte navodila za uporabo ventila Ambu PEEP 20 za enkratno uporabo ali sliko 8.1 v teh navodilih za uporabo. Za namestitev ventila Ambu PEEP na pripomoček za oživljanje (če je ta potrebna) odstranite zaščito pred brizganjem. 8.2

Tlačni manometer Ambu® za enkratno uporabo 8.3

Če želite izvedeti več, glejte navodila za uporabo tlačnega manometra Ambu za enkratno uporabo.

4.4. Po uporabi

Uporabljene izdelke je treba zavreči v skladu z lokalnim protokolom.

5. Tehnične specifikacije izdelka

5.1. Uporabljeni standardi

Pripomoček za oživljjanje Ambu SPUR II je v skladu s standardom EN ISO 10651-4 za zadevne izdelke.

5.2. Specifikacije

	Za dojenčke	Za otroke	Za odrasle
Volumen pripomočka za oživljjanje	pribl. 220 ml	pribl. 670 ml	pribl. 1510 ml
Dovedeni volumen z eno roko*	150 ml	450 ml	600 ml
Dovedeni volumen z obema rokama*	-	-	1000 ml
Mere (dolžina x premer) brez rezervoarja in dodatne opreme	pribl. 190 x 71 mm	pribl. 223 x 99 mm	pribl. 284 x 127 mm
Teža brez rezervoarja in dodatne opreme	pribl. 70 g	pribl. 145 g	pribl. 220 g
Ventil za omejitve tlaka**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)

	Za dojenčke	Za otroke	Za odrasle
Prazen prostor	≤ 5 ml + 10 % dovedenega volumna	≤ 5 ml + 10 % dovedenega volumna	≤ 5 ml + 10 % dovedenega volumna
Upor pri vdihavanju***	največ 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) pri 5 l/min	največ 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pri 50 l/min	največ 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) pri 50 l/min
Upor pri izdihanju***	največ 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) pri 5 l/min	največ 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pri 50 l/min	največ 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) pri 50 l/min
Volumen rezervoarja	pribl. 300 ml (vreča) pribl. 100 ml (cevka)	pribl. 2600 ml (vreča)	pribl. 2600 ml (vreča)
Prikluček za bolnika	Zunanji 22 mm, moški (ISO 5356-1) Notranji 15 mm, ženski (ISO 5356-1)		
Prikluček za izdihanje (za priključek ventila PEEP)	30 mm, moški (ISO 5356-1)		
Prikluček nastavka za manometer	Ø 4,2 +/- 0,1 mm		
Prikluček za ventil na zahtevo	-	Notranji 32 mm, ženski (EN ISO 10651-4)	
Uhajanje naprej in nazaj	Ni mogoče izmeriti		
M-Port	Prikluček v skladu s standardom EN ISO 80369-7		
Vhodni priključek za O ₂	V skladu s standardom EN 13544-2		
Omejitve delovne temperature	-18 °C do +50 °C (-0,4 °F do +122 °F), preskušeno v skladu s standardom EN ISO 10651-4		
Omejitve temperature skladiščenja	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F), preskušeno v skladu s standardom EN ISO 10651-4		
Priporočeno dolgotrajno skladiščenje v zaprti embalaži, zaščiteni pred sončno svetlobo, pri sobni temperaturi			

* Preskušeno v skladu s standardom EN ISO 10651-4.

** Preglasitev ventila za omejitev tlaka omogoča višji tlak dovoda.

*** Pri splošnih preskusnih pogojih v skladu s standardom EN ISO 10651-4.



5.3. Informacije o varnosti pri slikanju z magnetno resonanco

Pripomoček za oživljjanje Ambu SPUR II¹, pripomoček za oživljjanje Ambu SPUR II s priključenim ventilom Ambu PEEP 20 za enkratno uporabo² ter pripomoček za oživljjanje Ambu SPUR II s priključenima ventilom Ambu PEEP 20 za enkratno uporabo in tlačnim manometrom Ambu za enkratno uporabo² so pripomočki za pogojno uporabo pri magnetni resonanci, zato se lahko v pogojih, navedenih v nadaljevanju, varno uporablajo v okolju, v katerem se izvaja magnetna resonanca (ne znotraj odprtine za magnetno resonanco).

Statično magnetno polje z gostoto največ 7 T

- Najvišjim prostorskim gradientom polja:
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²
- Najvišjim produktom jakosti:
 - 450.000.000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G²/cm (721 T²/m)²

Uporaba znotraj odprtine za magnetno resonanco lahko vpliva na kakovost magnetnoresonančne slike.

Radiofrekvenčno inducirano segrevanje in artefakti magnetnoresonančne slike niso bili preskušeni. Vsi kovinski deli so v celoti zapečateni in ne pridejo v stik s človeškim telesom.

1. Viktig information – Läs före användning

Läs alltid säkerhetsanvisningarna innan du använder Ambu® SPUR® II andningsballong. Bruksanvisningen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Exemplar av den aktuella versionen kan erhållas på begäran. Observera att denna bruksanvisning inte förklarar eller beskriver kliniska förfaranden. Beskrivningen avser endast den grundläggande funktionen och de försiktighetsåtgärder som gäller vid användning av andningsballongen. Innan andningsballongen används för första gången är det viktigt att användarna har erhållit tillräcklig utbildning i återupplivning samt har läst igenom informationen om avsedd användning, varningar, uppmaningar om försiktighet och indikationer i denna bruksanvisning. Ambu SPUR II andningsballong omfattas inte av någon garanti.

1.1. Avsedd användning

Ambu SPUR II är en andningsballong för enpatients bruk som är avsedd för lungräddning.

1.2. Indikationer för användning

Ambu SPUR II andningsballong är avsedd att användas i situationer där en manuell andningsballong för hjärt-lungräddning behövs för assisterad ventilation.

Ambu SPUR II andningsballong är indikerad för ventilation och syresättning av patienter fram till dess en mer definitiv luftväg kan etableras eller patienten har återhämtat sig.

1.3. Avsedd patientpopulation

Användningsområden och storlekar för de olika versionerna är:

- Vuxen:** Vuxna och barn med kroppsvekt över 30 kg.
- Barn:** Spädbarn och barn med en kroppsvekt från 6 till 30 kg.
- Spädbarn:** Nyfödda och spädbarn med kroppsvekt upp till 10 kg.

Observera att alla konfigurationer av Ambu SPUR II andningsballong inte är tillgängliga för samtliga tre patientgrupper.

1.4. Avsedda användare

Vårdpersonal utbildade i luftvägsbehandling, till exempel narkosläkare, sjuksköterskor eller räddningspersonal.

1.5. Kontraindikationer

Inga kända.

1.6. Kliniska fördelar

Den basala tekniken för luftvägsbehandling med en manuell andningsballong möjliggör ventilation och syresättning av patienter fram till dess en mer definitiv luftväg kan etableras eller patienten har återhämtat sig.

1.7. Varningar och försiktighetsåtgärder

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till otillräcklig ventilation och syresättning av patienten eller skada på utrustningen.

VARNINGAR

1. Använd inte andningsballongen mer än fyra timmar sammanlagt under en maximal tidsperiod på en vecka för att undvika infektionsrisk.
2. Andningsballongen ska inte användas igen om synlig fukt eller restprodukter finns kvar inne i enheten, detta för att undvika infektionsrisk och risk för att fel uppstår.
3. Säkerställ att endera stänkskyddet eller Ambu PEEP-ventil är anslutet till utandningsporten. Om utandningsporten är öppen finns det risk för att den kan oavsiktligt blockeras, vilket kan medföra alltför stor luftvolym i lungorna som i sin tur kan vålla vävnadstrauma.
4. Undvik att använda andningsballongen i giftiga eller farliga miljöer för att undvika risk för vävnadsskada.

5. Säkerställ alltid att oxygenreservoarslangen inte är blockerad eftersom en blockerad slang kan förhindra att kompressionsballongen blåses upp på nytt, vilket kan leda till att ventilation blir omöjlig.
6. Använd inte produkten om den är kontaminerad eftersom detta kan leda till infektion.
7. Utför alltid en visuell kontroll av produkten och utför ett funktionstest efter uppackning, montering och inför användning eftersom defekter och främmande ämnen kan leda till utebliven eller försämrad ventilation av patienten.
8. Använd inte produkten om den inte godkänts vid funktionstestning eftersom detta kan leda till utebliven eller försämrad ventilation.
9. Åsidosätt aldrig tryckbegränsningsventilen såvida det inte är indikerat enligt medicinsk bedömning. Höga ventilationstryck kan orsaka barotrauma.
10. Endast för enpatientsbruk. Användning på andra patienter kan leda till smittspridning.
11. Det går inte att tillföra läkemedel via M-porten om tillbehör (t.ex. filter, CO₂-detektor) har kopplats in mellan andningsballongen och ansiktsmasken.
12. Lämna inte M-porten öppen efter användning för att undvika läckage, vilket kan leda till minskad O₂-tillförsel till patienten.
13. M-porten ska inte användas för endtidal CO₂-övervakning då patienten ventileras med mindre än 400 ml tidalvolym för att undvika felaktiga CO₂-mätningar.
14. Vid tillförsel av läkemedel i mindre volymer än 1 ml måste M-porten först spolas för att säkerställa korrekt dosering.
15. Anslut inte syrgasslangen till M-porten eftersom önskad O₂-koncentration då inte kommer att tillföras patienten.
16. Användning av tillbehör kan göra att motståndet vid in- och/eller utandning ökar. Anslut inte tillbehör om ökat andningsmotstånd skulle vara till men för patienten.
17. Får endast användas av avsedda användare som har läst denna bruksanvisning eftersom felaktig hantering kan skada patienten.
18. Tillförsel av extra syre får endast ske på en plats där rökning är förbjuden och öppen låga, olja, smörjfett, andra lättantändliga kemikalier eller utrustning/verktyg som kan leda till gnistbildning inte förekommer på grund av risken för brand och/eller explosion.
19. Anslut aldrig en andningsstyrd ventil till spädbarnsversionen eftersom det kan ge upphov till höga syrekonzcentrationer som kan skada nyfödda.
20. Var uppmärksam på tecken på fullständig/partiell blockering av övre luftvägarna när andningsballongen är ansluten till en ansiktsmask, eftersom detta medför utebliven eller begränsad syretillförsel. Välj alltid ett annat alternativ (om möjligt) än ansiktsmask för att tillföra luft till patienten.
21. Använd inte produkten med ansiktsmask ansluten vid ventilation av spädbarn med medfött diafragmabräck på grund av risken för inblåsning. Välj ett annat alternativ (om möjligt) än ansiktsmask för att tillföra luft till patienten.
22. Den vårdpersonal som utför proceduren ska välja storlek på andningsballong och tillbehör (t.ex. ansiktsmask, PEEP-ventil m.m.) baserat på patientens specifika tillstånd eftersom felaktig användning kan skada patienten.
23. Använd inte Ambu SPUR II när tillförsel av fritt flödande syrgas krävs på grund av att det finns risk för otillräcklig syrgasadministration, något som kan leda till hypoxi.
24. Manometerlocket måste alltid sättas tillbaka på M-porten när trycket inte övervakas för att undvika läckage, vilket kan leda till minskad O₂-tillförsel till patienten.
25. Anslut alltid syrgasslangen till syrgastillförseln vid en temperatur överstigande 0 °C eftersom det kan vara svårt att ansluta den i minusgrader, något som också kan medföra minskad syrgastillförsel till patienten.
26. När andningsballongen används med en ansiktsmask, säkerställ att ansiktsmasken är korrekt och stabilt placerad eftersom otillräcklig tätnings kan leda till att luftburna infektionssjukdomar sprids till användaren.

FÖRSIKTIGHET

1. Förvara aldrig andningsballongen på annat sätt än hopvikt på samma sätt som när den levererades från tillverkaren. Annan förvaring kan leda till permanent deformation vilket kan minska ventilationens effektivitet. Området för vikning syns tydligt på ballongen (endast versionerna för vuxna och barn kan vikas).
2. Observera alltid bröstkorgens rörelser och lyssna efter exspirationsljud från patientventilen för att säkerställa effektiv ventilation. Övergå omedelbart till mun-mot-mun-metoden om det inte är möjligt att uppnå tillräckligt effektiv ventilation med andningsballongen.
3. Produkten får inte blötläggas, sköljas eller steriliseras eftersom dessa processer kan lämna kvar skadliga rester eller leda till att produkten inte fungerar. Produktens utformning och material tål inte vanliga rengörings- och steriliseringsprocesser.
4. M-porten får endast användas för antingen endtidal CO₂-mätning ELLER läkemedelstillförsel eftersom uppmätta värden kan påverkas.
5. Vid användning av tillbehör, läs informationen på tillhörande förpackning eftersom felaktig hantering kan leda till att hela produkten inte fungerar korrekt.
6. Om produkter och enheter för syrgastillförsel (t.ex. filter och andningsstyrda ventilér) från tredje part används tillsammans med Ambu SPUR II andningsballong kan detta påverka produktens funktion negativt. Kontakta tillverkaren av enheten från tredje part för att säkerställa att den kan användas med Ambu SPUR II andningsballong och avgöra om den kan påverka prestandan.
7. Oxygenreservoarpåsen är permanent monterad vid inloppsventilen på andningsballonger för vuxna och barn, dock inte på versionerna med andningsstyrd ventil. Försök aldrig ta isär den. Dra inte i oxygenreservoarpåsen eftersom enheten kan upphöra att fungera.

1.8. Potentiellt negativa händelser

Potentiellt negativa händelser relaterade till återupplivning (ingen fullständig lista): barotrauma, volutrauma, hypoxi, hyperkapni och aspirationspneumoni.

1.9. Allmänna observanda

Om allvarliga negativa händelser eller tillbud har inträffat vid användning av denna enhet eller på grund av att den har använts ska detta rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

2. Beskrivning av enheten

Ambu SPUR II andningsballong kan anslutas till Ambu® engångsmanometer, Ambu® PEEP-ventiler och Ambu® ansiktsmasker enligt beskrivningen i avsnitt 4.3 Använda andningsballongen.

3. Förklaring av använda symboler

Symbol/indikation	Beskrivning
	Vuxna Tilltänkt idealisk kroppsvekt över 30 kg
	Barn Tilltänkt idealisk kroppsvekt från 6 till 30 kg
	Spädbarn Tilltänkt idealisk kroppsvekt upp 10 kg
	MR-villkorad

Symbol/indikation	Beskrivning
	Tillverkningsland
	Medicinteknisk produkt
	För flergångsbruk på en patient
	Dra inte i oxygenreservoarpåsen

En heltäckande lista med förklaringar finns på <https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Produktanvändning

4.1. Funktionsprincip

Bild 1 visar ventilationsgasflödet till ballongen och till/från patienten vid manuell hantering av andningsballongen. 1a) Andningsballong för vuxna och barn, 1b) andningsballong för spädbarn med sluten oxygenreservoarpåse (reservoarpåse), 1c) andningsballong för spädbarn med öppen oxygenreservoarslang (slangreservoar).

Gasflödet ser ungefär likadant ut då patienten andas spontant genom enheten.

Oxygenreservoaren har två ventiler. Genom den ena sugs omgivningsluft in när reservoaren är tom och den andra släpper ut överskottssyre när oxygenreservoarpåsen är full.

M-porten ger tillgång till det in- och exspiratoriska gasflödet vilket gör det möjligt att ansluta en spruta för tillsättning av läkemedel 1d eller ansluta en gasprovtagningsledning för mätning av endtidal CO₂ 1e.

- 1.1 Utsläpp av överskottsoxygen, 1.2 luftingång, 1.3 syrgasingång, 1.4 patientanslutning, 1.5 exspiration, 1.6 manometerport, 1.7 tryckbegränsningsventil, 1.8 M-port.

OBS! Fästet för 1.5 kan endera vara ett stänkskydd eller en PEEP-ventil.

4.2. Inspektion och förberedelse

Andningsballongen måste packas upp och förberedas (inklusive ett funktionstest) för omedelbar användning innan den placeras på lämplig plats för användning i en nödsituation.

4.2.1. Förberedelser

- Om andningsballongen är förpackad i hoppresad form, öppna den genom att dra i patientventilen och inloppsventilen.
- Förbered andningsballongen och lägg alla delar i den medföljande väskan.
- Om ansiktsmasken som medföljer andningsballongen ligger i en skyddspåse ska påsen avlägsnas före användning.

Se avsnitt 4.2.2. (Syrgasslang) när det gäller att förbereda enheten inför användning i temperaturer under 0 °C.

4.2.2. Funktionstest 2

Andningsballong

Stäng tryckbegränsningsventilen med överkopplingsklämman och stäng patientanslutningen med tummen 2.1. Kläm energiskt på ballongen. Andningsballongen ska bjuda motstånd när den kläms samman.

Skjut bort överkopplingsklämman för att öppna tryckbegränsningsventilen och upprepa procedturen. Tryckbegränsningsventilen ska nu vara aktiverad och det ska gå att höra flödet från ventilen när du klämmer energiskt på ballongen.

Kläm ihop och släpp upp andningsballongen några gånger för att säkerställa att luften flödar genom ventilsystemet och ut genom patientventilen. **2.2**

OBS! Ett svagt ljud kan höras när ventilskivorna rör sig under funktionstestet eller pågående ventilation. Detta är inget fel och påverkar inte andningsballongens funktion.

Syrgasslang

Inkoppling av syrgasslang och funktionstest av oxygenreservoarpåse och oxygenreservoarslang ska utföras vid temperaturer överstigande 0 °C. Om andningsballongen ska användas vid temperaturer under 0 °C ska syrgasslangen förblifft ansluten till syrgastillförseln efter utfört funktionstest.

Oxygenreservoarpåse

Tillför ett syrgasflöde på 10 L/min. till syrgasingången. Använd eventuellt händerna för att hjälpa till att veckla upp ballongen. Kontrollera att oxygenreservoarpåsen fylls. Om inte, kontrollera att de två ventillåsen är hela och att oxygenreservoaren inte är skadad eller läcker.

Justera därefter syrgastillförseln enligt medicinsk indikation.

Slang till oxygenreservoaren

Tillför ett syrgasflöde på 10 L/min. till syrgasingången. Kontrollera att syrgasen flödar ut från oxygenreservoarslangs ände. Om inte, kontrollera om syrgasslangen är blockerad. Justera därefter syrgastillförseln enligt medicinsk indikation.

M-port

Ta bort locket till M-Port och blockera patientanslutningen. Kläm på ballongen och lyssna efter ljud från luft som tränger ut genom M-porten. **2.3**

4.3. Använda andningsballongen

- Använd rekommenderade metoder för att rensa patientens mun och luftväg och etablera en korrekt position för att öppna fri luftväg.
- Håll ansiktsmasken tätt mot patientens ansikte. **3.1**
- Placera handen (version för vuxna) eller ring- och längfinger (pediatrik version) under handtaget. Barnversionen saknar stödhandtag. När stödhandtag saknas kan ventilation utföras genom att vrida ballongen. **3.2** Ventilation av patienten: Kontrollera att bröstkorgen höjs under inblåsning. Släpp snabbt greppet om ballongen och lyssna efter exspirationsljud från patientventilen. Kontrollera också att bröstkorgen sjunker.
- Vid fortsatt motstånd mot inblåsning, kontrollera om luftvägarna är blockerade och/eller ändra patientens position för att säkerställa öppen luftväg.
- Om patienten kastar upp under pågående ventilation, rensa omedelbart patientens luftväg och töm andningsballongen på uppkastningar genom att skaka och trycka samman ballongen kraftigt upprepade gånger innan du fortsätter med ventilationen. Torka vid behov av produkten med en trasa med tvättspit och rengör stänkskyddet med vatten.

Manometerport

Både Ambus engångsmanometer och manometrar från andra leverantörer kan anslutas till manometerporten på ovan sidan av patientventilen. Ta bort locket och anslut manometern/tryckmätaren

Tryckbegränsningssystem **4**

Tryckbegränsningsventilen är inställt för att öppnas vid 40 cm H₂O (4,0 kPa). **4.1**

Om ett tryck över 40 cm H₂O är indicerat efter medicinsk bedömning kan tryckbegränsningsventilen åsidosättas genom att flytta överkopplingsklämman på ventilen. **4.2**

Alternativt kan tryckbegränsningsventilen åsidosättas genom att hålla ett finger på den röda knappen samtidigt som ballongen kläms samman.

M-port

Ambu SPUR II finns med eller utan M-port. M-porten ger tillgång till det in- och exspiratoriska gasflödet och kan användas för att ansluta en spruta för att tillföra läkemedel, men också för att mäta endtidal CO₂ (EtCO₂). När M-porten inte används, kom ihåg att sätta tillbaka det röda locket för att stänga porten.

Mäta endtidal CO₂

För mätning av endtidal CO₂, anslut provtagningsslangen till endtidal CO₂-mätaren till M-porten på Ambu SPUR II andningsballong. Anslut provtagningsslangens kontakt genom att vrida den ett kvarts varv medurs.

Tillföra läkemedel

Var ytterst observant på hur patienten reagerar på den tillsatta medicineringen. Administrering av volymer på 1 ml vätska eller mer via M-Port är jämförbar med administrering direkt i en endotrakealtub. M-port har testats med epinefrin, lidokain och atropin.

Ambu SPUR II andningsballong med andningsstyrd ventil 5

Ambu SPUR II andningsballong med andningsstyrd ventil finns i storlekar för både vuxna och barn och kan användas med eller utan andningsstyrd ventil och en löstagbar oxygenreservoarpåse medföljer.

En adapter används för att koppla ihop inloppsventilen på Ambu SPUR II andningsballong med den andningsstyrda ventilen.

Koppla in den andningsstyrda ventilen:

- Ta bort oxygenreservoaren från inloppsventilen på Ambu SPUR II andningsballong om en sådan är ansluten.
- Anslut adaptern till den andningsstyrda ventilen.
- För in adaptern till andningsstyrda ventilen i inloppsventilen på Ambu SPUR II andningsballong.

OBS! Använd endast delen märkt "Kompressionsenhet" (Compression unit) tillsammans med adaptern och den andningsstyrda ventilen. Delen märkt "Oxygenreservoarpåse" (Oxygen Reservoir Bag) kan fungera som reserv om den andningsstyrda ventilen går sönder.

Administrering av syrgas

Administrera syrgas enligt medicinsk indikation.

Siffrorna i 6 visar beräknad tillförsel av syrgas i procent som kan erhållas vid olika ventilationsvolymer och -frekvenser vid olika gasflödeskastigheter. Syrehalterna visas för 6 Vuxen 6.1, Pediatrik 6.2, Spädbarn 6.3.

Oxygenreservoarpåse 7

Den tunna plastfolien på oxygenreservoarpåsen får aldrig tas loss från andningsballongen.

Tillbehör 8

Anslutningarna på Ambu SPUR II andningsballong följer standarderna ISO 5356-1 och SS-EN 13544-2 och uppfyller därmed kraven för användning med annan sjukhusutrustning. Om en extern enhet ska användas, kontrollera först att funktionen är korrekt och läs bruksanvisningen för den externa enheten.

Följande Ambu-produkter kan användas med Ambu SPUR II andningsballong:

Ambu® ansiktmask för engångsbruk

Mer information finns i bruksanvisningen för Ambu ansiktmask för engångsbruk.

Ambu® PEEP 20-ventil för engångsbruk 8.1 8.2

Mer information finns i bruksanvisningen för Ambu PEEP 20-ventilen för engångsbruk eller i illustrationen 8.1 i denna bruksanvisning. För att ansluta Ambu PEEP 20-ventilen för engångsbruk (vid behov) till andningsballongen, ta bort stänkskyddet. 8.2

Ambu® engångsmanometer 8.3

Mer information finns i bruksanvisningen för Ambu engångsmanometer.

4.4. Efter användning

Använda produkter måste kasseras i enlighet med vedertagna rutiner.

5. Tekniska produktspecifikationer

5.1. Tillämpade standarder

Andningsballongen Ambu SPUR II uppfyller kraven i den produktspecifika standarden SS-EN ISO 10651-4.

5.2. Specifikationer

	Spädbarn	Barn	Vuxna
Handventilatorns volym	ca 220 ml	ca 670 ml	ca 1 510 ml
Levererad volym, enhandsfattning*	150 ml	450 ml	600 ml
Levererad volym, tvåhandsfattning*	-	-	1 000 ml
Mått (längd x diameter) utan reservoar och tillbehör	ca 190 x 71 mm	ca 223 x 99 mm	ca 284 x 127 mm
Vikt utan reservoar och tillbehör	ca 70 g	ca 145 g	ca 220 g
Tryckbegränsningsventil**	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)
Dead space	≤ 5 ml + 10 % av den levererade volymen	≤ 5 ml + 10 % av den levererade volymen	≤ 5 ml + 10 % av den levererade volymen

	Spädbarn	Barn	Vuxna
Inspiratoriskt motstånd**	max 0,1 kPa (1,0 cm H ₂ O) vid 5 l/min	max 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) vid 50 l/min	max 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) vid 50 l/min
Exspiratoriskt motstånd**	max 0,2 kPa (2,0 cm H ₂ O) vid 5 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) vid 50 l/min	max 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) vid 50 l/min
Reservoarvolym	ca 300 ml (ballong) ca 100 ml (slang)	ca 2 600 ml (ballong)	ca 2 600 ml (ballong)
Patientanslutning		Utsida, 22 mm hane (ISO 5356-1) Insida, 15 mm hona (ISO 5356-1)	
Utandningsanslutning (för anslutning av PEEP-ventil)		30 mm hane (ISO 5356-1)	
Anslutning, manometerport		Ø 4,2 ± 0,1 mm	
Koppling för andningsstyrd ventil	-	Insida, 32 mm hona (SS-EN ISO 10651-4)	
Läckage, framåt och bakåt		Ej mättbart	
M-port		Anslutning kompatibel med SS-EN ISO 80369-7	
O ₂ -inloppsanslutning		Enligt SS-EN 13544-2	
Intervall för användningstemperatur		-18 till +50 °C, testad i enlighet med SS-EN ISO 10651-4	
Intervall för förvaringstemperatur		-40 till +60 °C, testad i enlighet med SS-EN ISO 10651-4	
Vid längre tids förvaring bör enheten förvaras öppnad i sin förpackning i rumstemperatur och ej i direkt solljus.			

* Testad enligt SS-EN ISO 10651-4.

** Högre leveranstryck kan erhållas genom att åsidosätta tryckbegränsningsventilen.

*** Vid allmänna testförhållanden enligt SS-EN ISO 10651-4.

5.3. MRT-säkerhet

Ambu SPUR II andningsballong¹ och Ambu SPUR II andningsballong med ansluten Ambu PEEP 20-ventil för engångsbruk² och Ambu SPUR II andningsballong med ansluten Ambu PEEP 20-ventil och ansluten manometer för engångsbruk² är MR-villkorade och kan därför användas på ett säkert sätt i MR-miljö (inte inne i MR-tunneln) under följande förutsättningar:

Statiskt magnetfält på högst 7 tesla med

- Maximalt spatialt gradientfält på
 - 10 000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16 000 G/cm (160 T/m)²
- Maximal kraft (produkt) på
 - 450 000 000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721 000 000 G²/cm (721 T²/m)²

Användning inne i MR-tunneln kan påverka MR-bildens kvalitet.

Ingen testning har utförts avseende RF-orsakad värme och artefakter på MR-bilder. Alla metalldelar är helt inkapslade och kommer inte i kontakt med människokroppen.

1. Önemli bilgiler – Kullanmadan önce okuyun

Ambu® SPUR® II Solunum Aletini kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun. Talimatlar önceden haber verilmeksızın güncellenebilir. Güncel versiyonun kopyaları talep üzerine temin edilebilir. Bu talimatların klinik prosedürleri açıklamadığını veya ele almadığını unutmayın. Burada sadece solunum aletinin çalışmasına ilişkin temel işlem ve önlemler açıklanmaktadır. Solunum aletinin ilk kullanımından önce, operatörlerin resüsitasyon teknikleri konusunda yeterli eğitim almış olması ve bu talimatlardaki kullanım amacını, uyarı, ikaz ve kontrendikasyonları bilmesi gerekmektedir. Ambu SPUR II Solunum Aleti garanti kapsamında değildir.

1.1. Kullanım amacı

Ambu® SPUR II Solunum Aleti, pulmoner resüsitasyon için tasarlanmış tek kullanımlık solunum aletidir.

1.2. Kullanım endikasyonları

Ambu SPUR II Solunum Aleti, destekli ventilasyon için manuel kardiyopulmoner solunum aletinin gerekli olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ambu SPUR II Solunum Aleti, daha belirleyici bir solunum yolu açılan veya hasta iyileşene kadar hastaların ventilasyon ve oksijenasyonu için endikedir.

1.3. Hedef hasta popülasyonu

Her versiyonun uygulama boyut aralığı şöyledir:

- **Erişkinler:**Erişkinler ve 30 kg dan (66 lb.) ağır çocukların.
- **Pediatrik:**Bebekler ve 6 kg ila 30 kg (13 - 66 lb) ağırlığındaki çocuklar.
- **Bebekler:**Yenidoğanlar ve ağırlığı 10 kg a (22 lb) kadar olan bebekler.

Tüm Ambu SPUR II Solunum Aleti konfigürasyonlarının üç hasta türü için de geçerli olmadığını lütfen unutmayın.

1.4. Hedef kullanıcı

Anestezi uzmanları, hemşireler, kurtarma personeli ve acil durum personeli gibi solunum yönetimi konusunda eğitim almış tıbbi profesyoneller.

1.5. Kontrendikasyonlar

Bilinen yok.

1.6. Klinik faydalari

Manuel solunum aletinin kullanıldığı temel solunum yönetimi tekniği, daha tanımlayıcı bir solunum yolu elde edilene veya hasta iyileşene kadar hastaların ventilasyonunu ve oksijenasyonunu sağlar.

1.7. Uyarı ve ikazlar

Bu uyarılara uyulmaması, hastanın yetersiz ventilasyon ve oksijenasyon almasıyla veya ekipmanın hasar görmesiyle sonuçlanabilir.

UYARILAR

1. Enfeksiyon riskini önlemek için solunum aletini maksimum 1 haftalık süre içinde art arda 4 saatten fazla kullanmayın.
2. Enfeksiyon ve arıza riskini önlemek için cihazın içinde gözle görülür nem veya kalıntı varsa solunum aletini tekrar kullanmayın.
3. Sıçrama Siperliğinin veya Ambu PEEP valfinin ekspirasyon portuna takılı olduğundan emin olun. Açık bir ekspirasyon portu yanlışlıkla tikanabilir ve akciğerlerde aşırı hava hacmine neden olarak doku travmasına yol açabilir.
4. Doku hasarı riskini önlemek için solunum aletini zehirli veya tehlikeli ortamlarda kullanmaktan kaçının.

5. Tüpün tikanması kompresyon balonunun yeniden şişmesini engelleyeceğinden ve bu da olası bir ventilasyona yol açabileceğinden, oksijen rezervuarı tüpünün tıkalı olmadığını her zaman kontrol edin.
6. Dış kaynaklarla kontamine olmuşsa enfeksiyona neden olabileceğinden ürünü kullanmayın.
7. Ürünü ambalajından çıkardıktan veya monte ettikten sonra ve kullanmadan önce mutlaka görsel olarak inceleyin ve bir fonksiyon testi yapın; aksi halde arızalar ve yabancı maddeler hastanın ya hiç ya da az ventilasyon almasına neden olabilir.
8. Fonksiyon testinden geçmemesi durumunda ürünü kullanmayın. Aksi takdirde bu durum hastanın ya hiç ya da az ventilasyon almasına neden olabilir.
9. Tibbi bir değerlendirmenin gerekli olduğu belirtilmedikçe basınç sınırlama valfini devre dışı bırakmayın. Yüksek ventilasyon basıncıları barotravmaya neden olabilir.
10. Sadece tek kullanımlıktır. Başka hastalarda kullanılması çapraz enfeksiyona neden olabilir.
11. Solunum aleti ile yüz maskesi arasına aksesuarlar (ör. filtre, CO₂ dedektörü) bağlı olduğunda ilaç M-portu üzerinden iletilemez.
12. Hastaya O₂ iletiminin azalmasına yol açabilecek bir sızıntıyı önlemek için M-port'u kullandıkten sonra açık bırakmayın.
13. Doğru olmayan EtCO₂ ölçümülarından kaçınmak amacıyla, M-Port, 400 ml'nin altında Tidal Hacim ile ventile edilen hastaların yan akım EtCO₂ takibinde kullanılmamalıdır.
14. 1 ml'nin altında hacme sahip ilaç uygularken, doğru ilaç dozajının uygulanmasını sağlamak için M-Port'un yikanması gereklidir.
15. Amaçlanan O₂ konsantrasyonu hastaya iletilmeyeceğinden, M-port'a oksijen besleme tüpü bağlamayın.
16. Aksesuarlar eklenerek inspirasyon ve/veya ekspirasyon direnci artırılabilir. Yüksek soluk alış-veriş direnci hasta için zararlı olacak ise aksesuar takmayın.
17. Yanlış kullanım hastaya zarar verebileceği için yalnızca bu kılavuzun içeriğine aşina olan hedef kullanıcılar tarafından kullanılmalıdır.
18. Oksijen takviyesi kullanırken, yangın ve/veya patlama riskinden dolayı cihazın açık alev, ya , gres, di er yanici kimyasal veya ekipman ve araçların yakınında sigara içilmesine veya kullanmasına izin vermeyin.
19. Bebek versiyonuna herhangi bir hava supabı takmaya çalışmayın çünkü bu durum yenido anlar için zararlı olabilecek yüksek oksijen konsantrasyonlarına neden olabilir.
20. Oksijen iletiminin olmamasına veya kısıtlı olmasına neden olabileceğinden yüz maskesine takılı solunum aletini kullanırken tüm/kısmı üst solunum yolu tıkanıklık belirtilerine dikkat edin. Belirtiler varsa hastaya hava iletmek için daima yüz maskesi yerine alternatif bir maske tercih edin.
21. İnsuflasyon riski nedeniyle konjenital diyafram fiti ına sahip bebeklerin ventilasyonu sırasında yüz maskesi takılı ürünleri kullanmayı. Hastaya hava iletmek için mevcut olması halinde bir yüz maskesi kullanma ihtimalini değerlendirin.
22. Yanlış kullanım hastaya zarar verebileceğinden prosedürü gerçekle ten uzmanlar, hastanın özel durumu/koşulları uyarınca solunum aleti boyutu ve aksesuarları (örn. yüz maskesi, PEEP valfi vb.) seçimini dikkate almalıdır.
23. Hipoksije neden olabilecek olası yetersiz oksijen uygulaması nedeniyle serbest aki ı oksijen veriliırken Ambu SPUR II'yi kullanmayın.
24. Basınç izlenmedi inde sızıntıyı önlemek için Manometre kapa ı daima Manometre bağlantı noktasına yerleştirilmelidir çünkü bu durum hastaya O₂ iletiminin azalmasına neden olabilir.
25. 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda montaj zorla abileceğinden ve bu durum hastaya oksijen iletimini azaltabileceğinden oksijen tüpünü her zaman 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oksijen beslemesine önceden ba layın.
26. Solunum aletini yüz maskesi takılıken kullanırken yüz maskesinin doğru konumlandırıldığından ve mühürlendi inden emin olun çünkü uygun şekilde kapatılmaması hava yoluyla bula ıcı hastalığın kullanıcıya yayılmasına neden olabilir.

UYARILAR

1. Solunum aletini, üretici tarafından teslimat sırasında katlanması dışında asla şekli bozulmuş vaziyette saklamayın, aksi takdirde balon kalıcı olarak deform olabilir ve ventilasyon verimi düşebilir. Katlama yerleri, balon üzerinde açıkça görülmektedir (sadece yetişkin ve pediyatrik versiyonlar katlanabilir).
2. Ventilasyonu takip etmek için mutlaka göğüs hareketlerini izleyin ve valften gelen hava üfleme sesini dinleyin. Solunum aletiyle ventilasyon sağlanamıysa derhal suni teneffüs uygulamasına geçin.
3. Bu cihazı suya batırmayın, yıkamayın veya sterilize etmeyin, aksi takdirde bu işlemler cihaz üzerinde zararlı kalıntılar bırakabilir veya cihazın arızalanmasına neden olabilir. Cihazın tasarımı ve malzemesi geleneksel temizlik ve sterilizasyon işlemleriyle uyumlu değildir.
4. Ölçülen değerleri değiştirebileceğinden M-Port'u sadece EtCO₂ ölçümü veya ilaç uygulamasından biri için kullanın.
5. Yanlış kullanım tüm ürünün arızalanmasına neden olabileceğiinden, mevcut olmasının halinde, her bir aksesuar hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen aksesuarın ambalajına bakın.
6. Üçüncü taraf ürünlerin ve oksijen dağıtım cihazlarının kullanımı (örn. Ambu SPUR II Solunum Aletine sahip filtreler ve hava supapları) ürün performansını etkileyebilir. Ambu SPUR II Solunum Aletiyle uyumluluğu doğrulamak ve olası performans değişiklikleri hakkında bilgi almak için lütfen üçüncü taraf cihazın üreticisine danışın.
7. Oksijen rezervuarı balonu, hava supaplı versiyonları hariç olmak üzere, erişkin ve pediyatrik solunum aletlerindeki giriş valfine kalıcı olarak takılır. Parçalarını ayırmaya çalışmayın. Cihazın arızalanmasına neden olabileceğiinden oksijen rezervuarı balonunu çekmeyin.

1.8. Potansiyel advers etkiler

Resusitasyonla ilgili potansiyel advers etkiler (tümünü kapsamaz): barotratma, volutratma, hipoksi, hiperkarbial ve aspirasyon pnömonisi.

1.9. Genel notlar

Bu cihaz kullanılırken veya cihazın kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi hasar meydana gelirse lütfen durumu üreticiye ve yetkili ulusal makama bildirin.

2. Cihazın tanımı

Ambu SPUR II Solunum Cihazı, 4.3 Solunum Cihazının Çalıştırılması bölümünde açıklanıldığı gibi Ambu® Tek Kullanımlık Basınç Manometresine, Ambu® PEEP Valflerine ve Ambu® Yüz maskelerine bağlanabilir.

3. Kullanılan sembollerin açıklaması

Sembol anlamı	Açıklama
	Erişkin Hedeflenen ideal vücut kütlesi 30 kg'dan büyük
	Pediatrik 6 - 30 kg arası ideal vücut kütlesi
	Bebek 10 kg'a kadar ideal vücut kütlesi
	MR koşullu

Sembol anlamı	Açıklama
	Üretildiği Ülke
	Tıbbi Cihazdır
	Aynı Hastada Tekrar Kullanılabilir
	Oksijen rezervuarı balonunu zorlayarak çekmeyin

Sembol açıklamalarının tam listesi şu adreste bulunabilir:
<https://www.ambu.com/symbol-explanation>

4. Ürünün kullanımı

4.1. Çalışma prensipleri

1 Şekilde, solunum cihazının manuel olarak çalıştırılması sırasında ventilasyon gazı karışımının ventilasyon balonuna ve hastaya/hastadan akışı gösterilmektedir. 1a Erişkinler için ve pediyatrik solunum cihazı, 1b kapalı oksijen rezervuarı balonu, 1c açık oksijen rezervuar tüplü bebek solunum cihazı (tüp rezervuarları).

Gaz akışı, hastanın cihaz aracılığıyla spontane nefes alıp vermesine benzemektedir.

Oksijen rezervuarına iki valf takılıdır, biri rezervuar boş olduğunda ortam havasının içeri çekilmesini sağlarken diğeri oksijen rezervuar balonu doluyken fazla oksijeni dışarı atar.

M-Port, inspiratuar ve ekspiratuar gaz akışına erişim sağlayarak ilaç vermek için bir şırınga bağlanmasıne 1d ya da EtCO₂ yan akışının ölçümü için bir gaz numune hattı bağlanmasıne olanak tanır 1e.

- 1.1 Fazla oksijen salımı, 1.2 Hava girişi, 1.3 Oksijen girişi, 1.4 Hasta konektörü, 1.5 Ekspirasyon, 1.6 Manometre yuvası, 1.7 Basınç sınırlama valfi, 1.8 M-port.

NOT: 1.5'e yapılacak ek bir sırçrama siperi veya PEEP valfi olabilir.

4.2. İnceleme ve Hazırlık

Solunum cihazı, paketinden çıkarılmalı ve acil durumlarda kullanılmak üzere hazır hale getirilmelidir (bir fonksiyon testi de yapılmalıdır).

4.2.1. Hazırlık

- Solunum cihazı basınçlı bir durumda paketlenmiş hasta valfi ve giriş valfini çekerek katlamayı açın.
- Solunum cihazını hazırlayın ve tüm öğeleri solunum cihazıyla birlikte temin edilen taşıma çantasına yerleştirin.
- Solunum aletiyle birlikte temin edilen yüz maskesi koruyucu bir poşet içine sarılmışa kullanmadan önce içinden çıkarılmalıdır.

Bölüm 4.2.2'ye bakın. (Oksijen tüpü) aleti 0 °C'nin altında kullanmadan önce hazırlamak için.

4.2.2. Fonksiyon testi 2

Solunum aleti

Basınç sınırlama valfini devre dışı bırakma klipsiyle, hasta konektörünü ise başparmağınızla 2.1 kapatın. Sıkıştırılabilir balonu hemen sıkın. Solunum aleti sıkıma dirençli olmalıdır.

Devre dışı bırakma klipsini kaydırarak ve prosedürü tekrarlayarak basınç sınırlama valfini açın. Basınç sınırlama valfi şu anda etkin olmalıdır ve sıkıştırılabilir balonun hızla sıkılması esnasında valften akış duyuluyor olmalıdır.

Solunum aletini birkaç kez sıkıp bırakarak havanın valf sistemi boyunca ilerleyerek hasta valfinden çıktılarından emin olun. **2.2**

NOT: Valf diskleri fonksiyon testi ya da ventilasyon sırasında hareket ederken hafif bir ses duyulabilir. Bu durum solunum aletinin fonksiyonunu olumsuz etkilemez.

Oksijen tüpü

Oksijen tüpü montajı ve oksijen rezervuar balonu ile oksijen rezervuar tüpünün fonksiyon testi 0 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Solunum aletinin 0 °C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanılması için fonksiyon testinden sonra oksijen tüpünü oksijen kaynağına bağlı bırakın.

Oksijen rezervuarı balonu

Oksijen giriş konektörüne 10 l/dk gaz akışı sağlayın. Balonun açılmasını elle destekleyin. Oksijen rezervuarı balonunun dolduğu kontrol edin. Dolmaması halinde iki valf sürgüsünün de mevcut olduğunu ve yırtık bir oksijen rezervuarı olmadığını kontrol edin.

Ardından cihazla birlikte verilen gaz akışını tıbbi endikasyona uygun şekilde ayarlayın.

Oksijen rezervuarı tüpü

Oksijen giriş konektörüne 10 l/dk gaz akışı sağlayın. Rezervuar tüpünün ucundan oksijen çıkışı olup olmadığını kontrol edin. Çıkış yoksa oksijen tüpünün tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. Ardından cihazla birlikte verilen gaz akışını tıbbi endikasyona uygun şekilde ayarlayın.

M-Port

M-Port kapağını çıkarın ve hasta konektörünü tikayın. Balonu sıkın ve M-Port üzerinden hava tahliyesi olduğunu görmek için sesi dinleyin. **2.3**

4.3. Solunum aletinin kullanımı

- Hastanın ağızını ve solunum yollarını açmak amacıyla hastayı doğru konuma getirmek için tavsiye edilen teknikleri kullanın.
- Yüz maskesini hastanın yüzüne doğru sıkıca tutun. **3.1**
- Elinizi (Erişkin Versiyonu) veya yüzük ve orta parmağınızı (Pediyatrik versiyon) destek tutamağının altına yerleştirin. Bebek versiyonunda destek tutamağı yoktur. Destek tutamağı kullanılmadan ventilasyon balon çevrilerek gerçekleştirilebilir. **3.2**
Destek tutamağı kullanılmadan ventilasyon balon çevrilerek gerçekleştirilebilir. **3.2**
Hastaya ventilasyon uygulanması: İnsuflasyon sırasında göğüs yükselişine dikkat edin.
Balonu tutan eli birden serbest bırakın, hasta valfinden gelen nefes verme akışını dinleyin ve göğüsün inmesini gözlemleyin.
- İnsuflasyona karşı sürekli dirençle karşılaşılırsa solunum yolunu tıkanma açısından kontrol edin ve açık solunum yolunun sağlandığından emin olmak için hastayı yeniden konumlandırın.
- Ventilasyon sırasında hasta kusarsa hastanın solunum yolunu hemen temizleyin ve ventilasyona devam etmeden önce solunum aletini birkaç kez kuvvetli ve hızlı bir şekilde sallayarak kusmuğu çıkarın.
Gerekirse ürünü alkol içeren bir bezle silin ve sıçrama siperini suyla temizleyin.

Manometre yuvası

Ambu tek kullanımlık basınç manometresi ve üçüncü taraf basınç göstergesi, hasta valfinin üst kısmında bulunan manometre yuvasına takılabilir. Kapağı çıkarın ve manometreyi/basınç ölçeri takın

Basınç sınırlama sistemi 4

Basınç sınırlama valfi, 40 cm H₂O'da açılacak biçimde ayarlanmıştır (4.0kPa). 4.1

Tibbi ve profesyonel değerlendirme 40 cm H₂O üzerinde bir basınç gerektirirse kapama klipsi valfin üzerine doğru hareket ettirilerek basınç sınırlama valfi devre dışı bırakılabilir. 4.2

Alternatif olarak, balonu sıkarken kırmızı düğmenin üzerine parmağınızı sokarak da basınç sınırlama valfi devre dışı bırakılabilir.

M-Port

Ambu SPUR II Solunum Aleti bir M-Port ile veya onsuz temin edilir. M-Port inspirasyon ve ekspirasyon gaz akışına erişim sağlar ve bir şiringayla uygulanan ilaçların uygulanması için ve yan akım CO₂ (EtCO₂) ölçümü için kullanılabilir. Kullanılmadığında M-port'u kırmızı M-port kapağıyla kapatmayı unutmayın.

EtCO₂ Ölçümü

Yan akım EtCO₂ ölçümü için EtCO₂ ölçüm cihazının gaz örnekleme hattını Ambu SPUR II Solunum Cihazının M-Port'una bağlayın. Gaz numune alma hattı konektörünü monte ederek ve saat yönünde 1/4 tur çevirerek bağlayın.

İlaç uygulama

Uygulanan ilaç dozuna hastanın verdiği tepkileri dikkatlice gözlemleyin. M-Port yoluyla 1 ml hacminde veya daha fazla sıvı uygulanması, doğrudan endotrakeal tüp içine yapılan uygulamaya eş değerdir. M-Port; epinefrin, lidokain ve atropinle test edilmiştir.

Ambu SPUR II Solunum Aleti hava supabı versiyonu 5

Ambu SPUR II Solunum Aleti hava supabı versiyonu, erişkin ve pediyatrik boyutlarında mevcuttur ve hava supaplı veya supapsız olarak kullanılabilmesinin yanı sıra, takılabilir oksijen rezervuar balonuyla birlikte gelir.

Ambu SPUR II Solunum Aletinin giriş valfi bir adaptör aracılığıyla hava supabına bağlanır.

Hava supabının takılması:

- Takılı olması halinde, oksijen rezervuarı ünitesini Ambu SPUR II Solunum Aleti giriş valfinden çıkarın.
- Adaptörü hava supap sistemine takın.
- Talep valfi adaptörünü Ambu SPUR II Solunum Cihazı giriş valfine takın.

NOT: Adaptör ve Hava supabıyla birlikte yalnızca "kompresyon ünitesi" etiketli parça kullanın.
"Oksijen Rezervuar Balonu" etiketli parça, hava supabı arızalandığında yedek olarak kullanılabilir.

Oksijen yönetimi

Medikal göstergelere uygun olarak oksijen uygulayın.

Şekil 6'de, farklı gaz akış hızlarında farklı ventilasyon hacimleri ve frekanslarıyla elde edilebilecek Hesaplanmış verilen oksijen yüzdesi gösterilmektedir. Oksijen yüzdesi 6 Erişkin 6.1, Pediatrik 6.2, Bebek 6.3 ürünlerinde görülebilir.

Oksijen rezervuarı balonu 7

Ince oksijen rezervuar balonunun plastik folyosu, hiçbir zaman solunum aletine bağlı olan sabitlenme noktasından çıkarılamaz.

Aksesuarlar 8

Ambu SPUR II Solunum Cihazı konektörleri, ISO 5356-1 ve EN 13544-2'ye uygun olduğundan diğer hastane ekipmanıyla uyumludur. Harici cihazları bağlarken işlevselliliği test ettiğinizden emin olun ve birlikte gönderilen harici cihazın kullanımı için talimatlara başvurun.

Ambu SPUR II Solunum Aleti ile uyumlu Ambu ürünleri aşağıda belirtilmiştir:

Ambu® Tek Kullanımlık Yüz Maskesi

Détailli bilgi için lütfen Ambu Tek Kullanımlık Yüz Maskesinin kullanım yönergelerine bakın.

Ambu® Tek Kullanımlık PEEP 20 valfi 8.1 8.1

Daha fazla bilgi için lütfen Ambu Tek Kullanımlık PEEP 20 valfinin kullanım talimatlarına veya bu Kullanım Talimatlarındaki şekil 8.1'e bakın. Ambu Tek Kullanımlık PEEP 20 valfini (gerekirse) solunum aletine takmak için sıçrama siperini çıkarın. 8.2

Ambu® Tek Kullanımlık Basınç Manometresi 8.3

Detaylı bilgi için lütfen Ambu® Tek Kullanımlık Basınç Manometresinin kullanım yönergelerine bakın.

4.4. Kullanım sonrası

Kullanılmış ürünler yerel prosedürlere göre imha edilmelidir.

5. Ürünün teknik özellikleri

5.1. Uygulanan standartlar

Ambu SPUR II solunum aleti, EN ISO 10651-4 ürün normlarına uygundur.

5.2. Özellikler

	Bebek	Pediatrik	Erişkin
Solunum aleti hacmi	yakl. 220 ml	yakl. 670 ml	yakl. 1510 ml
Tek elle iletilen hacim*	150 ml	450 ml	600 ml
İki elle iletilen hacim*	-	-	1000 ml
Rezervuar ve aksesuarlar olmadan ebatlar (uzunluk x çap)	yakl. 190 x 71 mm	yakl. 223 x 99 mm	yakl. 284 x 127 mm
Rezervuar ve aksesuarlar olmadan ağırlık	yakl. 70 g	yakl. 145 g	yakl. 220 g
Basınç sınırlama valfi*	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)	4,0 kPa (40 cm H ₂ O)

	Bebek	Pediatrik	Erişkin
Ölü hacim	≤5 ml + iletilen hacmin %10'u	≤5 ml + iletilen hacmin %10'u	≤5 ml + iletilen hacmin %10'u
İspiratuvar direnç***	maks. 0,1 kPa 5 lt/dak'da (1,0 cm H ₂ O)	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O), 50 lt/dak'da	maks. 0,5 kPa (5,0 cm H ₂ O) 50 lt/dak'da
Ekspiratuvar direnç**	maks. 0,2 kPa 5 lt/dak'da (2,0 cm H ₂ O)	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O), 50 lt/dak'da	maks. 0,27 kPa (2,7 cm H ₂ O) 50 lt/dak'da
Rezervuar hacmi	yakl. 300 ml (balon) yakl. 100 ml (tüp)	yakl. 2600 ml (balon)	yakl. 2600 ml (balon)
Hasta konektörü		22 mm erkek dış (ISO 5356-1) 15 mm dişi iç (ISO 5356-1)	
Ekspirasyon konektörü (PEEP valfi bağlanması için)		30 mm erkek (ISO 5356-1)	
Manometre Yuvası konektörü		Ø 4,2 +/- 0,1 mm	
Hava Supabı konektörü	-	32 mm dişi iç (ISO 10651-4)	
İleri ve geri sızıntı		Ölçülebilir değil	
M-Port		EN ISO 80369-7 ile uyumlu konektör	
O ₂ giriş konektörü		EN 13544-2'ye göre	
Çalıştırma sıcaklığı limitleri		-18 °C ila +50 °C (-0,4 °F ila +122 °F) EN ISO 10651-4'e göre test edilmiştir	
Saklama sıcaklık aralığı		-40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) EN ISO 10651-4'e göre test edilmiştir	
Kapalı ambalajda, güneş ışığından uzakta ve oda sıcaklığında uzun süreli saklama önerilir.			

* EN ISO 10651-4'e göre test edilmiştir.

** Basınç sınırlama valfi devre dışı bırakılarak daha yüksek besleme basıncı elde edilebilir.

*** Genel test koşullarında EN ISO 10651-4'e göre.

5.3. MRG Güvenlik Bilgileri

Ambu SPUR II Solunum Cihazı¹ ve Ambu SPUR II Solunum Cihazı, beraberinde Ambu Tek Kullanımlık PEEP 20 Valf² ve Ambu SPUR II Solunum Cihazı, beraberinde Ambu Tek Kullanımlık PEEP 20 Valf ve Ambu Tek Kullanımlık Basınç Manometresi³ MR Koşulludur ve bu nedenle aşağıdaki koşullar altında MR ortamında (MR silindiri içinde değil) güvenli bir şekilde kullanılabilir.

7 Tesla ve daha düşük statik manyetik alan

- Maksimum uzamsal alan eğimi
 - 10.000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16.000 G/cm (160 T/m)²
- Maksimum kuvvet ürünü
 - 450.000.000 G²/cm (450 T²/m)¹
 - 721.000.000 G²/cm (721 T²/m)²

MR silindirinin içinde kullanılması MR görüntü kalitesini etkileyebilir.

RF kaynaklı ısınma ve MR görüntü artefaktları test edilmemiştir. Metal parçalar tamamen kapsüllenmiştir ve insan vücutuyla herhangi bir teması yoktur.

1. 重要信息 – 使用前请阅读

在使用 Ambu® SPUR® II 人工呼吸器之前, 请认真阅读这些安全说明。本使用说明可能会更新, 忽不另行通知。可以按需提供最新版本副本。请注意, 这些使用说明不对临床程序进行解释或讨论。它们只介绍人工呼吸器的基本操作以及与操作相关的注意事项。初次使用人工呼吸器系统前, 操作人员应当接受过人工呼吸器使用方法的充分培训, 并且熟悉这些使用说明中所述的预期用途、警告、小心和适应症。对 Ambu SPUR II 人工呼吸器不予担保。

1.1. 预期用途

Ambu SPUR II 人工呼吸器是供单个患者使用的装置, 用于肺部复苏。

1.2. 用途

Ambu SPUR II 人工呼吸器用于需要人工心肺复苏器辅助通气的情况。

Ambu SPUR II 人工呼吸器适用于患者通气和氧合, 直到建立更明确的气道或病人康复。

1.3. 目标患者人群

每种型号的适用体重范围是:

- **成人:** 体重在 30 公斤 (66 磅) 以上的成人和儿童。
- **小童:** 体重在 6 公斤至 30 公斤 (13 – 66 磅) 之间的婴儿和儿童。
- **婴儿:** 体重不超过 10 公斤 (22 磅) 的新生儿和婴儿。

请注意, 并非所有 Ambu SPUR II 人工呼吸器配置都可用于所有三个患者范围。

1.4. 目标用户

受过气道管理培训的医疗专业人员, 如麻醉师、护士、救援人员和急救人员。

1.5. 禁忌症

未知。

1.6. 临床优势

使用人工呼吸器的基本气道管理技术允许患者通气和供氧, 直到建立更明确的气道或患者已恢复。

1.7. 警告和小心

不遵守这些注意事项可能会导致患者通气和氧合的效率低下, 或造成设备损坏。



1. 人工呼吸器最长使用时间不得超过 1 周, 在此期限内的累计使用时间不得超过 4 小时, 以避免感染风险。
2. 如果人工呼吸器内有可见水分或残留物, 请勿重复使用, 以避免感染和出现故障的风险。
3. 确保将防溅罩或 Ambu PEEP 阀连接到呼气口。开放的呼气口可能会意外堵塞, 导致肺部空气量过多, 进而导致组织创伤。
4. 避免在有毒或危险的环境中使用人工呼吸器, 以免造成组织损伤。
5. 务必确保储氧管未被堵塞, 因为阻断输送管可防止压缩袋重新充气, 从而导致无法进行通气。
6. 如果产品被外部污染源污染, 请勿使用, 否则可能会导致感染。
7. 在拆开包装、组装和使用前, 一定要目视检查产品并执行功能测试, 因为缺陷和异物可能导致患者无法通气或通气不畅。
8. 如果功能测试失败, 请勿使用产品, 否则可能导致患者无法通气或通气不畅。
9. 除非医学评估证明有必要, 否则绝不可覆盖限压阀。较高的通气压力可能导致气压伤。
10. 一次性使用。用于其他患者会造成交叉感染。
11. 如果人工呼吸器和面罩之间连接有配件 (例如 过滤器、CO₂ 探测器), 则无法通过 M-Port 输送药物。

12. 使用后请勿打开 M-Port，以免发生泄漏，否则可能会减少向患者输送的 O₂。
13. 当通气潮气量小于 400 ml 时，请勿将 M-Port 用于患者的侧流 EtCO₂ 监测，避免 EtCO₂ 的测量值不准确。
14. 当给药量低于 1 ml 时，需要冲洗 M-Port 以确保准确的给药剂量。
15. 请勿将氧气供应管连接至 M-Port，因为不会向患者输送预期的 O₂ 浓度。
16. 添加附件后，可能会增大吸气和/或呼气阻力。如果增大的呼吸阻力对患者极其不利，请不要连接附件。
17. 只能由熟悉本手册内容的预期用户使用，因为不正确的使用可能会对患者造成伤害。
18. 使用补充氧气时，请勿在明火、油、油脂、其他易燃化学品或设备及工具附近吸烟或使用设备，否则，将会引起火花，存在火灾和/或爆炸风险。
19. 请勿尝试将任何按需阀连接至婴儿型呼吸器，因为这可能导致氧气浓度过高，可能对新生儿有害。
20. 使用与面罩连接的人工呼吸器时，请注意完整/部分上呼吸道阻塞标志，因为这会导致氧气无法输送或输送受限。如果可能，请始终换用面罩将空气引至患者。
21. 对患有先天性膈疝的婴儿通气时，切勿使用连接面罩的产品，否则会有吹气风险。如果可能，请换用面罩将空气引至患者。
22. 执行手术的专业人员应根据患者的具体情况评估人工呼吸器尺寸和附件的选择（例如，面罩、PEEP 阀等），因为不正确使用可能会对患者造成伤害。
23. 由于可能会因给氧不足而导致缺氧，因此在需要输送自由流动的氧气时，请勿使用 Ambu SPUR II。
24. 未监测压力时，压力计盖必须始终盖在压力计端口上，以避免泄漏，否则可能会导致向患者输送的 O₂ 减少。
25. 当温度高于 0 °C 时，务必将氧气管预先连接至氧气供应装置，因为当温度低于 0 °C 时，安装将会变得困难，从而导致向患者输送的氧气量减少。
26. 使用带面罩的人工呼吸器时，确保正确放置和密封面罩，因为不恰当的密封可能导致将空气传染性疾病传染给使用者。

小心

1. 人工呼吸器在存储时不能变形，制造商供应时被折叠的情况除外，否则储氧袋可能永久变形，降低通气效率。储氧袋上的折叠区域清晰可见（只有成人型和小童型可折叠）
2. 要一直观察胸部运动，倾听患者阀门的出气流量，以便检查通气情况。如果无法使用人工呼吸器实现有效通气，立即切换到口对口通气。
3. 切勿浸泡、冲洗该装置或者对其进行消毒，这样做会留下有害的残余物或者导致装置出现故障。本装置的设计及所用材料不适用于传统的清洁和消毒程序。
4. 只能将 M-Port 用于两种操作之一，即测量 EtCO₂ 或药物管理，因为这会修改测量的值。
5. 如果适用，请参阅配件包装了解各个配件的更具体信息，因为错误的处理可能导致整个产品出现故障。
6. 将第三方产品和氧气输送装置（例如，过滤器和按需阀）与 Ambu SPUR II 人工呼吸器一起使用可能会影响产品性能。请向第三方装置制造商咨询，以确认是否与 Ambu SPUR II 人工呼吸器相兼容，并获取有关可能的性能变化的信息。
7. 除按需阀型号外，储氧袋固定安装在成人和小童用人工呼吸器的进气阀上。不要尝试拆卸。请勿拉动储氧袋，否则可能导致装置出现故障。

1.8. 潜在不良事件

与复苏相关的潜在不良事件（非详尽清单）：气压伤、肺容积伤、缺氧、高碳酸血症和吸入性肺炎。

1.9. 基本注意事项

如果在设备使用过程中出现严重事故，或者因使用设备而导致严重事故，请向制造商及主管当局报告。

2. 设备说明

Ambu SPUR II 人工呼吸器可连接至 Ambu® 一次性压力计、Ambu® PEEP 阀和 Ambu® 面罩，如第 4.3 节“操作人工呼吸器”所述。

3. 所用符号的说明

符号指示	说明
	成人 预期理想体重为超过 30 公斤
	小童 预期理想体重为 6 至 30 公斤
	婴儿 预期理想体重为不超过 10 公斤
	MR 特定条件下安全
	制造商所属国家/地区
	医疗器械

符号指示	说明
	可供单个患者多次使用
	请勿用力拉出储氧袋

<https://www.ambu.com/symbol-explanation> 上提供了符号解释的完整清单。

4. 产品使用

4.1. 操作原理

示意图 1 示出了在手动操作人工呼吸器期间，混合气体如何进入袋中和进出患者身体。
1b 成人和小儿用人工呼吸器，**1c** 带封闭式储氧袋的婴儿用人工呼吸器，**1d** 带开放式储氧管的婴儿用人工呼吸器。

气流相当于患者通过装置自主呼吸时的程度。

储氧袋配备两个阀门，其中一个允许在储氧袋为空时吸入周围空气，另一个允许在储氧袋满时排出多余氧气。

通过 M-Port 提供进出气流，可与注射器连接后进行给药 **1d**，也可连接至气体取样线以测量侧流 EtCO₂ **1e**。

1.1 过量氧气释放口、**1.2** 进气口、**1.3** 氧气进气口、**1.4** 患者连接器、**1.5** 呼气口、**1.6** 压力计端口、**1.7** 限压阀、**1.8** M-Port。

注意：1.5 的附件可以是防溅罩或 PEEP 阀。

4.2. 检查和准备

准备人工呼吸器应对紧急情况时，必须先打开包装并做好可以立即使用的准备（包括执行功能测试）。

4.2.1. 准备

- 如果人工呼吸器呈压缩状态包装，拉患者阀门和进气阀可打开人工呼吸器。
- 准备人工呼吸器并将所有物品放入人工呼吸器随附的手提箱袋内。
- 如果人工呼吸器附带的面罩外套有保护袋，使用前要将其去掉。

请参阅第 4.2.2 节。（氧气管），用于在低于 0 °C 的温度下使用前准备设备。

4.2.2. 功能测试 ②

人工呼吸器

用覆盖夹关闭限压阀，并用拇指关闭患者接头 ②.1。轻且快地挤压可压缩袋。人工呼吸器应当能够耐受挤压。

滑开覆盖夹并重复上述步骤，打开限压阀。此时，限压阀应已激活，在对可压缩袋进行快速压缩期间，应该可以听到阀中气流的声音。

挤压并释放人工呼吸器数次，确保空气通过阀门系统排出患者阀门。 ②.2

注意：在功能测试或排气过程中，阀片可能会在移动过程中发出轻微的声音。但这不会影响人工呼吸器的功能。

氧气导管

氧气导管的安装以及储氧袋和储氧管的功能测试应在高于 0 °C 的温度下进行。在低于 0 °C 的温度下使用人工呼吸器时，应在完成功能测试后保持氧气导管连接到氧气供应源。

储氧袋

在氧气进气接口处提供 10 l/min 的气流。最后，用手支撑展开袋子。检查储氧袋是否充满。如果未满，检查两个进气阀是否完整或者储氧袋是否破损。

然后，根据医学指征调节所供应的气体流量。

储氧管

在氧气进气接口处提供 10 l/min 的气流。检查氧气是否从储氧管末端排出。如果不是，检查输氧导管是否阻塞。然后，根据医学指征调节所供应的气体流量。

M-Port

移除 M-Port 盖并堵住患者接头。挤压袋子并倾听空气从 M-Port 压出的声音。 ②.3

4.3. 操作人工呼吸器

- 按照推荐的方法清理患者口腔和气道，让患者保持正确体位以打开气道。
- 将面罩紧紧贴住患者面部。 ③.1
- 在把手下方滑动您的手（成人型）或无名指和中指（小童型）。婴儿型没有支撑把手。不用支撑把手的情况下，可以通过旋转储氧袋来实现通气。 ③.2 保持患者通气：吹气期间，观察胸部是否隆起。突然释放储氧袋，倾听从患者阀门经过的呼气气流，并观察胸部下降情况。
- 如果吹气持续受阻，检查气道是否堵塞，并调整患者体位，确保气道通畅。
- 如果患者在通气期间出现呕吐；立即清理患者气道，通过用力和快速摇动和按压数次，将呕吐物从人工呼吸器中排出，然后再恢复通气。
- 必要时，使用含酒精的布擦拭产品，然后用清水清洁防溅罩。

压力计端口

Ambu 一次性压力计和第三方压力计可连接至位于患者阀门顶部的压力计端口。取下密封盖，安装压力计

限压系统 ④

限压阀设置为在 40 cm H₂O (4.0kPa) 时打开。 ④.1

如果医学和专业评估表明需要高于 40 cm H₂O 的压力，则可通过将覆盖夹移动到阀门上来覆盖限压阀。 ④.2

也可以在挤压储氧袋时，将食指放在红色按钮上覆盖限压阀。

M-Port

Ambu SPUR II 人工呼吸器带有或不带 M-Port。M-Port 提供吸气和呼气气流通路，可在连接到注射器时应用药物，也可用于测量侧流 CO₂ (EtCO₂)。不使用时，记住用红色 M-Port 盖封闭 M-Port。

测量 EtCO₂

用于测量侧流 EtCO₂；将 EtCO₂ 测量设备的气体采样管连接至 Ambu SPUR II 人工呼吸器的 M-Port。安装气体采样管接头并顺时针旋转 1/4 圈，将其连接。

药物治疗

仔细观察患者对给药的反应。通过 M-Port 给予 1 毫升或以上药液，不亚于直接通过气管内导管给药。M-Port 已经通过应用肾上腺素、利多卡因和阿托品的测试。

Ambu SPUR II 人工呼吸器按需阀型号 5

Ambu SPUR II 人工呼吸器按需阀有成人和小童尺寸可供选择，可带或不带按需阀，并配有可连接的储氧袋。

Ambu SPUR II 人工呼吸器的入口阀通过适配器连接到按需阀。

连接按需阀：

- 从 Ambu SPUR II 人工呼吸器入口阀（如果已连接）上拆下储氧袋装置。
- 将适配器连接到按需阀系统。
- 将按需阀适配器插入 Ambu SPUR II 人工呼吸器入口阀。

注意：只能将带有“压缩设备”标签的部件与适配器和按需阀一起使用。如果需求阀出现故障，带有“储氧袋”标签的部件将被视为备用部件。

氧气管理

根据医学指征给氧。

图 6 示出了不同气体流速下，使用不同通气量和频率时计算得出的已输送气体的含氧百分比。含氧百分比在图 6 中对应的成人 6.1、小童 6.2、婴儿 6.3 表中示出。

储氧袋 7

任何时候，都要保持薄型氧气储氧袋塑料薄膜与其在人工呼吸器上的固定点相连接。

附件 8

Ambu SPUR II 人工呼吸器连接器符合 ISO 5356-1 和 EN 13544-2 标准，因此符合其他医院设备的要求。如果要在人工呼吸器上连接外部设备，必须对外部设备进行功能测试，并参考设备随附的使用说明。

与 Ambu SPUR II 人工呼吸器兼容的 Ambu 产品如下所述：

Ambu® 一次性面罩

请参阅 Ambu 一次性面罩的使用指南了解详情。

Ambu® 一次性 PEEP 20 阀 8.1 8.2

有关详细信息，请参阅 Ambu 一次性 PEEP 20 阀的使用说明或参阅本使用说明书中的示意图 8.1。要将 Ambu 一次性 PEEP 20 阀（如果需要）安装到人工呼吸器上，请拆除防溅罩。8.2

Ambu® 一次性压力计 8.1

请参阅 Ambu 一次性压力计的使用指南了解详情。

4.4. 使用后

用过的产品必须按当地规程进行处理。

5. 产品技术规格

5.1. 适用标准

Ambu SPUR II 人工呼吸器符合产品特定标准 EN ISO 10651-4。

5.2. 技术规格

	婴儿	小童	成人		
人工呼吸器体积	大约 220 ml	大约 670 ml	大约 1510 ml		
单手交付量*	150 ml	450 ml	600 ml		
双手交付量*	-	-	1000 ml		
尺寸(长度 x 直径), 不带储氧袋和配件	约 190 x 71 mm	约 223 x 99 mm	约 284 x 127 mm		
不带储氧袋和配件的重量	大约 70 g	大约 145 g	大约 220 g		
限压阀**	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)	4.0 kPa (40 cm H ₂ O)		
死腔	≤ 5 ml + 已交付量 的 10 %	≤ 5 ml + 已交付量 的 10 %	≤ 5 ml + 已交付量 的 10 %		
吸气阻力 ***	最大 0.1 kPa (1.0 cm H ₂ O) (5 l/min 下)	最大 0.5 kPa (5.0 cm H ₂ O) (50 l/min 下)	最大 0.5 kPa (5.0 cm H ₂ O) 50 l/min 下		
呼气阻力***	最大 0.2 kPa (2.0 cm H ₂ O) 5 l/min 下	最大 0.27 kPa (2.7 cm H ₂ O) 50 l/min 下	最大 0.27 kPa (2.7 cm H ₂ O) 50 l/min 下		
储气容积	约 300 ml(袋) 约 100 ml(管)	约 2600 ml(袋)	约 2600 ml(袋)		
患者接头	外径 22 mm 公头 (ISO 5356-1) 内径 15 mm 母头 (ISO 5356-1)				
呼气接头 (用于连接 PEEP 阀)	30 mm 公头 (ISO 5356-1)				
压力计端口接头	Ø 4.2 +/- 0.1 mm				
按需阀接头	-	内径 32 mm 母头 (EN ISO 10651-4)			
向前和向后泄漏	不可测量				
M-Port	接头符合 EN ISO 80369-7 标准				

	婴儿	小童	成人
O ₂ 入口接头	遵循 EN 13544-2		
工作温度限制	-18 °C 至 +50 °C (-0.4 °F 至 +122 °F), 按照 EN ISO 10651-4 标准进行测试		
存储温度限制	-40 °C 至 +60 °C (-40 °F 至 +140 °F), 按照 EN ISO 10651-4 标准进行测试		

* 根据 EN ISO 10651-4 进行测试

** 通过覆盖限压阀可获得较高的输送压力。

*** 根据 EN ISO 10651-4 在一般测试条件下测试。

5.3. MRI 安全信息



Ambu SPUR II 人工呼吸器¹、连接有 Ambu 一次性 PEEP 20 阀的 Ambu SPUR II 人工呼吸器²，以及连接有 Ambu 一次性 PEEP 20 阀和 Ambu 一次性压力计的 Ambu SPUR II 人工呼吸器²在 MR 特定条件下安全，因此，可在以下条件下安全地在 MR 环境（而不是 MR 孔内）中使用。

静磁场不超过 7 特斯拉，而且

- 最大空间磁场梯度为
 - 10,000 G/cm (100 T/m)¹
 - 16,000 G/cm (160 T/m)²
- 产生的最大力为
 - 450,000,000 G2/cm (450 T²/m)¹
 - 721,000,000 G2/cm (721 T²/m)²

在 MR 内孔内使用可能会影响 MR 影像质量。

RF 诱导加热和 MR 图像伪影尚未经过测试。所有金属部件均完全封装，不会与人体接触。

Ambu



Ambu A/S

Baltorpbakken 13

2750 Ballerup

Denmark

T +45 72 25 20 00

ambu.com